

**ВСТРОЕННЫЕ ТРЕХКАНАЛЬНЫЕ  
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ  
УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ  
ЭМ-ГИПЕРТЕРМИИ «ЯХТА-3»**


**Внесены  
в Государственный  
реестр  
под № 10989—87**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 23 июня 1987 г.**

**Выпуск разрешен  
без срока**

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Встроенные трехканальные измерители температуры установки для локальной ЭМ-гипертермии «Яхта-3» предназначены для измерения температуры в биологических тканях.

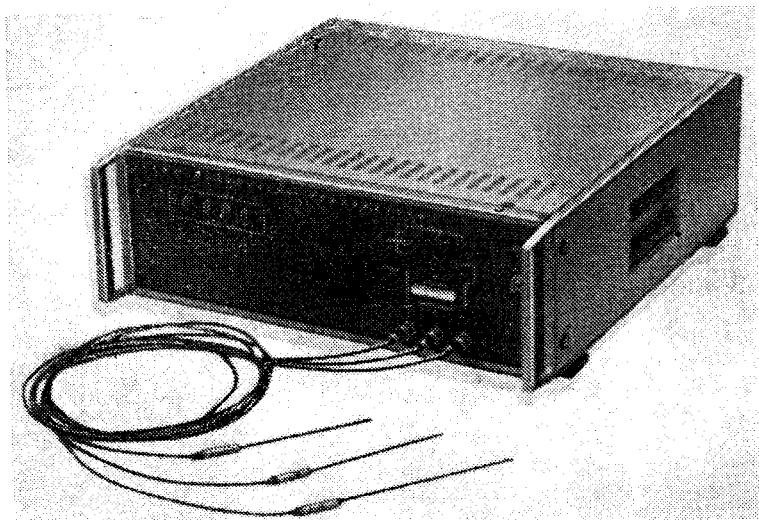

**ОПИСАНИЕ**

Трехканальный измеритель температуры является встроенным блоком установки для локальной ЭМ-гипертермии «Яхта-3».

Работа измерителя температуры основана на зависимости напряжения на р-р переходе полупроводникового диода, включенного в прямом направлении, от температуры. В качестве термопреобразовательного элемента использован бескорпусный малогабаритный диод, который помещается на кончике датчика диаметром 1 мм. С другой стороны датчика располагается малогабаритный разъем для соединения при помощи кабеля с блоком измерения температуры. Датчики, применяемые в измерителе температуры, инвазивного типа (катеторные и игольчатые).

Сигнал с датчика температуры, обработанный усилительно-преобразовательной системой, регистрируется в цифровом виде в абсолютных значениях температуры по шкале Цельсия. Единица младшего разряда 0,1 °C.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон измерений температуры 35—47 °С.  
Пределы допускаемой погрешности  $\pm 0,3$  °С.  
Потребляемая мощность 70 Вт.  
Габаритные размеры 510×170×490 мм.  
Масса 20 кг.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Совместно с блоком измерителя температуры поставляют: датчики температуры — 20 шт.; датчики катеторные — 10 шт.; кабели — 4 шт.

## **ПОВЕРКА**

Проверка измерителей температуры осуществляется по методике «Встроенный трехканальный измеритель температуры установки локальной ЭМ-гипертермии», изданной отдельным документом.

*Испытания проводила государственная комиссия.*