


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

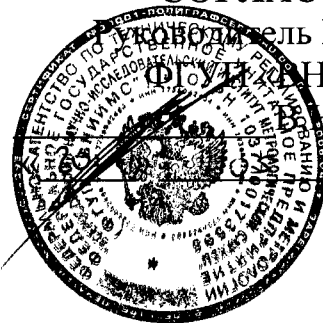

Исполнитель ГЦИ СИ
«ВНИИМ»
И.Яншин
2008

Термометры сопротивления ТСП-05	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № <u>14456-08</u> Взамен № <u>14456-03</u>
--	---

Выпускаются по ГОСТ Р 8.625-2006 и техническим условиям ТУ 95 2537-94

Назначение и область применения

Термометры сопротивления (далее - ТС) ТСП-05 предназначены для непрерывного измерения температуры химически неагрессивных сред: воды, пара, масла, воздуха, металлических и бетонных конструкций на АЭС с реакторами типа ВВЭР, РБМК, БН и на АСТ, включая оборудование, размещаемое в герметичной зоне АЭС с ВВЭР, а также для термоконтроля I контура реактора типа ВВР-Ц (отдельные исполнения).

ТС могут быть использованы в других отраслях промышленности.

Климатическое исполнение ТП – УХЛ4 (для внутренних поставок), М4, ТВЗ, ТМЗ, тип атмосферы IV (для поставок на экспорт) по ГОСТ 15150-69, группа исполнения – Д2 по ГОСТ 12997-84.

ТС устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций, допустимых для группы исполнений V4 по ГОСТ 12997-84.

ТС относятся к категории I сейсмостойкости по НП-031-01.

По устойчивости к помехам ТС относятся к группе исполнения IV по ГОСТ Р 50746-2000.

Нормальный режим эксплуатации ТС определяется следующими внешними воздействующими факторами:

- температура окружающего воздуха – до плюс 60°C;
- относительная влажность воздуха – до 90 %.

Описание

Измерение температуры с помощью ТС основано на свойстве проводников изменять электрическое сопротивление с изменением температуры.

ТС состоят из одного или двух чувствительных элементов (далее – ЧЭ), предназначенных для преобразования измеряемой температуры в изменение электрического сопротивления, и защитной арматуры.

ТС имеют исполнения, отличающиеся длиной монтажной части, диаметром арматуры, способом крепления, количеством чувствительных элементов, типом головки и номинальной статической характеристикой (НСХ) преобразования.

Чувствительные элементы ТС выполнены из платины.

Защитная арматура ТС выполнена из стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72.

ТС в зависимости от исполнения выполнены с металлической водозащищенной головкой с клеммником для подключения соединительных линий и с крепежным устройством в виде штуцера М20х1,5, М22х1,5, М27х2 или без него.

Соединение внутренних проводов ТС в зависимости от исполнения выполнено по четырехпроводной или двухпроводной схеме ГОСТ Р 8.625-2006.

ТС являются невосстанавливаемыми, неремонтируемыми, однофункциональными изделиями.

Основные технические характеристики

Диапазон измеряемых температур ТСП-05 в зависимости от исполнения – от минус 50 °С до плюс 400°С.

Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) преобразования ТС по ГОСТ Р 8.625-2006 в зависимости от исполнения – 50П, 100П и Pt100.

Температурный коэффициент ТС:

- $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ для НСХ 50П, 100П;

- $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ для НСХ Pt100.

Класс допуска ТС – А, В и С по ГОСТ Р 8.625-2006.

Примечание – ТС класса А с соединением внутренних проводов по двухпроводной схеме ГОСТ Р 8.625-2006 не выполняются.

Номинальное значение сопротивления ТС при 0 °С (R_0) по ГОСТ Р 8.625-2006 составляет, Ом:

а) 50 – для ТС с НСХ 50П;

б) 100 – для ТС с НСХ 100П и Pt100.

НСХ ТС (зависимость от температуры, температурного коэффициента α и сопротивления ТС) с $R_0 = 100$ Ом соответствуют табличным значениям ГОСТ Р 8.625-2006.

Табличные значения НСХ ТС с $R_0 = 50$ Ом рассчитываются по формуле:

$$R_{\text{нсх}}(t) = R_{\text{табл}}(t) \cdot R_0/100,$$

где $R_{\text{нсх}}(t)$ – значение сопротивления ТС (с $R_0 = 50$) по НСХ при температуре t , °С;

$R_{\text{табл}}(t)$ – значение сопротивления при температуре t , °С по таблице приложения А ГОСТ Р 8.625-2006 для $R_0 = 100$ Ом и $\alpha = 0,00391$ °С⁻¹;

R_0 – номинальное сопротивление ТС ($R_0 = 50$ Ом).

Допуск ТС (допускаемое отклонение сопротивления в температурном эквиваленте (Δt) от НСХ) при выпуске из производства:

- для класса А – $\Delta t = \pm (0,15 + 0,002 \cdot |t|)$, °С;

- для класса В – $\Delta t = \pm (0,3 + 0,005 \cdot |t|)$, °С;

- для класса С – $\Delta t = \pm (0,6 + 0,01 \cdot |t|)$, °С,

где t – абсолютное значение температуры (без учета знака), °С.

Максимальное значение измерительного тока, протекающего по ЧЭ, не превышает, мА:

- 10 – для ТС с $R_0 = 50$ Ом;

- 7 – для ТС с $R_0 = 100$ Ом.

Время термической реакции ТС в потоке воды, имеющем скорость не менее 0,3 м/с, при котором изменение показаний составляет 63,2 % полного изменения, в зависимости от исполнения – не более 20 или 40 с.

Длина монтажной части ТС в зависимости от исполнения – от 80 до 2000 мм.

Диаметр монтажной части ТС в зависимости от исполнения – 10 мм и 8 мм.

Масса ТС в зависимости от исполнения – от 0,37 до 1,12 кг.

Назначенный срок службы – 5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится штампом на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации.

Комплектность

Термометр сопротивления – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (групповой паспорт на партию ТП до 25 шт.).

Руководство по эксплуатации – 1 экз. (на партию ТП до 25 шт.).

Прокладка (в зависимости от исполнения) – 1 шт.

Поверка

Поверку ТС проводят в соответствии с ГОСТ Р 8.624-2006. «Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 2 года.

Нормативные и технические документы

1 ГОСТ 8.558-93. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.

2 ГОСТ Р 8.625-2006. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

3 ТУ 95 2537-94. Термометры сопротивления ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06. Технические условия.

Заключение

Тип термометров сопротивления ТСП-05 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель

Федеральное агентство по атомной энергии, ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» отделение «Техно-Луч».

Юридический адрес: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 24.

Телефон: (495) 715-94-49

Факс: (4967) 54-85-89

Начальник лаборатории термометрии
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»


Е.В.Васильев

Заместитель генерального директора
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»


В.П.Денисов

