


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

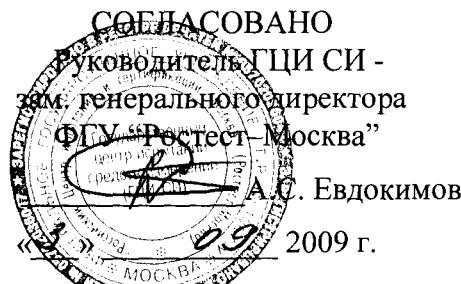

Уровнемер магнитострикционный VEEDER-ROOT	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>16333-09</u> Взамен № <u>16333-07</u>
--	---

Выпускается по технической документации фирмы "VEEDER-ROOT Co", США.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровнемер магнитострикционный типа VEEDER-ROOT (далее - уровнемер) предназначен для измерения уровней жидкости, подтоварной воды и утечки жидкости горизонтальных резервуарах, а также для измерения плотности и температуры жидкости.

Уровнемер применяется в различных отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Уровнемер состоит из магнитострикционного зонда модификаций 8462, 8463 и электронного блока (далее – блок) TLS-350, TLS-300, TLS-50 или TLS-2 и дополнительных датчиков (опционально).

Конструктивно зонд представляет собой магнитострикционный преобразователь с излучателем и приемником, и стержень из алюминиево-магниевого сплава или нержавеющей стали с двумя расположенными на нем поплавками (топливный и водяной), внутри стержня проходит магнитопровод из никелевого сплава. В поплавках находятся кольцевые ферриты, предназначенные для отражения акустического сигнала, масса поплавков подбирается в зависимости от вида топлива.

Электрический импульс, генерируемый магнитострикционным преобразователем распространяется вниз по струне, создает вокруг нее концентрическое магнитное поле, которое взаимодействуя с полем постоянных магнитов (кольцевых ферритов) топливного и водяного поплавков на основе магнитострикционного эффекта формирует ультразвуковой сигнал, пропорциональный уровню жидкости. Сигнал распространяется по струне и принимается и обрабатывается электронным блоком магнитострикционного преобразователя, и затем передается через барьер в блок, к которому может подключаться компьютер через один из интерфейсов RS 232, IFSF, SITELINK, EDIM, TCP/IP, GSM-Modem, RS 485.

Температура топлива измеряется в шести равномерно расположенных точках при помощи платиновой термопары Pt 100.

Для измерения плотности жидкости на зонде дополнительно устанавливается датчик плотности, представляющий собой поплавок, аналогичный топливному. Поплавок свободно перемещается внутри ограничителя, неподвижно закрепленного на водяном поплавке, при этом перемещение поплавка внутри ограничителя пропорционально плотности измеряемой жидкости. При использовании датчика плотности используется блок TLS-2

К блоку TLS-350 возможно подключение одновременно до 16 резервуаров, к блоку TLS-300 - до 8 резервуаров, а к блокам TLS-50 и TLS-2- до 6 резервуаров. Блок TLS-350 позволяют производить градуировку резервуаров, при этом обеспечивается автоматическая

корректировка градуировочной характеристики резервуара в процессе эксплуатации по показаниям топливораздаточных колонок. Вся информация о результатах измерений выводится на дисплей и печать.

Блоки уровнемера позволяют вычислять объём жидкости в резервуаре в литрах при рабочей температуре окружающей среды и жидкости, а также приведенных к 20 °C или 15 °C.

При использовании блоков TLS-350, TLS-300 или TLS-2 возможен контроль утечек.

При использовании блоков TLS-350 и TLS-300 возможно подключение дополнительных датчиков:

- датчик межстенного пространства резервуаров;
- дискриминационный датчик резервуара и шахты;
- датчик в технологической нише резервуара (на наличие жидкости);
- датчик межстенного пространства для двустенных труб (на наличие жидкости);

При использовании блока TLS-350:

- датчик определения топлива в грунтовых водах;
- датчик воздушных пробок;
- датчик контроля утечек на линии под давлением

Блок TLS-350 позволяет обнаружить утечку жидкости из резервуара при расходе 0,38 л/час или 0,76 л/час (в зависимости от модификации зонда).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения уровня жидкости, мм

- без поплавка плотности от 122 до 3660 включ.
- при наличии поплавка плотности от 250 до 3660 включ.

Диапазон измерения уровня подтоварной воды, мм

- без поплавка плотности от 17 до 122 включ.
- при наличии поплавка плотности от 17 до 122 включ.

Диапазон рабочих температур жидкости в резервуаре, °C

Диапазон измерения плотности жидкости, кг/м³

Пределы допускаемой погрешности:

- | | |
|--|-------|
| - измерения уровня жидкости, мм | ± 1,0 |
| - измерения уровня подтоварной воды, мм | ± 1,5 |
| - измерения температуры жидкости, °C | ± 1,0 |
| - измерения плотности, кг/м ³ | ± 1,0 |

Погрешность вычисления объёма жидкости, в % от измеряемого объёма

± 0,1

Вариация показаний при измерении уровня жидкости, мм, не более

1,0

Порог чувствительности при измерении уровня жидкости, мм, не более

0,1

Верхний предел индикации и регистрации:

- | | |
|---------------------------|---------|
| - уровня жидкости | 9 999 |
| - уровня подтоварной воды | 999,99 |
| - объема жидкости | 999 999 |
| - температуры жидкости | 99,9 |

Температура окружающего воздуха в зоне размещения электронного блока, °C

от 0 до плюс 40

Габаритные размеры, мм, не более:

- TLS-350 и TLS-300	500 x 240 x 380
- TLS-50	195 x 66 x 170
- TLS-2	195x 100 x 170
- зондов	Ø 80 x (от 1000 до 4100) (в зависимости от диапазона измерения)

Масса, кг, не более:

- электронных блоков:	
- TLS-350	13,5
- TLS-300	10
- TLS-50	1,4
- TLS-2	3
- зондов	6

Параметры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, В	220 ⁺²² ₋₃₃
- частота, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, В·А, не более	100
Средний срок службы, лет	12

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульном листе Руководства по эксплуатации и на маркировочной табличке, закрепленной на корпусе уровнемера типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Зонд уровнемера с комплектом поплавков - 1 шт. (длина и модификация заказу)
2. Электронный блок - 1 шт. (модификация по заказу)
3. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
4. Датчики - по заказу

ПОВЕРКА

Проверка уровнемеров производится в соответствии с Методикой поверки, утвержденной ГЦИ СИ ФГУ "Ростест-Москва" в августе 2009 г., и являющейся разделом Руководства по эксплуатации.

Основное поверочное оборудование:

- установка эталонная уровнемерная с диапазоном измерения от 10 до 6000 мм и пределами допускаемой погрешности не более ± 0,3 мм;
- пробоотборник по ГОСТ 2517-85;
- набор ареометров общего назначения - рабочий эталон 1 разряда, Госреестр № 27442-04;
- набор термометров по ГОСТ 400-80, с пределами допускаемой погрешности не более ± 0,1°C.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 28725-90 “Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.
Общие технические требования и методы испытаний”.
Документация фирмы “VEEDER-ROOT Co”, США.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип уровнемеров магнитострикционных VEEDER-ROOT утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.


Уровнемеры магнитострикционные VEEDER-ROOT имеют Сертификат соответствия № РОСС US. ГБ04. В00826.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма “VEEDER-ROOT Co.”, 125 Powder Forest Drive, PO Box 2003, Simsbury, CT 06070, США.

Представитель фирмы
“VEEDER-ROOT Co”, США
“GILBARCO S.r.l.” Italy
Quality Manager

Mario Lazzerini


GILBARCO S.r.l.