

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Наборы прозрачных мер координат цвета и цветности НМП моделей НМП-01 и НМН-02

Назначение средства измерений

Наборы эталонных прозрачных мер координат цвета и цветности НМП моделей НМП-01 и НМН-02 (в дальнейшем по тексту – наборы мер), предназначены для передачи размера единиц координат цвета и цветности рабочим средствам измерений.

Описание средства измерений

Каждый из наборов мер НМП-01 и НМП-02 состоит из семи мер, изготовленных из цветного оптического стекла марок ЖС-4, ЖС-11, ЖС-12, ОС-11, ОС-12, КС-10, КС-18 размером \varnothing 16 мм, толщиной 2 мм, вставленных в оправы.

Меры наборов НМП-01 и НМП-02 отличаются габаритными размерами оправ мер.

Габаритные размеры оправ мер составляют:

- для набора НМП-01 22x21x46, мм;
- для набора НМП-02 22x19x46, мм.

Наборы мер НМП-01 предназначены для поверки спектроколориметров типа Lovinbond PFX и аналогичных.

Наборы мер НМП-02 предназначены для поверки анализаторов сахара моделей ATM X2-10-0-10, ATM X2-10-0-20 и ATM X2-10-0-30.

Все меры помещаются в футляр, устройство которого предохраняет меры от ударов и загрязнения.

Внешний вид наборов мер представлен на рисунке 1.

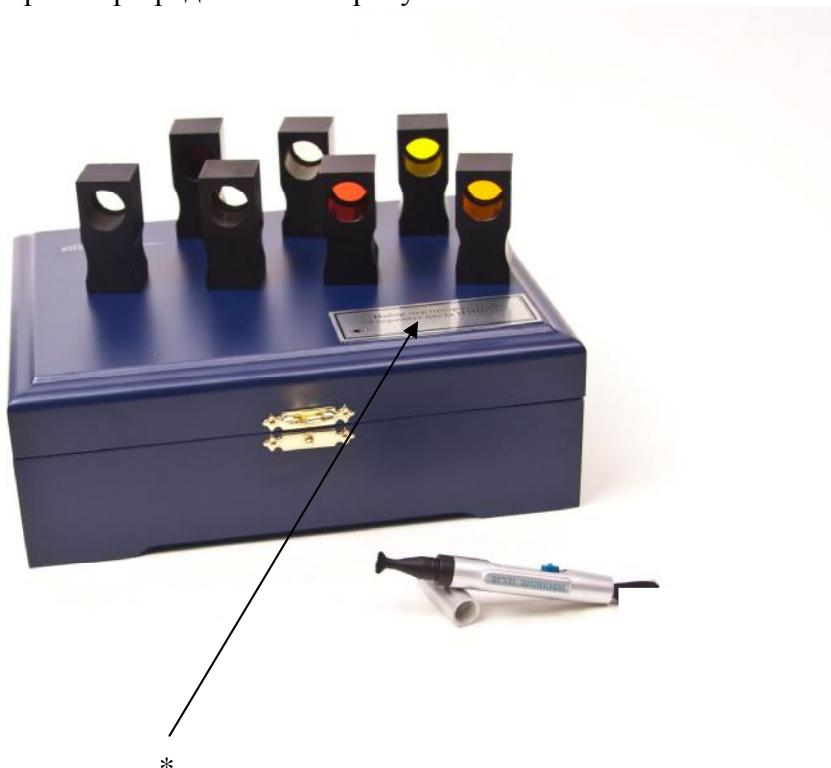


Рисунок 1 – Внешний (общий) вид наборов мер НМП моделей НМП-01 и НМП-02 ,
*- место маркировки

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики наборов мер представлены в таблице 1.

Таблица 1

Модель набора мер	НМП-01	НМП-02
Диапазон измерения координат цвета	X = 1,0 - 109,0 Y = 0,3 - 98,0 Z = 0,01 - 107,0	
Диапазон измерения координат цветности	x = 0,004 - 0,740 y = 0,005 - 0,834	
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения координат цвета		ΔX=ΔY=ΔZ=0,2
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения координат цветности		Δx=Δy=0,005
Габаритные размеры футляра с набором мер, мм, не более		210x175x75
Габаритные размеры оправ мер, мм, не более	22x21x46	22x19x46
Масса набора мер в футляре, кг, не более		0,86

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации наборов мер и на этикетку футляра методом наклеивания.

Комплектность средства измерений

наборы мер комплектуются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Мера № 1	1
2	Мера № 2	1
3	Мера № 3	1
4	Мера № 4	1
5	Мера № 5	1
6	Мера № 6	1
7	Мера № 7	1
8	Руководство по эксплуатации с методикой поверки «Наборы прозрачных мер координат цвета и цветности НМП моделей НМП -01 и НМП-02»	1
9	Футляр	1
10	Карандаш для чистки светофильтров	1

Проверка

осуществляется по документу «Наборы прозрачных мер координат цвета и цветности НМП моделей НМП-01 и НМП-02. Методика поверки МП 21.Д4-12 », утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» 6 февраля 2012 г.

Основные средства поверки

спектроколориметрическая установка, входящая в состав Вторичного эталона единиц координат цвета и координат цветности ВЭТ 81-1-2003 (в соответствии с поверочной схемой ГОСТ 8.205-90)

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методах измерений приведены в руководстве по эксплуатации «Наборы прозрачных мер координат цвета и цветности НМП моделей НМП-01 и НМП-02», раздел 6 «Работа с набором».

Нормативные документы, устанавливающие требования к набору прозрачных мер координат цвета и цветности НМП моделей

ГОСТ 8.205-90 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ и (или) оказание услуг по обеспечению единства измерений.

Изготовитель

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)

Адрес: г. Москва, 119361, ул. Озерная д.46

Тел/факс: (499) 792-07-03, E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ»), аттестат аккредитации государственного центра испытаний (испытательной, измерительной лаборатории) средств измерений № 30003-08 от 30.12.2008 г.

Адрес: г. Москва, 119361, ул. Озерная д.46

Тел/факс: (499) 792-07-03, E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.п.

«____» 2012 г.