

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства сопряжения MTC01, MTC02, MTC03

Назначение средства измерений

Устройства сопряжения MTC01, MTC02, MTC03 предназначены для измерения сопротивления постоянному току термометров сопротивления ТСМ-50, ТСП-50 по 16 (4 для МСТ03) независимым каналам.

Описание средства измерений

Устройства сопряжения MTC01, MTC02, MTC03 являются модулями, и входят в состав комплексов измерительно-информационных и управляющих МСУВТ В10Р. Комплексы МСУВТ В10Р относятся к системам открытого типа, архитектура которых формируется проектно-компоновочным способом, типы и количество технических и программных средств проектируемого комплекса определяются картой заказа. Выходные сигналы с устройств сопряжения MTC01, MTC02, MTC03 поступают на измерительные устройства сопряжения АВВ14Р.

Устройства сопряжения созданы на базе интегральных микросхем средней и большой степени интеграции и печатной платы с четырёхслойным печатным монтажом.

В состав устройства входят 16 (4 для МСТ03) входных каналов измерения сопротивления постоянному току термометров сопротивления ТСМ-50, ТСП-50, состоящих из мостовой схемы измерения сопротивления постоянному току, дифференциального усилителя, элементов гальванической развязки (MTC01, MTC03), выходных коммутаторов на 2 канала (MTC01, MTC02), вторичного источника питания.

Принцип действия измерительных каналов основан на использовании трехпроводной схемы измерения сопротивлений постоянному току и передачи полученного в результате преобразования напряжения в измерительный модуль в соответствии с функциями преобразования, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Тип входного сигнала	Функция преобразования $Y = f(X)$, Y - выходной сигнал
Сопротивление постоянному току в диапазоне от 46 до 110 Ом	$Y = KX + 1,6V$

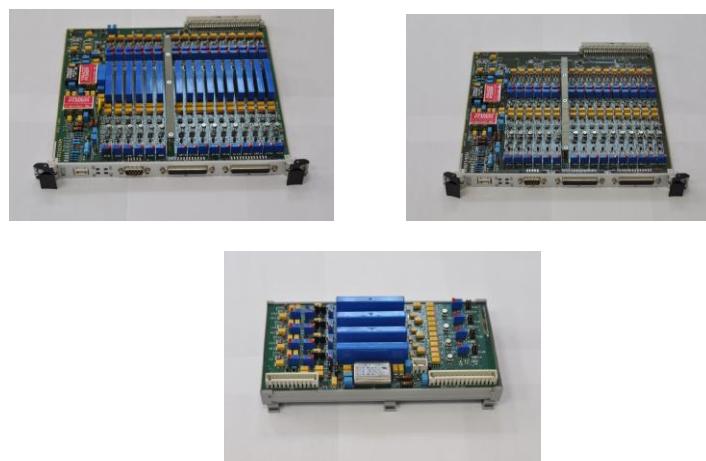


Рисунок 1 - Фотографии общего вида устройств сопряжения MTC01, MTC02, MTC03

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики устройств сопряжения МТС01, МТС02, МТС03 приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные метрологические характеристики измерения сопротивления постоянного тока

Тип модуля	Входной сигнал канала	Выходной сигнал, % от диапазона изменения физической величины	Предел основной приведенной погрешности, % δ_x
МТС01, МТС02, МТС03	46 -110 Ом	от 1,6 до 8,0 В	0,2

Таблица 3 - Габаритные размеры и масса устройств сопряжения МТС01, МТС02

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
245	262	20,3	0,5

Таблица 4 - Габаритные размеры и масса устройств сопряжения МТС03

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
106	187,5	32,5	0,5

Температура

Рабочая.....от 18 °C до 28 °C

Хранения.....от минус 50 °C до 50 °C

Влажность.....от 10 % до 90 % без конденсации

Питание

напряжение от +20,4 В до +28,4 В

Знак утверждения типа

nanoсят на лицевую панель устройств сопряжения МТС01, МТС02 или торцевую панель устройств сопряжения МТС03 методом трафаретной печати и на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - комплектность устройств сопряжения МТС01, МТС02, МТС03

Наименование	Количество
Устройство сопряжения МТС01, МТС02, МТС03	1
Паспорт	1
Методика поверки МП-474/447-2011	1

Проверка

осуществляется по документу МП-474/447-2011 «ГСИ. Устройство сопряжения МТС. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» 15 августа 2011 г.

Основным средствами поверки являются вольтметр универсальный В7-64/1диапазон измерения напряжения постоянного тока от 0 до 12,5 В погрешность измерения напряжения постоянного тока $\pm 0,0004 \%$, и магазин сопротивления Р4831 диапазон воспроизведения сопротивления постоянного тока от 0,001 до 99999,9 Ом погрешность воспроизведения сопротивления постоянного $\pm 0,02 \%$, тока.

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в документе «Устройство сопряжения МТС01, МТС02, МТС03» Паспорт ПИБШ.468353.089 ПС

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам сопряжения МТС01, МТС02, МТС03

Паспорт ПИБШ.468353.089 ПС

Изготовитель

АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
107078, Российская Федерация, г. Москва,
Хоромный тупик дом 4, строение 1
Тел. (495) 608-84-67
vniiem@vniiem.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (495) 544-00-00
<http://www.rostest.ru>

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний
средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2017 г.