

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства весоизмерительные автоматические CSJ, CMJ

Назначение средства измерений

Устройства весоизмерительные автоматические CSJ, CMJ (далее - средство измерений) предназначены для измерений массы.

Описание средства измерений

Принцип действия средства измерений основан на использовании гравитационного притяжения. Сила тяжести объекта измерений вызывает деформацию чувствительного элемента средства измерений, которая преобразуется в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный массе объекта измерений. Этот сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию, математической обработке электронными устройствами средства измерений с дальнейшим определением значения массы объекта измерений.

Измеренное значение массы отображается в визуальной форме на дисплее средства измерений, а также может быть сохранено в запоминающем устройстве.

Средство измерений представляет собой устройства весоизмерительные автоматические по ГОСТ Р 54796-2011 (как однодиапазонные или многоинтервальные устройства для автоматического динамического взвешивания объектов измерений при их движении по конвейерной ленте) и состоит из следующих частей:

- опорная рама (в различных конфигурациях в зависимости от места установки, для которого предназначено средство измерений);
- весоизмерительный тензорезисторный датчик (далее - датчик), смонтированный на опорной раме и закрытый защитным кожухом;
- грузоприемное устройство в виде ленточного конвейера, опирающегося на датчик;
- графический дисплей с чувствительным экраном;
- электрический шкаф, содержащий электронное устройство обработки измерительной информации и управления исполнительными механизмами средства измерений, блоки цифровых интерфейсов, устройства питания и коммутации;
- устройство обнаружения груза на грузовой транспортной системе (оптический датчик);
- ленточные конвейеры для подачи объектов измерений на грузоприемное устройство или снятия с него (в зависимости от места установки, для которого предназначено средство измерений);
- устройства отбраковки/сортировки для реализации функций устройства сортировки по массе, дополнительные устройства обнаружения металлов внутри объектов измерений (в зависимости от места установки, для которого предназначено средство измерений);
- печатающее устройство (в зависимости от оснащения).

Средство измерений выпускается в модификациях, отличающихся максимальной нагрузкой, конструктивным исполнением ленточных конвейеров, определяемым характером объекта измерений и местом установки, для которых предназначено средство измерений, а также оснащением. Схема обозначения модификаций средства измерений:

C[A]J[B]L[C][D]-[E] / CE3100

где:

[A] - S для устройств с шириной ленты конвейера 160, 240 или 320 мм; M для устройств с шириной ленты конвейера 400 мм.

[B] - условное обозначение максимальной нагрузки: 06, 22, 33 - соответственно, 600 или 6000, 2200, 3300 г; 12, 30, - соответственно 12, 30 кг.

[C] - М или MN: наличие устройства обнаружения металлов внутри объектов измерений в составе средства измерений; индекс отсутствует - без устройства обнаружения металлов;

[D] - W: влагозащищенное исполнение; индекс отсутствует: обычное исполнение;

[E] - буквенно-цифровое обозначение оснащения устройства: обозначения исполнения устройства сортировки, обнаружения металлов внутри объектов измерений, печатающих устройств и т.д.

Внешний вид средства измерений представлен на рисунке 1



Рисунок 1 - Внешний вид средства измерений (примеры)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунках 2 и 3.



Рисунок 2 - Схема пломбировки печатной платы электронного устройства обработки измерительной информации и управления

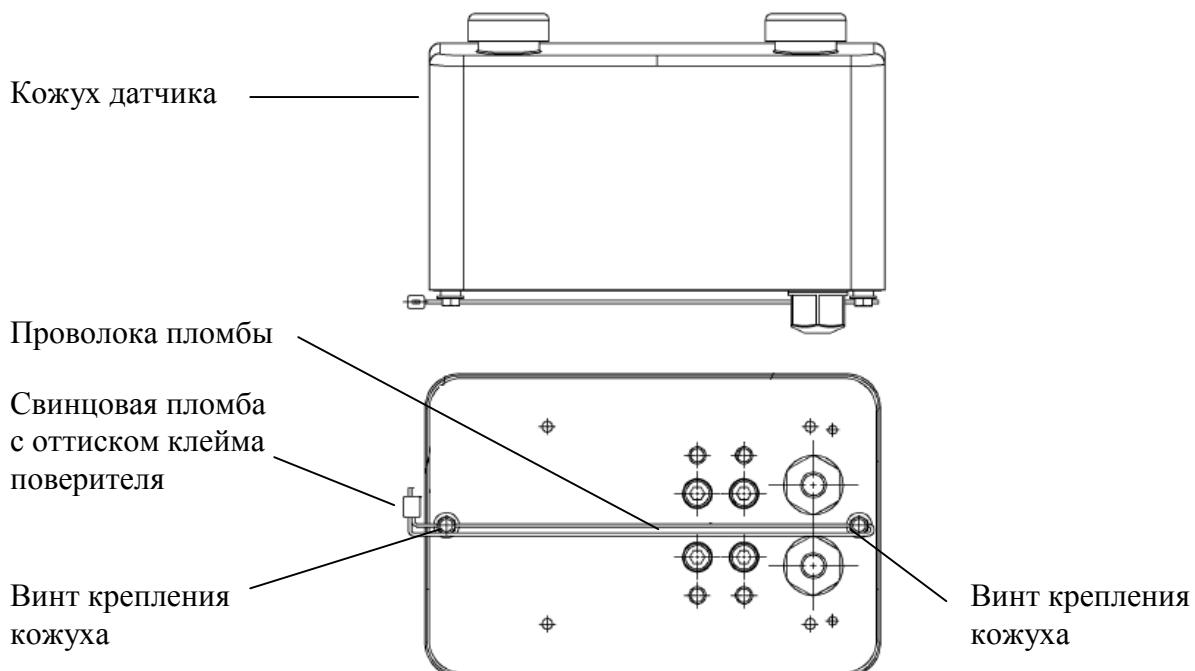


Рисунок 3 - Схема пломбировки датчика (сверху - вид сбоку, снизу - вид снизу)

Программное обеспечение

Программное обеспечение является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами.

Для защиты от несанкционированного доступа к метрологически значимой части программного обеспечения, параметрам регулировки средства измерений, а также измерительной информации, используются:

– пломбировка переключателя регулировки на печатной плате электронного устройства, осуществляющего обработку сигнала датчика;

– разграничение прав доступа к режимам работы средства измерений с помощью пароля;

Идентификационные данные ПО доступны для просмотра при работе средства измерений в специальном пункте меню в соответствии с эксплуатационной документацией. Номер версии (идентификационный номер) ПО должен быть не ниже указанного в таблице 1.

Уровень защиты программного обеспечения «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	A/D
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.02
Цифровой идентификатор ПО	F58E

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики однодиапазонных средств измерений

Наименование характеристики	CSJ06...	CSJ33...	CMJ06...	CMJ12...	CMJ30...
Класс точности по ГОСТ 54796-2010	XIII(1)				
Максимальная нагрузка, Max, г	600	3300	6000	12000	30000
Минимальная нагрузка Min, г, при установленной скорости грузовой транспортной системы, м/мин:					
– до 60 включ.	15	30	60	60	300
– св. 60 до 80 включ.	30	30	-	-	-
– св. 80	40	-	-	-	-
Поверочное деление e , действительная цена деления (шкалы) d , $e=d$, г	0,2	0,5	2	2	5
Число поверочных делений n	3000	6600	3000	6000	6000
Диапазон уравновешивания тары (максимальное значение массы тары)	100 % Max				

Таблица 3 - Метрологические характеристики многоинтервальных средств измерений

Наименование характеристики	CSJ22...
Класс точности по ГОСТ 54796-2010	XIII(1)
Максимальная нагрузка, Max_1/Max_2 , г	1500/2200
Минимальная нагрузка Min, г, при установленной скорости грузовой транспортной системы, м/мин:	
– до 60 включ.	15
– св. 60 до 80 включ.	30
– св. 80	40

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	CSJ22...
Поверочное деление e_1/e_2 , действительная цена деления (шкалы) $d_1/d_2, e_i=d_i, \text{г}$	0,2/0,5
Число поверочных делений n_1/n_2	7500/4400
Диапазон уравновешивания тары (максимальное значение массы тары)	100 % Max

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания:	
– напряжение переменного тока (номинальное), В	220
– частота переменного тока, Гц	50±1
Максимальная скорость грузовой транспортной системы v_{Max} , м/мин	116
Габаритные размеры средства измерений, мм, не более	
– высота	2000
– ширина	1500
– длина	4000
Условия эксплуатации:	
– температура окружающей среды, °С	от -10 до +40
– относительная влажность, %	до 85 включ.

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе средства измерений методом офсетной печати, а также на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Устройство весоизмерительное автоматическое	-	1 шт.
Комплект принадлежностей	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.
Методика поверки	МП 204-09-2016	1 экз.

Проверка

осуществляется по документу МП 204-09-2016 «Устройства весоизмерительные автоматические CSJ, CMJ. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 18 ноября 2016 г.

Основные средства поверки:

– гири, соответствующие классам точности F₁, F₂, M₁ по ГОСТ OIML R 111-1-2009;
– весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1-2011 (весы для статического взвешивания), обеспечивающие измерения испытательной нагрузки (условно истинного значения массы) с погрешностью, не превышающей 1/3 пределов допускаемых показателей точности средства измерений.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на лицевую панель показывающего устройства.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам весоизмерительным автоматическим CSJ, CMJ

ГОСТ Р 54796-2011 «Устройства весоизмерительные автоматические. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Техническая документация изготовителя.

Изготовитель

«YAMATO SCALE CO., LTD», Япония

Юридический адрес: 5-22 Saenba-cho, Akashi, Japan, 673-8688

Почтовый адрес: 5-22 Saenba-cho, Akashi, Japan, 673-8688

Телефон: +81(78)918-5566, +81(78)918-5567, +81(78)918-5568

Факс: +81(78)918-5552

Web-сайт: www.yamato-scale.co.jp

Заявитель

Представительство общества с ограниченной ответственностью «ЯМАТО СКЕЙЛ ГмбХ»
(Германия)

ИНН 9909210499

Юридический адрес: 109341, г.Москва,ул.Люблинская,151 Телефон: +7 495 620 48 70

Телефон: (495) 620 48 70

Факс: (495) 620 48 77

Web-сайт: www.yamatoscale.com

E-mail: salesru@yamatoscale.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

Телефон/факс: (495) 437 55 77 / (495) 437 56 66

Web-сайт: vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2017 г.