

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-2М

Назначение средства измерений

Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-2М (далее - секундомеры) предназначены для измерений и воспроизведений интервалов времени.

Описание средства измерений

Принцип действия секундомеров основан на делении опорной частоты и получения ряда частот, которые используются для формирования и измерения интервалов времени. Секундомеры оснащены основным и вспомогательным цифровыми 6-и разрядными индикаторами. На основном табло индицируется отсчет интервалов времени, показания часов, а на вспомогательном - значение уставок. Секундомеры обеспечивают два режима работы: секундомера и часов. Выбор режима работы осуществляется с помощью кнопочных переключателей. Секундомеры обеспечивают дистанционный и ручной пуск, остановов и сброс. В режиме секундомера обеспечивается прямой и обратный счет с включением таймерного и звукового (светового) сигнала при достижении конечного значения.

Общий вид секундомера представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид секундомера

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.

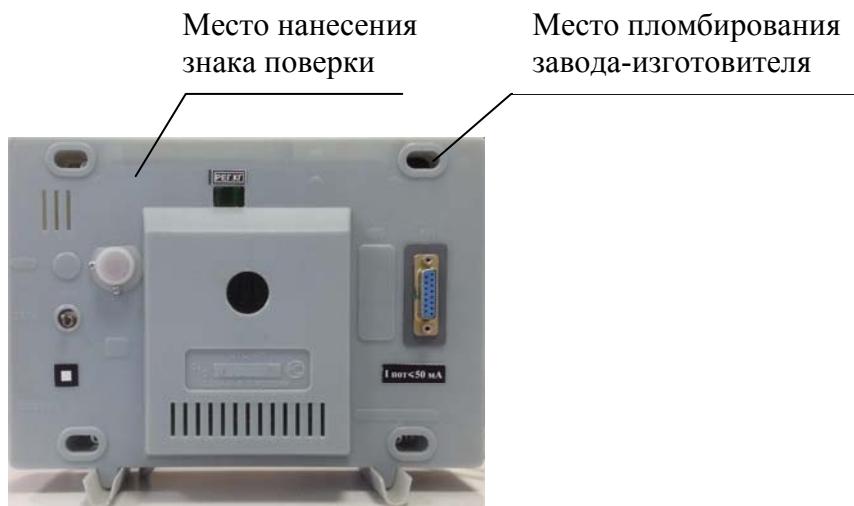


Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Защита от внесения несанкционированных изменений в конструкцию секундомеров обеспечивается установкой пломбы завода-изготовителя.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений и воспроизведений интервалов времени: - при цене деления 0,01 с (режим секундомера), с - при цене деления 1 с (режим часов), с	от 0,01 до 9999,99 от 1 с до 23 ч 59 мин 59 с
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений и воспроизведений интервалов времени при выпуске из производства в нормальных условиях (при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$), с - при цене деления 0,01 с - при цене деления 1 с	$\pm(15 \cdot 10^{-6} \cdot T^* + 0,01)$ $\pm(15 \cdot 10^{-6} \cdot T^* + 1)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения и воспроизведения интервалов времени в рабочих условиях за год, с: - при цене деления 0,01 с - при цене деления 1 с	$\pm(35 \cdot 10^{-6} \cdot T^* + 0,01)$ $\pm(35 \cdot 10^{-6} \cdot T^* + 1)$
* Т - измеренное значение интервала времени	

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	220_{-33}^{+22} 50 ± 1
Потребляемая мощность, В·А, не более	8
Сила постоянного тока, коммутируемого на таймерном выходе, мА, не более	300
Габаритные размеры, мм, не более - высота - ширина - длина	180 80 242
Масса, кг, не более	1,2
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, $^\circ\text{C}$ - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от +1 до +40 80 от 84 до 107
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	5000

Знак утверждения типа
наносится на паспорт печатным способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность секундомеров

Наименование	Обозначение	Количество
Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-2М	-	1 шт.
Вставка плавкая ПВ1-1-0,25 А	-	1 шт.

Наименование	Обозначение	Количество
Вилка РП15-15 ШК (ШВК, ШВКВ)	-	1 шт.
Паспорт	гИ2.815.052 ПС	1 экз.
Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-2М.	МП 288-17	1 экз.
Методика поверки		

Проверка

осуществляется по документу МП 288-17 Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-2М. Методика поверки, утвержденному ФБУ «Томский ЦСМ» 09.10.2017 г.

Основные средства поверки:

Рабочий эталон по ГОСТ 8.129-2013, диапазон измерений частот от $1 \cdot 10^{-3}$ до $6,5 \cdot 10^9$ Гц, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 5 \cdot 10^{-10}$, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 56478-14.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на корпус секундомера (рисунок 2). Знак поверки также наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к секундомерам электронным с таймерным выходом СТЦ-2М

ГОСТ 8.129-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ТУ 4282-006-35481912-2002 Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-2М. Технические условия

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Завод Специальные технические системы» (ЗАО «Завод СТС»)

ИНН: 7825461478

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 44

Телефон: (812) 764-93-94

Заявитель

Открытое акционерное общество «Томскнефть» Восточной нефтяной компании (ОАО «Томскнефть» ВНК)

ИНН 7022000310

Адрес: 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д.23

Телефон: (38259) 6-95-03, факс: (38259) 6-96-35

E-mail: JSCTN@tomskneft.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»)

Адрес: 634012, Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д.17-а

Телефон: (3822) 55-44-86, факс (3822) 56-19-61, 55-36-76

Web-сайт: tomskcsms.ru

E-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Томский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30113-13 от 03.06.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2018 г.