

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакциях, утвержденных приказами Росстандарта № 1580 от 17.10.2016 г.,
№ 598 от 25.03.2019 г.)

Комплексы измерительно-вычислительные ИМЦ-07

Назначение средства измерений

Комплексы измерительно-вычислительные ИМЦ-07 (далее - ИВК) предназначены для измерений и преобразования параметров входных электрических сигналов (токовых, импульсных, частотных), поступающих от измерительных преобразователей, в значения величин.

Описание средства измерений

Принцип действия ИВК заключается в том, что электрические сигналы от измерительных преобразователей через барьеры искробезопасности (при их наличии) поступают на входные модули контроллера, где происходит измерение. Далее измеренные значения передаются в компьютер. В компьютере измеренные значения преобразуются в значения величин с последующим отображением на экране монитора, сохранением в отчетах и протоколах, и выводом на печать.

ИВК обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- измерение информативных параметров входных электрических сигналов, поступающих от измерительных преобразователей;
- контроль значений измеренных информативных параметров входных электрических сигналов;
- преобразование информативных параметров входных электрических сигналов в значения величин;
- контроль значений величин, звуковая сигнализация и печать сообщений о выходе значений за установленные пределы;
- создание и ведение журналов событий с возможностью просмотра и печати;
- представление учетной информации в виде отчетов (оперативный, сменный, суточный, месячный, годовой, на партию);
- создание и ведение архивов учетной информации с возможностью просмотра и печати;
- определение метрологических характеристик (МХ) преобразователей расхода (ПР);
- формирование, отображение и печать протоколов поверки и контроля ПР;
- создание и ведение архивов протоколов поверки и контроля ПР с возможностью просмотра и печати;
- управление автоматическими пробоотборниками;
- управление приводом крана трубопоршневых поверочных установок (ТПУ);
- защита информации системой доступов и паролей;
- обмен данными с компьютером верхнего уровня по протоколам: Modbus ASCII, RTU, интерфейс RS 232 или RS 485; Modbus TCP, интерфейс Ethernet.

ИВК обеспечивает измерение следующих информативных параметров входных электрических сигналов:

- сила постоянного тока;
- частота и период импульсного сигнала;
- количество импульсов;
- количество импульсов за интервал времени;
- отношение количества импульсов за интервал времени.

ИВК обеспечивает вычисление значений следующих основных величин:

- объемный и массовый расход жидкости в измерительных линиях (ИЛ);
- суммарный объемный и массовый расход жидкости по блоку ИЛ (БИЛ);
- объем жидкости;
- масса жидкости;
- температура жидкости;
- давление жидкости;
- плотность жидкости;
- перепад давления на фильтрах;
- вязкость жидкости;
- объемная и массовая доля воды в жидкости;
- массовая доля серы в жидкости;
- коэффициент преобразования преобразователей объемного расхода (ПОР) при определении МХ по ТПУ или КП;
- коэффициент преобразования ПОР при определении МХ по эталонному преобразователю расхода (ЭПР);
- коэффициент преобразования ПОР при определении МХ по мернику;
- коэффициент преобразования, коэффициент коррекции, градуировочный коэффициент преобразователя массового расхода (ПМР) при определении МХ по ТПУ или КП и преобразователю плотности (ПП);
- коэффициент преобразования, коэффициент коррекции, градуировочный коэффициент ПМР при определении МХ по ЭПР.

ИВК изготавливается в девяти вариантах конструктивного исполнения:

- приборное исполнение: исполнение 1 – встраиваемый прибор; исполнение 8 – встраиваемый прибор с дублированием всех функций;
- шкафное исполнение: исполнение 2 – настенный шкаф; исполнение 3 – напольный шкаф; исполнение 4 и 5 – напольный шкаф с дублированием всех функций; исполнение 6 – настенный взрывозащищенный шкаф;
- распределенное исполнение: исполнение 7 – модуль 1 и модуль 2: настенные взрывозащищенные шкафы с дублированием всех функций; исполнение 9 – модуль 1: настенный взрывозащищенный шкаф, модуль 2: переносной прибор.

Дублирование функций ИВК обеспечивается дублированием контроллера, компьютера, блоков питания («горячее» резервирование).

Общий вид ИВК показан на рисунках 1-5. Общий вид конкретного изделия может отличаться от представленных примеров (определяется требованиями конкретного заказа).



Рисунок 1 – Общий вид ИВК, исполнения 1 и 8



Рисунок 2 – Общий вид ИВК, исполнения 2, 3, 4 и 5



Рисунок 3 – Общий вид ИВК, исполнение 6



Рисунок 4 – Общий вид ИВК, исполнение 7



Рисунок 5 – Общий вид ИВК, исполнение 9



Рисунок 6 – Места нанесения знака поверки, приборное исполнение

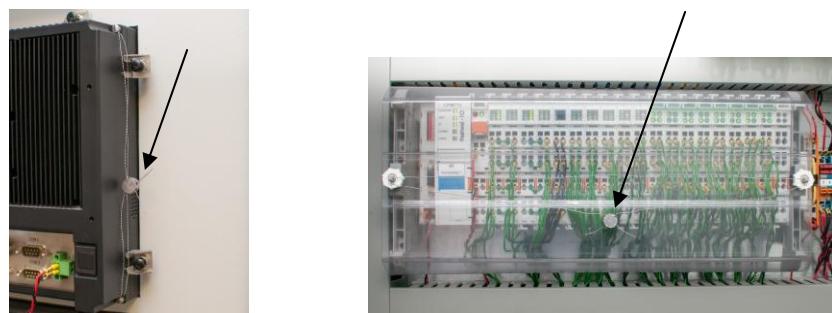


Рисунок 7 – Места нанесения знака поверки, шкафное исполнение

Программное обеспечение

ИВК имеет встроенное прикладное программное обеспечение (далее - ПО ИВК)

Защита данных от несанкционированного доступа в ПО ИВК обеспечивается разграничением прав пользователей. Введены четырехуровневая система доступа и система паролей. Предусмотрена физическая защита (опломбирование) контроллеров, установленных в ИВК, от несанкционированного доступа.

Контроль целостности и подлинности ПО осуществляется посредством расчета контрольных сумм файлов по алгоритму CRC32. Влияние ПО ИВК на метрологические характеристики ИВК учтено при нормировании метрологических характеристик ИВК.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	EMC07.exe или EMC07.Metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	PX.7000.01.01 или выше
Цифровой идентификатор ПО*	XXXXXX (CRC32)

* Цифровые идентификаторы ПО ИВК приведены в свидетельствах о метрологической аттестации (сертификатах подтверждения соответствия) программного обеспечения (программы) для каждой конкретной версии (или диапазона версий) ПО ИВК.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений частоты импульсного сигнала, Гц	от 1 до 10000
Диапазон измерений силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Диапазон формирования силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой относительной погрешности ИВК при измерении: - периода импульсного сигнала, % - частоты импульсного сигнала, % - количества импульсов, % - количества импульсов за интервал времени, % - отношения количества импульсов за интервал времени, %	$\pm 0,0015$ $\pm 0,0015$ $\pm 0,005$ $\pm 0,005$ $\pm 0,005$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИВК при измерении силы постоянного тока, мА	$\pm 0,009$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИВК при формировании силы постоянного тока, мА	$\pm 0,015$
Пределы допускаемой относительной погрешности ИВК при преобразовании параметров входных электрических сигналов в значения: - объема жидкости: - для ПОР, % - для ПМР и ПП, % - объема жидкости при стандартных условиях: - для ПОР, % - для ПМР и ПП, %; - массы жидкости: - для ПОР и ПП, % - для ПМР, % - коэффициента преобразования ПОР при определении МХ: - по ТПУ и КП, % - по эталонному ПОР (ЭПОР), контролльному ПОР (КПОР), ПОР, % - по эталонному ПМР (ЭПМР), контролльному ПМР (КПМР), ПМР и ПП, % - по мернику - коэффициента преобразования, коэффициента коррекции, градуировочного коэффициента ПМР при определении МХ: - по ТПУ или КП и ПП, %. - по ЭПОР (КПОР, ПОР) и ПП, % - по ЭПМР (КПМР, ПМР), %	$\pm 0,005$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,005$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,02$ $\pm 0,005$

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Характеристики импульсных входов: - амплитуда входного сигнала, В - количество*	от 2 до 24 от 0 до 24
Характеристики токовых входов: - количество*	от 0 до 48
Характеристики аналоговых выходов: - сопротивление нагрузки, Ом, не более - количество*	600 от 0 до 4

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	Значение
Характеристики входов для подключения детекторов ТПУ:	
- тип сигнала	«сухой» контакт
- количество*	от 0 до 16
Характеристики дискретных входов:	
- тип сигнала	«сухой» контакт
- количество*	от 0 до 24
Характеристики дискретных выходов:	
- исполнение 1, 8:	
- тип сигнала	открытый коллектор
- напряжение постоянного тока, В, не более	24
- выходной ток, А, не более	0,5
- исполнения 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9:	
- тип сигнала	контакт реле
- напряжение постоянного тока, В, не более	36
- напряжение переменного тока, В, не более	30
- выходной ток, мА, не более	50
- количество*	от 0 до 16
Параметры электрического питания напряжением переменного тока:	
- напряжение, В	220±22
- частота, Гц	50±0,4
- потребляемая мощность, В·А, не более **:	
- исполнение 1, 2, 3, 6 и 9	120
- исполнение 4, 5 и 7	240
Параметры электрического питания напряжением постоянного тока:	
- напряжение, В	24±2,4
- потребляемая мощность, В·А, не более **:	
- исполнение 1	60
- исполнение 8	120
Условия эксплуатации:	
- рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С	от +5 до +35 (от -40 до +35)***
- рабочий диапазон относительной влажности окружающего воздуха (без конденсации), %	от 30 до 80
- рабочий диапазон атмосферного давления, кПа	от 84 до 106
Габаритные размеры (ширина; высота; глубина), мм, не более **:	
- исполнение 1	500; 350; 250
- исполнение 2	600; 1600; 500
- исполнения 3, 4	600; 2100; 600
- исполнение 5	800; 2100; 600
- исполнение 6	650; 900; 500
- исполнение 7	
- модуль 1	710; 1010; 500
- модуль 2	450; 300; 350
- исполнение 8	500; 700; 300
- исполнение 9	
- модуль 1	710; 1010; 500
- модуль 2	600; 500; 300

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	Значение
Масса ИВК без упаковки, кг, не более **:	
- исполнение 1	15
- исполнение 2	70
- исполнение 3	110
- исполнение 4	120
- исполнение 5	140
- исполнение 6	150
- исполнение 7	230
- исполнение 8	20
- исполнение 9	200
Срок службы, лет, не менее	10
Наработка на отказ, ч, не менее	30000
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенных шкафов	1ExdIIBT4/T5/T6

* В зависимости от заказа
** Приведены максимальные значения, без учета системы обогрева
*** При наличии системы обогрева

Знак утверждения типа

наносится на паспортную табличку ИВК и титульные листы эксплуатационной документации методом компьютерной графики.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность комплексов измерительно-вычислительных ИМЦ-07

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
ИВК		1	
Принтер			По заказу
Барьеры искробезопасности			Модель и количество определяется заказом
Комплект ЗИП		1	Номенклатура и количество определяется заказом
Комплект эксплуатационной документации	PX.7xxx.xx.00.000	1	
Методика поверки	МИ 3395-2013 с изменением № 1	1	
Резервная копия программного обеспечения		1	Поставляется на электронном носителе

Проверка

осуществляется по документу МИ 3395-2013 с изменением № 1 «Рекомендация. ГСИ. Комплексы измерительно-вычислительные ИМЦ-07. Методика поверки», утвержденному ООО «ИМС Индастриз» и ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 25 мая 2018 г.

Основные средства поверки:

- устройство для поверки вторичной измерительной аппаратуры узлов учета нефти и нефтепродуктов УПВА-Т (регистрационный номер 39214-08);
- калибратор многофункциональный DPI 620 (регистрационный номер 60401-15).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в виде оттиска на пломбы (рисунки 6, 7) и на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам измерительно-вычислительным ИМЦ-07

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ТУ 4222-007-97243614-2013 Комплекс измерительно-вычислительный ИМЦ-07.
Технические условия с изменениями 1, 2, 3

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ИМС Индастриз»
(ООО «ИМС Индастриз»)

ИНН 7736545870

Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 47 А

Юридический адрес: 142703, Московская обл., Ленинский район, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2, стр. 10, ком. 611

Телефон: (495) 221-10-50, факс: (495) 221-10-51

E-mail: ims@imsholding.ru

Web-сайт: www.imsholding.ru

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ИМС Индастриз» филиал «ИМС Индастриз – Уфа»

(ООО «ИМС Индастриз» филиал «ИМС Индастриз – Уфа»)

ИНН 7736545870

Адрес: 450071, г. Уфа, ул. Луганская 3/1

Юридический адрес: 142703, Московская обл., Ленинский район, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2, стр. 10, ком. 611

Телефон: (347) 216-34-78, факс: (347) 216-34-79

E-mail: ufa@imsholding.ru

Web-сайт: www.imsholding.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

A.B. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2019 г.