

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» июля 2021 г. № 1289

Регистрационный № 61575-15

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Гамма - спектрометры сцинтилляционные OSPREY-NS

Назначение средства измерений

Гамма - спектрометры сцинтилляционные OSPREY-NS (далее спектрометры OSPREY-NS) предназначены для измерения энергий испускаемых радионуклидами гамма-квантов и активности гамма-излучающих радионуклидов в пробах (при наличии соответствующих градуировок и аттестованных методик измерений).

Описание средства измерений

Принцип действия спектрометров OSPREY-NS основан на регистрации сцинтилляционным детектором квантов гамма-излучения, испускаемого радионуклидами, присутствующими в среде или объекте, получении спектра амплитудного распределения и выделении в спектре пиков полного поглощения (ППП) квантов гамма-излучения. По положению ППП в спектре определяют энергию гамма-квантов E_i (спектрометр предварительно градуируют по энергии с помощью образцовых источников гамма излучения).

Для управления гамма-спектрометрами используется персональный компьютер с установленным программным обеспечением. Программное обеспечение выполняет следующие функции: управление настройками спектрометрических трактов и набором спектров, вывод спектров, проведение необходимых калибровок, анализ полученных спектров.

Спектрометры OSPREY-NS состоят из:

- сцинтилляционного блока детектирования (серий 802 или LABR);
- многоканального анализатора амплитуд импульсов OspreyTM;
- персонального компьютера с программным обеспечением семейства Genie-2000;
- поциальному заказу может поставляться защитный свинцовый экран.

Многоканальный анализатор амплитуд импульсов OspreyTM имеет цифровой стабилизатор спектра по реперному пику.

Гамма-спектрометры могут использоваться как самостоятельно, так и в составе систем радиационного мониторинга. Гамма-спектрометры могут эксплуатироваться как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Внешний вид спектрометров OSPREY-NS представлен на рисунке 1.

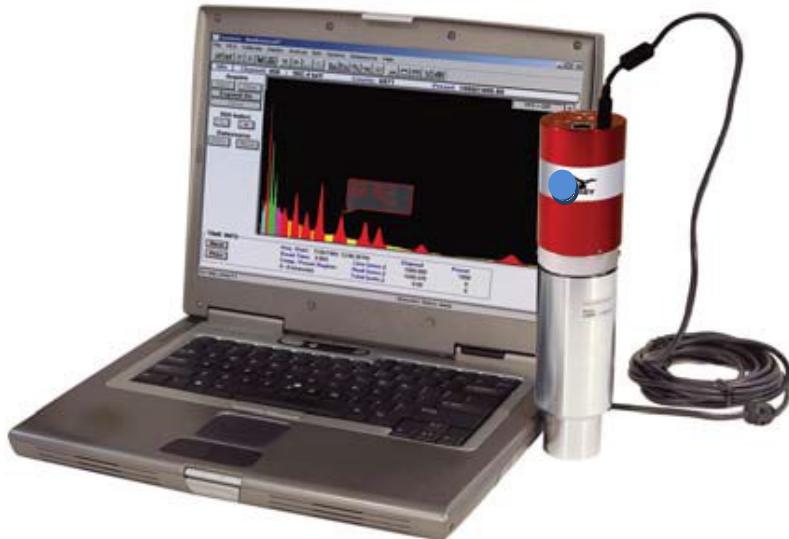


Рис. 1 Внешний вид спектрометров OSPREY-NS (Синей точкой обозначено место пломбирования от несанкционированного доступа).

Программное обеспечение

Управление набором спектров, их визуализация и анализ, калибровки и остальные необходимые операции со спектрометрами выполняются средствами программного обеспечения, установленного на управляющий компьютер.

Указанное программное обеспечение предназначено для работы на персональных компьютерах, работающих под управлением операционной системы Windows XP Pro или выше.

Базовое программное обеспечение (ПО) Genie-2000 выполняет следующие основные функции:

- управление многоканальными анализаторами и вывод спектра на экран;
- запись и чтение спектрометрической информации на диск;
- операции со спектром в ручном и автоматическом режимах (калибровка, поиск и предварительная идентификация пиков, расчет их параметров);
- создание отчетов (отчеты создаются на основе шаблонов, которые пользователь может модифицировать, исходя из своих требований).

Базовое ПО Genie-2000 может поставляться в 3 различных модификациях:

- базовое ПО для многовходовых систем модели S500. Данная модификация позволяет одновременное управление несколькими многоканальными анализаторами;
- базовое ПО для одновходовых систем модели S502. Данная модификация позволяет одновременное управление одним многоканальным анализатором;
- базовое ПО для анализаторов InSpectr модели S504. Данная модификация позволяет одновременное управление одним многоканальным анализатором OSPREY.

Модификации S500 и S502 отличаются друг от друга только ключом аппаратной защиты, файловая структура у них одинаковая.

Метрологически значимая часть ПО Genie-2000 состоит из программных модулей набора и анализа гамма – спектров (MVCG.exe, MVCGSA.dll) и виртуального диспетчера данных (WINVDM.exe).

Таблица 1. Идентификационные признаки метрологически значимой части ПО спектрометров модификации S504

Идентификационные данные		Значения	
Идентификационное наименование ПО	MVCG.exe	MVCGSA.dll	WINVDM.exe
Номер версии ПО	3.3.0.2435 ¹⁾	не указан	3.3.0.2435 ¹⁾
Цифровой идентификатор ПО (по MD5)	493A2F4CA25B662D 98036904EC583891 ²⁾	19741EE5E98D63499 68FE7D1DB46093C ²⁾	B83FEBC95C7CFD7F 55E05E805D6E5F43 ²⁾
Дата	18.03.2013 ²⁾ и позднее	18.03.2013 ²⁾ и позднее	18.03.2013 ²⁾ и позднее
Примечания: 1. Номер версии программного обеспечения не ниже указанного в таблице. 2. Контрольная сумма и дата создания файлов относятся к текущей версии программного обеспечения.			

Таблица 2. Идентификационные признаки метрологически значимой части ПО спектрометров модификаций S500 и S502

Идентификационные данные		Значения	
Идентификационное наименование ПО	MVCG.exe	MVCGSA.dll	WINVDM.exe
Номер версии ПО	3.3.0.2435 ¹⁾	не указан	3.3.0.2435 ¹⁾
Цифровой идентификатор ПО (по MD5)	493A2F4CA25B662D 98036904EC583891 ²⁾	19741EE5E98D63499 68FE7D1DB46093C ²⁾	60DBDB5B0D3CB2D32 ABEDB03DD39201E ²⁾
Дата	18.03.2013 ²⁾ и позднее	18.03.2013 ²⁾ и позднее	18.03.2013 ²⁾ и позднее
Примечания: 1. Номер версии программного обеспечения не ниже указанного в таблице. 2. Контрольная сумма и дата создания файлов относятся к текущей версии программного обеспечения.			

Уровень защиты программного обеспечения спектрометров от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний», согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Основные технические характеристики спектрометров OSPREY-NS приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование характеристики	Значение
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения, кэВ:	от 40 до 3000
Число каналов в спектре	2048
Пределы допускаемой относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность), %	±2,0
Относительное энергетическое разрешение для гамма – излучения радионуклида ^{137}Cs с энергией 661,7 кэВ, %, не более:	
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-2Х2;	8,5
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-2x2W;	9,0
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-3x3;	7,5
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-3x3W;	9,0
• для варианта исполнения с блоком детектирования LABR-1.5X1.5	3,0
Максимальная входная статистическая загрузка, с^{-1} , не менее	$5 \cdot 10^4$
Время установления рабочего режима, мин, не более	30
Нестабильность градуировочной характеристики преобразования за 8 ч непрерывной работы (после установления рабочего режима), %, не более	±2,0
Материал и размеры сцинтиллятора блока детектирования (диаметр x высота), мм:	
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-2Х2;	NaI(Tl), 51 x 51
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-2x2W;	NaI(Tl), 51 x 51
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-3x3;	NaI(Tl), 76 x 76
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-3x3W;	NaI(Tl), 76 x 76
• для варианта исполнения с блоком детектирования LABR-1.5X1.5	LaBr ₃ (Ce), 38 x 38
Размеры колодца сцинтиллятора блока детектирования (глубина x диаметр), мм:	
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-2x2W;	39 x 16
• для варианта исполнения с блоком детектирования 802-3x3W	54 x 16
Интерфейсы подключения к управляющему компьютеру:	USB 2.0, Ethernet
Питание спектрометра (без учета управляющего компьютера и периферийных устройств):	
• от интерфейса USB управляющего компьютера: напряжение, В;	5
потребляемая мощность, В·А, не более	2
• от интерфейса Ethernet PoE: напряжение, В;	48
потребляемая мощность, В·А, не более	3
• от сети переменного тока через инжектор PoE: напряжение, В;	от 90 до 240
потребляемая мощность, В·А, не более	30
Рабочие условия эксплуатации:	
• диапазон температур окружающего воздуха, °C;	от 10 до 35
• атмосферное давление, кПа, не более;	106,73
• относительная влажность окружающего воздуха (при температуре 30 °C без образования конденсата), %, не более	85

Наименование характеристики	Значение
Масса спектрометра (без учета защиты, управляющего компьютера и периферийных устройств), кг, не более	
• для варианта исполнения с блоками детектирования 802-2x2, 802-2x2W	1,1
• для варианта исполнения с блоками детектирования 802-3x3, 802-3x3W	2,1
• для варианта исполнения с блоком детектирования LABR-1.5x1.5	0,75
Габаритные размеры спектрометра (без учета защиты, управляющего компьютера и периферийных устройств), (длина x диаметр), мм	
• для варианта исполнения с блоками детектирования 802-2x2, 802-2x2W	295 x 62
• для варианта исполнения с блоками детектирования 802-3x3, 802-3x3W	332 x 83
• для варианта исполнения с блоком детектирования LABR-1.5x1.5	260 x 62
Средняя наработка на отказ, ч.	20000
Средний срок службы, лет, не менее	8

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации спектрометров OSPREY-NS и на пленочную этикетку, kleящуюся на корпус многоканального амплитудного анализатора.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки спектрометров OSPREY-NS указан в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Блок детектирования сцинтилляционный	<ul style="list-style-type: none"> • 802-2X2 • 802-2x2W • 802-3x3 • 802-3x3W • LABR-1.5X1.5 	1	1
Анализатор амплитуд импульсов многоканальный	Osprey™	1	
Экран-защита	727		2, 3
Базовое программное обеспечение Genie-2000	<ul style="list-style-type: none"> • S500 • S502 • S504 	1	1
Программное обеспечение Genie-2000 по анализу гамма-спектров	S501	1	2
Программное обеспечение Genie-2000 по контролю качества измерений	S505	1	2
Программное обеспечение Genie-2000 по интерактивной подгонке пиков	S506	1	2
Программное обеспечение расчёта калибровки по эффективности в полевых условиях ISOCS	S573	1	2
Программное обеспечение расчёта калибровки по эффективности для лабораторных геометрий LabSOCS	S574	1	2
Данные характеристики сцинтилляционного детектора	<ul style="list-style-type: none"> • ISXCLNA2 • ISXCLNA3 • ISXCLLA1 	1	2
Руководство по эксплуатации		1	

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Методика поверки	МП 2104-001-2015 «Спектрометры гамма – излучения сцинтилляционные Osprey-NS. Методика поверки»	1	
Руководство пользователя программного обеспечения		1	4
Компьютер		1	1, 2
Принтер		1	1, 2

Примечания:

- 1) – конкретная модель согласуется с заказчиком при заказе спектрометра;
- 2) – дополнительная поставка по согласованию с заказчиком;
- 3) – по согласованию с заказчиком допускается поставка защит или коллиматоров других типов;
- 4) – руководства пользователя на каждый поставляемый программный продукт.

Сведения о методиках (методах) измерений

CAN-GSP-ORY-001-РЭ. «Гамма - спектрометры сцинтилляционные OSPREY-NS. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к гамма – спектрометрам сцинтилляционным OSPREY-NS

1. ГОСТ 4.59-79 Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей.
2. ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия
3. ГОСТ 26874-86 Спектрометры энергий ионизирующих излучений. Методы измерения основных параметров.
4. Техническая документация компании Canberra Industries, Inc., США.

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.