

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» июля 2021 г. № 1498

Регистрационный № 66391-17

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Фотометры пламенные автоматические ФПА-2-01

Назначение средства измерений

Фотометры пламенные автоматические ФПА-2-01 (далее фотометры) предназначены для измерений массовой концентрации химических элементов (калия, кальция, натрия, лития или стронция по заказу) в растворах.

Описание средства измерений

Принцип действия фотометров основан на эмиссионном методе фотометрии пламени.

Раствор исследуемого элемента в виде аэрозоля вводится в пламя газовой горелки. Под действием тепловой энергии пламени возникает спектр излучения характерный для данного элемента. Спектральная линия этого элемента выделяется дифракционной решеткой и воспринимается линейкой из 512 фотоприемников. Сигнал с фотоприемников после усиления и обработки выводится на цифровое табло. Обработку текущей информации и управление работой фотометра осуществляют встроенная микро-ЭВМ.

Конструктивно фотометр состоит из двух блоков: оптико-электронного и компрессора. Компрессор обеспечивает подачу воздуха в горелку. В состав блока оптико-электронного входят: усилитель, микро-ЭВМ, устройство ввода-вывода, узел горелки и узел питания.

Заводской номер, обеспечивающий идентификацию каждого экземпляра средства измерений, печатается на индивидуальной этикетке методом термотрансферной печати и имеет цифровое обозначение.

Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид оптико-электронного блока фотометра ФПА-2-01

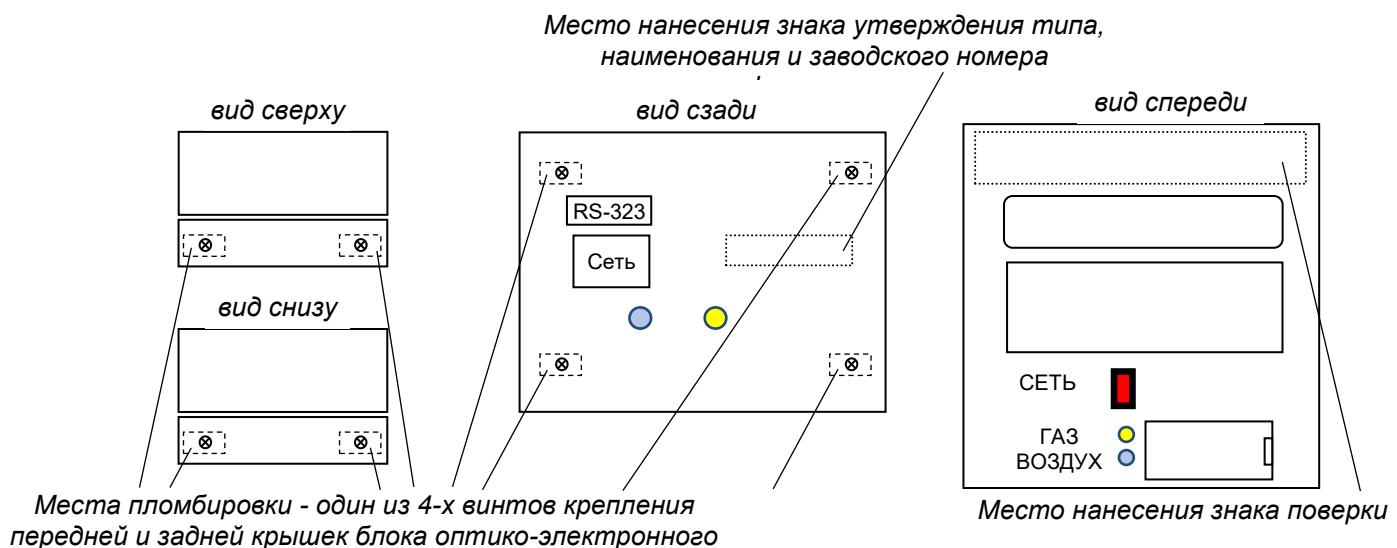


Рисунок 2 - Схема пломбировки оптико-электронного блока фотометров от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ФПА2-01 ЗОМЗ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V: 1.1
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма КС)	КС: 0x5EDD

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений массовой концентрации химических элементов, мг/дм ³ :	
Na;	от 0,5 до 23,0
Ca;	от 0,5 до 40,0
K;	от 0,2 до 40,0
Li или	от 0,1 до 4,0
Sr (по заказу)	от 2,5 до 200
Пределы допускаемой систематической составляющей приведенной погрешности к верхнему пределу диапазона измерений, %	±2,5
Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной составляющей приведенной погрешности к верхнему пределу диапазона измерений, %	1,5

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Горючий газ	пропан-бутан ГОСТ 20448-90
Время установления рабочего режима, мин., не более	30
Изменение показаний фотометра через 1 ч после установления рабочего режима, %, не более	±3
Параметры электрического питания:	
- напряжение переменного тока, В	220±22
- частота переменного тока, Гц	50,0±0,5
Диапазон длин волн, выделяемый дифракционной решеткой и линейкой фотоприемников, нм	от 350 до 950
Фотометр позволяет одновременно измерять концентрацию из одной пробы	до четырех элементов
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С;	от +10 до +35
- относительная влажность, %	от 30 до 80
Габаритные размеры блока оптико-электронного, мм, не более	
- длина	325
- ширина	210
- высота	445
Масса блока оптико-электронного, кг, не более	9
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	2500

Средний полный срок службы, лет, не менее	10
---	----

Знак утверждения типа

наносится на табличку, установленную на блоке оптико-электронном, фотоспособом, и на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество на изделие, шт.
Блок оптико-электронный	БШ 5.139.183	1
Насос-компрессор вакуумный мембранный МВНК-1,5х2М	ВН 2.960.002 ТУ	1
Трубопровод	БШ 6.453.012	1
Трубка	БШ 7.867.108-01	1
Трубка	БШ 7.867.109-01	1
Гайка	БШ 8.930.108	1
Трубка силиконовая медицинская 1×0,8	ТУ 9398-003-00152106-2005	1 (0,15 м)
Комплект принадлежностей		
Кожух	БШ 6.431.193	1
Газовая зажигалка Ø≤15 мм	—	3
Запасные части		
Трубка силиконовая медицинская 1×0,8	ТУ 9398-003-00152106-2005	1 (0,5 м)
Игла	БШ 7.051.014	2
Вставка плавкая ВПТ-2	ОЮ 0.481.021 ТУ	4
Документация		
Руководство по эксплуатации	БШ 2.850.230 РЭ	1
Паспорт	БШ 2.850.230 ПС	1
Методика поверки	БШ 2.850.230 МП	1
Программное обеспечение связи с внешней ЭВМ с комплектом документации*	БШ 2.850.230 ПО	1
Комплект упаковок БШ 4.170.868		
Ящик деревянный	БШ 4.164.516	1
Ящик из гофрированного картона	СТП БШ 6.876.564	1

* Поставляется по дополнительному требованию заказчика

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к фотометрам пламенным автоматическим ФПА-2-01

ГОСТ Р 8.735.0-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Основные положения.

ГОСТ Р 8.735.1-2014 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Передача единиц от государственного первичного эталона на основе кулонометрии.

Технические условия БШ 2.850.230 ТУ. Фотометр пламенный автоматический ФПА-2-01.