

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАСХОДОМЕТРИИ –  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ  
им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»  
ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора филиала

ВНИИР – филиала ФГУП «ВНИИМ  
им.Д.И.Менделеева»



А. С. Тайбинский

2020 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ ВЗЛЕТ ТСРВ

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 0832-1-2018

с изменением № 1

Начальник научно-исследовательского отдела

Р.А. Корнеев

Тел. отдела: 8 (843) 272-12-02

г. Казань  
2020

Настоящая инструкция распространяется на тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ (далее – тепловычислитель), предназначенные для измерений тепловой энергии теплоносителя, интервалов времени и преобразования входных сигналов в значение единиц объемного и массового расхода, объема и массы, температуры, разности температуры, давления теплоносителя, температуры окружающего воздуха и электрической энергии и устанавливает методику, а также последовательность их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками – 4 года.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (пункт 6.1);
- опробование (пункт 6.2);
- подтверждение соответствия программного обеспечения (пункт 6.3);
- определение метрологических характеристик (пункт 6.4).

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- рабочий эталон единицы времени и частоты 4 разряда согласно ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 31.07.2018 № 1621 (далее – эталон частоты);
- рабочий эталон единицы электрического сопротивления постоянного тока 3 разряда согласно ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 № 3456 (далее – эталон сопротивления);
- рабочий эталон единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда согласно ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 01.10.2018 № 2091 (далее – эталон силы тока)
- комплекс поверочный «ВЗЛЕТ КПИ» (регистрационный номер 14510-12) (далее – КПИ);
- секундомер электронный «Интеграл С-01» (регистрационный номер 44154-16) (далее – секундомер).

**2.1 (Измененная редакция, Изм. №1)**

**2.2 (Исключен, Изм. №1)**

**2.3 (Исключен, Изм. №1)**

2.4 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемого СИ, с требуемой точностью.

2.5 Эталоны и (или) средства измерений, применяемые в качестве средств поверки, должны быть аттестованы и (или) поверены в установленном порядке.

## 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки соблюдают требования:

- действующие на объекте, на котором производится поверка;
- правил безопасности при эксплуатации средств поверки и поверяемого средства измерения, приведенных в их эксплуатационных документах;
- инструкций по охране труда, действующих на объекте;
- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, руководство по эксплуатации тепловычислителя и эксплуатационные документы на средства поверки, применяемые при поверке и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.3 К средствам поверки и используемому при поверке оборудованию обеспечивают свободный доступ. При необходимости предусматривают лестницы и площадки, соответствующие требованиям безопасности.

3.4 Освещенность должна обеспечивать отчетливую видимость для снятия показаний с применяемых средств поверки.

#### 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия окружающей среды:

- температура воздуха, °C от плюс 15 до плюс 40;
  - относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
  - атмосферное давление, кПа от 86 до 107;

4.2 Проверку тепловычислителя допускается проводить одновременно по всем каналам измерений тепловычислителя.

4.3 На основании письменного заявления владельца тепловычислителя допускается проведение поверки тепловычислителя по отдельным каналам измерений (канал преобразования импульсного сигнала в значение объема и объемного расхода теплоносителя; канал преобразования токового сигнала в значение объемного расхода теплоносителя; канал измерений температуры теплоносителя; канал измерений давления теплоносителя; канал измерений электрической энергии; канал измерений количества тепловой энергии и тепловой мощности) и в меньшем диапазоне измерений, определяющем применение тепловычислителя. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте тепловычислителя.

## **5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ**

## 5.1 При подготовке к поверке выполняют следующие работы:

- проверяют выполнение условий разделов 2 – 4 настоящей инструкции;
  - проверяют наличие действующих свидетельств об аттестации эталонов и наличие действующих свидетельств о поверке или оттисков поверительного клейма средств поверки.

5.2 При проведении поверки тепловычислителя с помощью КПИ или эталонов единицы частоты, сопротивления, силы тока подготовку к поверке выполняют в следующей последовательности:

- подготавливают к работе средства поверки и поверяемый тепловычислитель в соответствии с их эксплуатационными документами;
  - переводят тепловычислитель в режим «проверка» посредством переключения перемычки отвечающей за данную функцию в соответствии с эксплуатационными документами на тепловычислитель;
  - производят подключение тепловычислителя в соответствии с Приложением А;

### **5.1.5.3 (Изменение ведомства, Иам №1)**

#### **6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ**

## 6.1. Внешний самолёт

6.1 Внешний осмотр  
Визуальным осмотром проверяют отсутствие механических повреждений

влияющих на работоспособность тепловычислителя, внешний вид и места нанесения маркировки, предусмотренные в эксплуатационных документах.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если отсутствуют механические повреждения, влияющие на работоспособность тепловычислителя, внешний вид, комплектность и маркировка соответствуют требованиям эксплуатационных документов.

## 6.2 Опробование

При опробовании проверяют работоспособность органов управления тепловычислителя, а также наличие коммуникационной связи с персональным компьютером (далее – ПК) и индикации измеряемых параметров на индикаторе тепловычислителя и (или) на экране ПК.

При опробовании тепловычислителей на измерительные каналы тепловычислителя последовательно подают электрические сигналы (имитационные воздействия), соответствующие диапазонам измерений тепловычислителя посредством КПИ или эталонов единицы частоты, сопротивления, силы тока. Тепловычислитель переводят в режим индикации измеряемого параметра (объемного расхода, температуры, давления). При изменении значений имитирующего воздействия показания на индикаторе и (или) на мониторе ПК должны изменяться соответственно.

Результаты опробования тепловычислителя считают положительными, если при подаче на измерительные каналы тепловычислителя соответствующих имитационных воздействий (импульсная последовательность и(или) сила тока и(или) электрическое сопротивление) на индикаторе тепловычислителя и(или) на экране ПК наблюдается наличие соответствующего измеряемого параметра, органы управления функционируют.

## 6.2 (Измененная редакция, Изм. №1)

### 6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Для подтверждения соответствия программного обеспечения (далее – ПО) тепловычислителя по встроенному индикатору необходимо:

- посредством навигационных клавиш перейти в меню «О приборе» и нажать «Enter», на индикаторе тепловычислителя будут отображены идентификационное наименование ПО и номер версии (идентификационный номер) ПО.
- посредством навигационных клавиш перейти к пункту «К/С» (контрольная сумма), на индикаторе тепловычислителя будет отображен цифровой идентификатор (контрольная сумма) ПО;

Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считают положительным, если полученные идентификационные данные программного обеспечения тепловычислителя (идентификационное наименование ПО и номер версии (идентификационный номер) ПО и цифровой идентификатор (контрольная сумма) ПО) соответствуют идентификационным данным, указанным в паспорте и описании типа тепловычислителя.

## 6.4 Определение метрологических характеристик.

6.4.1 Определение относительной погрешности тепловычислителя при преобразовании частотно-импульсных сигналов в значение объема теплоносителя.

Производят подключение модуля формирователя импульсного сигнала КПИ или эталона частоты в соответствии с эксплуатационными документами на КПИ или эталон частоты и тепловычислитель. Тепловычислитель устанавливают в режим индикации объема. В соответствии с руководством по эксплуатации тепловычислителя устанавливают значение константы преобразования импульсного входа равной 1 имп/м<sup>3</sup>.

С помощью КПИ или эталона частоты задают импульсную последовательность состоящую из не менее чем 2000 импульсов с частотой генерации 0,1·Fнаиб, 0,3·Fнаиб, 0,9·Fнаиб, где Fнаиб максимально допустимое значение частоты подаваемой на импульсные входы в соответствии с руководством по эксплуатации тепловычислителя. Значения частоты генерации импульсной последовательности устанавливают с допуском не более  $\pm 10\%$ . При каждом значении частоты генерации импульсной последовательности выполняют не менее двух измерений.

Значение действительного объема теплоносителя  $V_3$ , дм<sup>3</sup>, вычисляют по формуле:

$$V_{3ij} = \frac{N_{ij}}{K_{np}} \quad (1)$$

- где  $N$  – количество импульсов, воспроизведенное КПИ или эталоном частоты, имп;
- $K_{np}$  – константа преобразования импульсного входа тепловычислителя (при проверке устанавливают равной 1 имп/дм<sup>3</sup>), имп/дм<sup>3</sup>;
- $ij$  – номер измерения и точки соответственно.

Относительную погрешность тепловычислителя при преобразовании импульсного сигнала в значение объема теплоносителя,  $\delta_V$ , %, вычисляют по формуле:

$$\delta_{V_{ij}} = \frac{V_{men\ ij} - V_{3ij}}{V_{3ij}} \cdot 100 \quad (2)$$

- где  $V_{men}$  – значение объема теплоносителя по показаниям тепловычислителя, дм<sup>3</sup> (определяют по показаниям индикатора тепловычислителя или монитору ПК).

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.1 считают положительными, если относительная погрешность тепловычислителя при преобразовании импульсного сигнала в значение объема теплоносителя определенная при каждом измерении не превышает  $\pm 0,1\%$ .

Метрологические характеристики тепловычислителя при преобразовании частотно-импульсных сигналов в значение объемного расхода принимают равными метрологическим характеристикам тепловычислителя при преобразовании частотно-импульсных сигналов в значение объема теплоносителя.

#### 6.4.2 Определение приведенной к диапазону измерений погрешности тепловычислителя при преобразовании токового сигнала в значение объемного расхода теплоносителя.

Производят подключение модуля формирователя постоянного тока КПИ или эталона силы тока в соответствии с эксплуатационными документами на КПИ или эталон силы тока и тепловычислитель. Тепловычислитель устанавливают в режим индикации расхода. С помощью КПИ или эталона силы тока задают значения тока, соответствующие диапазону измерений силы тока тепловычислителя. Проверку проводят при трех значениях силы тока: 0,1 от верхнего значения диапазона измерений силы тока, если токовые входы тепловычислителя настроены в диапазоне значений 0 – 20 и 0 – 5 мА, или 1,1 от нижнего значения диапазона измерений силы тока, если токовые входы тепловычислителя настроены в диапазоне значений 4 – 20 мА, 0,5 от верхнего значения диапазона измерений силы тока и 0,9 от верхнего значения диапазона измерений силы тока (диапазон измерений силы тока определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя). Значения силы тока устанавливают с допуском не более  $\pm 10\%$ .

Проверочные точки, соответствующие вышеуказанным значениям силы тока, допускается выбирать в произвольном порядке. При каждом значении силы тока проводят не менее трех измерений и регистрируют показания тепловычислителя. При каждом измерении вычисляют действительные значения объемного расхода,  $Q_{T_3}$ , м<sup>3</sup>/ч, по формуле:

$$Q_{T_3 ij} = Q_{hn} + (Q_{en} - Q_{hn}) \cdot \frac{(I_{3 ij} - I_{наим})}{(I_{наиб} - I_{наим})} \quad (3)$$

- где  $I_3$  — значение силы тока, воспроизведенное КПИ или эталоном силы тока, мА;  
 $I_{наиб}$  — наибольшее значение силы тока токового выхода тепловычислителя (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя);  
 $I_{наим}$  — наименьшее значение силы тока токового выхода тепловычислителя (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя);  
 $Q_{en}$  — наибольшее значение объемного расхода, м<sup>3</sup>/ч (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя);  
 $Q_{hn}$  — наименьшее значение объемного расхода, м<sup>3</sup>/ч (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя).

Приведенную к диапазону измерений погрешность тепловычислителя при преобразовании токового сигнала в значение объемного расхода теплоносителя  $\gamma_{Q_T}$ , %, вычисляют по формуле:

$$\gamma_{Q_T} = \frac{Q_{Tij} - Q_{T3ij}}{Q_{en} - Q_{hn}} \cdot 100 \quad (4)$$

- где  $Q_T$  — значение объемного расхода теплоносителя по показаниям тепловычислителя, м<sup>3</sup>/ч (определяют по показаниям индикатора тепловычислителя или монитору ПК).

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.2 считают положительными, если приведенная к диапазону измерений погрешность тепловычислителя при преобразовании токового сигнала в значение объемного расхода теплоносителя не превышает пределов  $\pm 0,5\%$ .

#### 6.4.3 Определение абсолютной погрешности при преобразовании сигналов электрического сопротивления в значение температуры.

Производят подключение модуля формирователя сигналов сопротивления КПИ или эталона сопротивления к тепловычислителю в соответствии с эксплуатационными документами на КПИ или эталон сопротивления и тепловычислитель. Тепловычислитель устанавливают в режим индикации температуры теплоносителя и окружающего воздуха. С помощью КПИ или эталона сопротивления на каждый канал измерения температуры устанавливают значения электрического сопротивления, соответствующие температуре,  $t_d$ , °C: минус ( $50 \pm 3$ ), от плюс 3 до плюс 5, плюс ( $30 \pm 3$ ), плюс ( $70 \pm 5$ ), от плюс 175 до плюс 180 для тепловычислителей, применяемых в водяных системах теплоснабжения и минус ( $50 \pm 3$ ), плюс ( $180 \pm 10$ ), плюс ( $240 \pm 15$ ), от плюс 285 до плюс 300 для тепловычислителей, применяемых в паровых системах теплоснабжения. Проверочные точки, соответствующие вышеуказанным температурам, допускается выбирать в произвольном порядке.

При каждом значении температуры проводят не менее трех измерений и регистрируют показания тепловычислителя. Значения необходимого электрического

сопротивления вычисляют в соответствии с формулами (5) и (или) (6) настоящей инструкции в зависимости от диапазона.

Значение электрического сопротивления  $R_t$ , Ом, для положительного диапазона измерений температуры, вычисляют по формуле:

$$R_{tij} = R_0 \cdot (1 + A \cdot t_{Dij} + B \cdot t_{Dij}^2) \quad (5)$$

- где  $R_t$  – значение электрического сопротивления соответствующее заданной температуре  $t_D$ , Ом;
- $R_0$  – номинальное электрическое сопротивление термопреобразователя сопротивления при температуре 0 °C, Ом (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя);
- $t_D$  – действительные значение температуры теплоносителя, °C;
- $A, B$  – значение постоянных коэффициентов (определяют в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 6651-2009).

Значение электрического сопротивления  $R_t$ , Ом, для диапазона измерений температуры от минус 50 до 0 °C вычисляют по формуле:

$$R_{tij} = R_0 \cdot [1 + A \cdot t_{Dij} + B \cdot t_{Dij}^2 + C \cdot (t_{Dij} - 100°C) \cdot t_{Dij}^3] \quad (6)$$

- где  $C$  – значение постоянного коэффициента (определяют в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ 6651-2009).

Абсолютную погрешность тепловычислителя при преобразовании электрического сопротивления в значение температуры теплоносителя и окружающего воздуха,  $\Delta_t$ , °C, вычисляют по формуле:

$$\Delta_{tij} = t_{u ij} - t_{D ij} \quad (7)$$

- где  $t_u$  – значение температуры теплоносителя по показаниям тепловычислителя, °C.

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.3 считают положительными, если абсолютная погрешность тепловычислителя при преобразовании электрического сопротивления в значение температуры теплоносителя и окружающего воздуха не превышает пределов  $\pm 0,1$  °C.

#### 6.4.4 Определение абсолютной погрешности при преобразовании разности сигналов электрического сопротивления в значение разности температур

Производят подключение модуля формирователя сигналов сопротивления КПИ или эталона сопротивления к тепловычислителю в соответствии с эксплуатационными документами на КПИ или эталон сопротивления и тепловычислитель. Тепловычислитель устанавливают в режим индикации температуры теплоносителя. С помощью КПИ или эталона сопротивления одновременно последовательно на два канала измерения температуры теплоносителя устанавливают значения электрического сопротивления, соответствующие температурам, указанным в таблице 1. Проверочные точки, соответствующие вышеуказанным температурам, допускается выбирать в произвольном порядке. Значения необходимого сопротивления вычисляют в соответствии с формулой (5) настоящей инструкции. При каждом значении температуры проводят не менее трех измерений, регистрируют показания тепловычислителя и вычисляют абсолютную погрешность тепловычислителя при преобразовании разности электрического сопротивления в значение разности температур теплоносителя,  $\Delta\Theta$ , °C, по формуле:

$$\Delta\Theta_{ij} = (t_{D(X)ij} - t_{D(Y)ij}) - (t_{u(X)ij} - t_{u(Y)ij}) \quad (8)$$

- где  $t_{D(X)}$  – действительное значение температуры теплоносителя в нечетном канале измерения температуры, °C;  
 $t_{D(Y)}$  – действительное значение температуры теплоносителя в четном канале измерения температуры, °C;  
 $t_{u(X)}$  – измеренное значение температуры теплоносителя в нечетном канале измерения температуры, °C;  
 $t_{u(Y)}$  – измеренное значение температуры теплоносителя в четном канале измерения температуры, °C.

Примечание: количество каналов измерения температуры теплоносителя определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя.

Таблица 1

Номер точки	В качестве теплоносителя используется вода			В качестве теплоносителя используется пар		
	$t_{D(X)} (t_{u(X)})$ , °C	$t_{D(Y)} (t_{u(Y)})$ , °C	$t_{D(X)} - t_{D(Y)}$ , °C	$t_{D(X)} (t_{u(X)})$ , °C	$t_{D(Y)} (t_{u(Y)})$ , °C	$t_{D(X)} - t_{D(Y)}$ , °C
1	от 175 до 180	от 3 до 8	от 172 до 177	от 295 до 300	$180 \pm 5$	120
2	$70 \pm 5$	$60 \pm 5$	от 10 до 20	от 295 до 300	$240 \pm 5$	60
3	$30 \pm 3$	$27 \pm 3$	от 3 до 3,6	от 240 до 245	от 180 до 185	60

Примечание: допускается использовать данные измерений, выполненных попарно в соответствии с пунктом 6.4.3 настоящей инструкции.

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.4 считают положительными, если абсолютная погрешность тепловычислителя при преобразовании разности сигналов электрического сопротивления в значение разности температур теплоносителя не превышает  $\pm 0,03$  °C.

#### 6.4.1-6.4.4 (Измененная редакция, Изм. №1)

6.4.5 Определение приведенной к диапазону измерений погрешности тепловычислителя при преобразовании токового сигнала в значение давления теплоносителя.

Производят подключение модуля формирователя постоянного тока КПИ или эталона силы тока в соответствии с эксплуатационными документами на КПИ или эталон силы тока и тепловычислитель. Тепловычислитель устанавливают в режим индикации давления. С помощью КПИ или эталона силы тока задают значения тока, соответствующие диапазону измерений силы тока тепловычислителя. Проверку проводят при трех значениях силы тока: 0,1 от верхнего значения диапазона измерений силы тока, если токовые входы тепловычислителя настроены в диапазоне значений 0 – 20 и 0 – 5 mA, или 1,1 от нижнего значения диапазона измерений силы тока, если токовые входы тепловычислителя настроены в диапазоне значений 4 – 20 mA, 0,5 от верхнего значения диапазона измерений силы тока и 0,9 от верхнего значения диапазона измерений силы тока (диапазон измерений силы тока определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя). Значения силы тока устанавливают с допуском не более  $\pm 10\%$ . Проверочные точки, соответствующие вышеуказанным значениям силы тока, допускается выбирать в произвольном порядке. При каждом значении силы тока проводят не менее трех измерений, регистрируют показания тепловычислителя и вычисляют действительное значение давления  $P_e$ , МПа, по формуле:

$$P_{eij} = P_{nn} + (P_{en} - P_{nn}) \cdot \frac{(I_{P_{eij}} - I_{P_{naim}})}{(I_{P_{naib}} - I_{P_{naim}})} \quad (9)$$

- где  $I_{P_3}$  – значение силы тока воспроизведенное эталоном силы тока, мА;  
 $I_{P_{наиб}}$  – наибольшее значение силы тока токового выхода тепловычислителя (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя);  
 $I_{P_{наим}}$  – наименьшее значение силы тока токового выхода тепловычислителя (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя);  
 $P_{en}$  – наибольшее значение давления теплоносителя, МПа (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя);  
 $P_{nn}$  – наименьшее значение давления теплоносителя, МПа (определяют в соответствии с паспортом тепловычислителя);

Приведенную к диапазону измерений погрешность тепловычислителя при преобразовании токового сигнала в значение давления теплоносителя  $\gamma_P$ , %, вычисляют по формуле:

$$\gamma_{P_{ij}} = \frac{P_{u_{ij}} - P_{\vartheta_{ij}}}{P_{en} - P_{nn}} \cdot 100 \quad (10)$$

- где  $P_u$  – значение давления теплоносителя по показаниям тепловычислителя, МПа.

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.5 считают положительными, если приведенная к диапазону измерений погрешность тепловычислителя при преобразовании токового сигнала в значение давления теплоносителя не превышает пределов  $\pm 0,5 \%$ .

#### 6.4.6 Определение относительной погрешности тепловычислителя при преобразовании количества импульсов в значения электрической энергии.

Производят подключение модуля формирователя импульсного сигнала КПИ или эталона частоты в соответствии с эксплуатационными документами на КПИ или тепловычислитель. Тепловычислитель устанавливают в режим индикации электрической энергии, константу преобразования импульсного входа устанавливают равной 1 имп/кВт·ч. С помощью КПИ или эталона частоты задают импульсную последовательность состоящую из не менее чем 2000 импульсов с частотой генерации  $0,05 \cdot F_{наиб}$ ,  $0,5 \cdot F_{наиб}$ ,  $0,9 \cdot F_{наиб}$ , где  $F_{наиб}$  максимально допустимое значение частоты подаваемой на импульсные входы в соответствии с руководством по эксплуатации тепловычислителя. Значения частоты устанавливают с допуском не более  $\pm 10 \%$ . Проверочные точки, соответствующие вышеуказанным значениям частот генерации, допускается выбирать в произвольном порядке. При каждом значении частоты генерации проводят не менее трех измерений, регистрируют показания тепловычислителя и вычисляют действительное значение электрической энергии,  $W_3$ , кВт·ч, по формуле:

$$W_{\vartheta_{ij}} = \frac{N_{ij}}{K_{np3}} \quad (11)$$

- где  $K_{np3}$  – константа преобразования импульсного входа тепловычислителя (при проведении поверки принимают равным 1 имп/кВт·ч), имп/кВт·ч.

Относительную погрешность тепловычислителя при преобразовании количества импульсов в значение электрической энергии  $\delta_W$ , %, вычисляют по формуле:

$$\delta_{W_{ij}} = \frac{W_{u_{ij}} - W_{\vartheta_{ij}}}{W_{\vartheta_{ij}}} \cdot 100 \quad (12)$$

где  $W_u$  – значение электрической энергии по показаниям тепловычислителя, кВт·ч.

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.6 считают положительными, если относительная погрешность тепловычислителя при преобразовании количества импульсов в значение электрической энергии не превышает  $\pm 0,2\%$ .

Метрологические характеристики тепловычислителя при преобразовании количества импульсов в значение электрической мощности принимают равными метрологическим характеристикам тепловычислителя при преобразовании количества импульсов в значение электрической энергии.

#### 6.4.7 Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии.

Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в однотрубных закрытых системах теплоснабжения проводят в соответствии с пунктом 6.4.7.1 настоящей инструкции. Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения, состоящих из двух и более труб, проводят в соответствии с пунктом 6.4.7.2 настоящей инструкции.

##### 6.4.7.1 Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в однотрубных системах теплоснабжения

При определении относительной погрешности тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в однотрубных системах теплоснабжения производят подключение модулей формирователей импульсного сигнала, сигнала сопротивления, сигнала постоянного тока КПИ или эталонов частоты, сопротивления, силы тока к тепловычислителю в соответствии с их эксплуатационными документами. Тепловычислитель устанавливают в режим индикации тепловой энергии, константу преобразования импульсного входа тепловычислителя устанавливают равной 1 имп/дм<sup>3</sup>. С помощью КПИ или эталонов сопротивления и силы тока задают значения электрического сопротивления и силы тока, соответствующие температуре и давлению указанным в таблице 2. Значение силы тока, соответствующее заданной величине давления, вычисляют в соответствии с формулой (13) настоящей инструкции. Значение электрического сопротивления вычисляют в соответствии с формулой (5) настоящей инструкции. С помощью КПИ или эталона частоты задают импульсную последовательность, состоящую из не менее чем 2000 импульсов с частотой генерации 100 Гц. Значения частоты генерации импульсной последовательности устанавливают с допуском не более  $\pm 10\%$ . При каждом значении температуры теплоносителя выполняют не менее трех измерений.

Таблица 2

Проверочная точка	Давление*, МПа	Температура теплоносителя, °C (для водяных систем теплоснабжения)	Температура теплоносителя, °C (для паровых систем теплоснабжения)
1		30 $\pm$ 3	180 $\pm$ 5
2	0,2; 1,6	70 $\pm$ 5	240 $\pm$ 5
3		от 175 до 180	от 295 до 300

\* – давление равное значению 1,6 МПа устанавливают при использовании в водяных системах теплоснабжения, 0,2 МПа при использовании в паровых системах теплоснабжения.

Значение силы тока, соответствующее заданной величине давления  $I$ , мА, вычисляют по формуле:

$$I = \frac{I_{P_{\text{наим}}} \cdot (P_{ycm} - P_{an}) - I_{P_{\text{наиб}}} \cdot (P_{ycm} - P_{nn})}{P_{nn} - P_{an}} \quad (13)$$

где  $P_{ycm}$  – значение давления предполагаемого теплоносителя определенное в соответствии с таблицей 2, МПа.

Значение давления теплоносителя 1,6 (0,2) МПа допускается устанавливать посредством ручного (программного) ввода в параметрах настройки тепловычислителя (алгоритм установки параметров указан в руководстве по эксплуатации тепловычислителя).

На основании заданных, согласно таблице 2 значений температуры и давления определяют плотность и энталпию теплоносителя в соответствии с документом ГСССД МР 147-2008 «Расчет плотности, энталпии, показателя адиабаты и коэффициента динамической вязкости воды и водяного пара при температурах 0...1000 °C и давлениях 0,0005...100 МПа на основании таблиц стандартных справочных данных ГСССД 187-99 и ГСССД 6-89».

Регистрацию показаний тепловычислителя проводят по истечению 90 секунд после завершения каждого измерения.

Перед каждым новым измерением в проверочной точке производят регистрацию начального значения количества тепловой энергии  $W_n$ , ГДж, по показаниям тепловычислителя.

После окончания каждого измерения регистрируют конечное значение количества тепловой энергии,  $W_k$ , ГДж, по показаниям тепловычислителя.

Измеренное значение количества тепловой энергии  $W_{Tij}$ , ГДж, вычисляют по формуле:

$$W_{Tij} = W_{kij} - W_{nij} \quad (14)$$

При каждом измерении определяют действительное значение количества тепловой энергии,  $W_d$ , ГДж, по формуле:

$$W_{dij} = \frac{h_{ij} \times \rho_{ij} \times N_{ij}}{K_p} \quad (15)$$

где  $h_{ij}$  – значение энталпии предполагаемого теплоносителя в  $j$ -той проверочной точке, ГДж/кг (определяют в соответствии с ГСССД МР 147-2008);  
 $K_p$  – константа преобразования импульсного входа тепловычислителя (принимают равной 1 имп/дм<sup>3</sup>), имп/дм<sup>3</sup>;  
 $\rho$  – плотность предполагаемого теплоносителя в  $j$ -той проверочной точке, кг/дм<sup>3</sup> (определяют в соответствии с ГСССД МР 147-2008).

Относительную погрешность тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в однотрубных системах теплоснабжения  $\delta_{WT}$ , %, вычисляют по формуле:

$$\delta_{WTij} = \frac{W_{Tij} - W_{dij}}{W_{dij}} \cdot 100 \quad (16)$$

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.7.1 считают положительными, если относительная погрешность тепловычислителя при измерении

количества тепловой энергии в однотрубных системах теплоснабжения не превышает пределов  $\pm 0,5\%$ .

Метрологические характеристики тепловычислителя при измерении тепловой энергии принимают равными метрологическим характеристикам тепловычислителя при измерении тепловой мощности.

6.4.7.2 Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в системах теплоснабжения, состоящих из двух и более труб

При определении относительной погрешности тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в системах теплоснабжения, состоящих из двух и более труб, производят подключение модулей формирователей импульсного сигнала, сигнала сопротивления, сигнала постоянного тока КПИ или эталонов частоты, сопротивления, силы тока к тепловычислителю в соответствии с их эксплуатационными документами. Тепловычислитель устанавливают в режим индикации тепловой энергии, константу преобразования импульсного входа тепловычислителя устанавливают равной 1 имп/дм<sup>3</sup>. В соответствии с руководством по эксплуатации в тепловычислителе устанавливают алгоритм расчета количества тепловой энергии в *n*-ой системе теплоснабжения  $W_{TC}$ , ГДж, в соответствии с формулой:

$$W_{TC} = M_{(X)} \cdot (h_{(X)} - h_{(Y)}) \quad (17)$$

где  $M_{(X)}$  – масса теплоносителя измеренная в системе теплоснабжения, кг.  
 $h_{D(X)}$ ; – значение энталпии теплоносителя в нечетном канале измерения температуры, ГДж/кг (определяют в соответствии с ГСССД МР 147-2008);  
 $h_{D(Y)}$  – значение энталпии теплоносителя в четном (*n*+1) канале измерения температуры, ГДж/кг (определяют в соответствии с ГСССД МР 147-2008);

С помощью КПИ или эталонов сопротивления и силы тока задают значения электрического сопротивления и силы тока, соответствующие температурам, указанным в таблице 1 и давлению равному 1,6 МПа при использовании в водяных системах теплоснабжения и 0,2 МПа при использовании в паровых системах теплоснабжения. Значение силы тока, соответствующее заданной величине давления, вычисляют в соответствии с формулой (13) настоящей инструкции. Значение электрического сопротивления вычисляют в соответствии с формулой (5) настоящей инструкции. С помощью КПИ или эталона частоты задают импульсную последовательность, состоящую из не менее чем 2000 импульсов с частотой генерации 100 Гц. Значения частоты генерации импульсной последовательности устанавливают с допуском не более  $\pm 10\%$ . При каждом значении температуры теплоносителя выполняют не менее трех измерений.

Значение давления теплоносителя 1,6 (0,2) МПа допускается устанавливать посредством ручного (программного) ввода в параметрах настройки тепловычислителя (алгоритм установки параметров указан в руководстве по эксплуатации тепловычислителя).

На основании заданных согласно таблице 1 значений температуры и установленного значения давления теплоносителя определяют плотность и энталпию теплоносителя в соответствии с документом ГСССД МР 147-2008 «Расчет плотности, энталпии, показателя адиабаты и коэффициента динамической вязкости воды и водяного пара при температурах 0...1000 С и давлениях 0,0005...100 МПа на основании таблиц стандартных справочных данных ГСССД 187-99 и ГСССД 6-89».

Регистрацию показаний тепловычислителя проводят по истечению 90 секунд после завершения каждого измерения.

Перед каждым новым измерением в проверочной точке производят регистрацию начального значения количества тепловой энергии  $W_h$ , ГДж, по показаниям тепловычислителя.

После окончания каждого измерения регистрируют конечное значение количества тепловой энергии  $W_k$ , ГДж, по показаниям тепловычислителя.

Измеренное значение количества тепловой энергии  $W_u$ , ГДж вычисляют по формуле (14) настоящей инструкции.

Действительное значение количества тепловой энергии  $W_d$ , ГДж, для тех же значений параметров теплоносителя вычисляют по формуле:

$$W_d = \frac{\rho_{(X)} \times N_{(X)} \times (h_{d(X)} - h_{d(Y)})}{K_p} \quad (18)$$

- где  $h_{d(X)}$  – значение энталпии предполагаемого теплоносителя в нечетном канале измерения температуры, ГДж/кг (определяют в соответствии с ГСССД МР 147-2008);  
 $h_{d(Y)}$  – значение энталпии предполагаемого теплоносителя в четном канале измерения температуры, ГДж/кг (определяют в соответствии с ГСССД МР 147-2008);  
 $N_{(X)}$  – количество импульсов, воспроизведенное КПИ или эталоном частоты и поступившее на импульсный вход нечетного канала измерения, имп;  
 $K_p$  – константа преобразования импульсного входа тепловычислителя (принимают равным значению 1 имп/дм<sup>3</sup>), имп/дм<sup>3</sup>;  
 $\rho_{(X)}$  – плотность предполагаемого теплоносителя в нечетном трубопроводе, кг/дм<sup>3</sup> (определяют в соответствии с ГСССД МР 147-2008).

Относительную погрешность тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в системах теплоснабжения, состоящих из двух и более труб, вычисляют по формуле (16) настоящей инструкции.

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.7.2 считают положительными, если относительная погрешность тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в системах теплоснабжения, состоящих из двух и более труб не превышает пределов  $\pm(0,5 + 3/\Delta t)$ .

Метрологические характеристики тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии принимают равными метрологическим характеристикам тепловычислителя при измерении тепловой мощности.

#### **6.4.7.1-6.4.7.2 (Измененная редакция, Изм. №1)**

6.4.7.3 При подтверждении метрологических характеристик тепловычислителей предназначенных для открытых систем теплоснабжения (в соответствии с паспортом) определяют относительную погрешность тепловычислителя при измерении количества тепловой энергии в соответствии с пунктами 6.4.7.1 и 6.4.7.2 настоящей инструкции.

Тепловычислитель считают пригодным для применения в открытых системах теплоснабжения, если он удовлетворяет требованиям, указанным в пунктах 6.4.7.1 и 6.4.7.2 настоящей инструкции.

6.4.7.4 При передаче и преобразовании данных, полученных с первичных преобразователей расхода, температуры, давления и электрической энергии посредством цифровых интерфейсов, определение метрологических характеристик тепловычислителей по пунктам 6.4.1-6.4.6, 6.4.7.1 и 6.4.7.2 данной инструкции не проводится.

Пределы допускаемой относительной погрешности при вычислении количества тепловой энергии и тепловой мощности принимают равными  $\pm 0,3\%$  для водяных систем

теплоснабжения в соответствии с МИ 2412-97 и  $\pm 0,19\%$  для паровых систем теплоснабжения в соответствии с МИ 2451-98.

#### 6.4.7.4 (Введен дополнительно, Изм. №1)

6.4.8 Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении интервалов времени.

Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении интервалов времени проводят в соответствии с пунктами 6.4.8.1 или 6.4.8.2. Допускается проводить определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении интервалов времени при выпуске из производства только в соответствии с пунктом 6.4.8.2.

6.4.8.1 Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении интервалов времени проводят путем сравнения выводимых на экран персонального компьютера показаний тепловычислителя и секундомера. Относительную погрешность определяют для интервала времени не менее 2400 с. На экран подключенного к тепловычислителю персонального компьютера выводят показания часов. На секундомере запускают режим измерения интервала времени. По окончании измерения фиксируют показания секундомера и тепловычислителя (персонального компьютера).

Относительную погрешность измерения интервалов времени вычисляют по формуле:

$$\delta_{BPij} = \frac{T_{BPij} - T_{\vartheta ij}}{T_{\vartheta ij}} \cdot 100 \quad (19)$$

где  $T_{BP}$  – интервал времени, измеренный тепловычислителем, с;  
 $T_{\vartheta}$  – интервал времени, измеренный секундомером, с.

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.8.1 считают положительными, если относительная погрешность при измерении интервалов времени не превышает пределов  $\pm 0,01\%$ .

#### 6.4.8.1 (Измененная редакция, Изм. №1)

6.4.8.2 Определение относительной погрешности тепловычислителя при измерении интервалов времени проводят посредством измерений частоты времязадающего кварцевого генератора тепловычислителя с применением частотомера. Для измерения частоты времязадающего кварцевого генератора тепловычислителя частотомер подключают к контрольным точкам ТР4-ТР5 на плате тепловычислителя и производят измерение частоты.

Результаты определения метрологических характеристик по пункту 6.4.8.2 считают положительными, если значение измеренной частоты времязадающего кварцевого генератора тепловычислителя составляет  $32768 \pm 3$  Гц.

Примечание: после завершения процедуры поверки необходимо восстановить первоначальные значения констант преобразования импульсных выходов тепловычислителя, указанных в его паспорте.

## 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом поверки произвольной формы.

Сведения о результатах поверки передают в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком проведения поверки средств измерений, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.2 При положительных результатах поверки по заявлению заказчика оформляют свидетельство о поверке тепловычислителя в соответствии с действующим законодательством РФ и (или) делают отметку в паспорте тепловычислителя о дате очередной поверки. Знак поверки наносят на свидетельство о поверке (при его наличии) и (или) в соответствующий раздел паспорта тепловычислителя, а также на пломбировочную мастику, установленную в соответствии с описанием типа тепловычислителя.

7.3 При отрицательных результатах поверки тепловычислитель к эксплуатации не допускают, свидетельство о поверке аннулируют, поверительные клейма уничтожают путем приведения их в состояние, не допускающее их дальнейшее применение, и по заявлению заказчика выдают извещение о непригодности к применению средства измерений с указанием причин в соответствии с действующим законодательством РФ.

**7.1-7.3 (Измененная редакция, Изм. №1)**

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема подключения тепловычислителя при проведении поверки  
с использованием КПИ и эталонов единиц частоты, сопротивления, силы тока  
(обязательное)

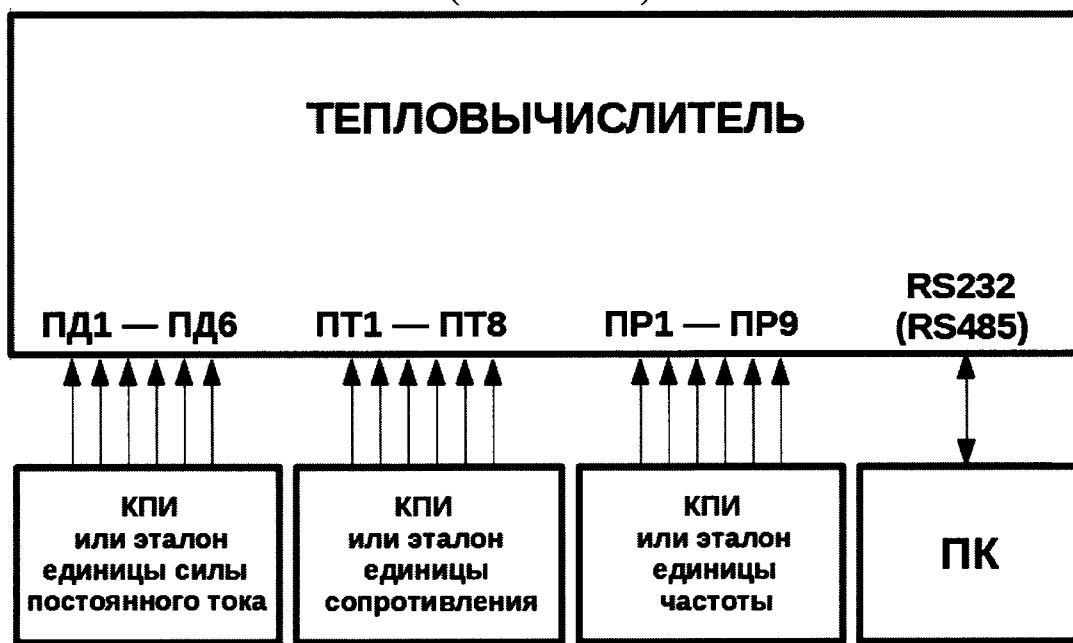


Рисунок А1

- где
- |         |                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПД1-ПД6 | — входы для подключения преобразователей давления                                                                                                |
| ПК      | — персональный компьютер                                                                                                                         |
| ПР1-ПР9 | — входы для подключения первичных преобразователей (преобразователи расхода, расходомеры, расходомеры-счетчики, счетчики электроэнергии и т.д.); |
| ПТ1-ПТ8 | — входы для подключения преобразователей температуры.                                                                                            |

Приложение А (Измененная редакция, Изм. №1)