

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «29» ноября 2024 г. № 2805

Регистрационный № 24321-13

Лист № 1
Всего листов 10

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]

Назначение средства измерений

Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К] предназначены для измерений массовой концентрации вредных веществ и объемной доли диоксида углерода в воздушных средах.

Описание средства измерений

Принцип действия трубок индикаторных модели ТИ-[ИК-К] – колористический: экспресс-метод, основанный на изменении окраски массы наполнителя ТИ при взаимодействии с определяемым газом и измерении длины прореагированного слоя. Длина прореагированного слоя является функцией преобразования определяемого газа и объема, отобранный на анализ пробы.

Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К] (далее – ТИ) являются измерительными преобразователями и представляют собой трубки из оптически прозрачного материала, заполненные сорбентом (индикаторным порошком), изменяющим оптические свойства под действием проникающих внутрь веществ. ТИ герметизируются путем запаивания их концов.

ТИ имеют 70 модификаций и обеспечивают измерение концентрации 35 различных газов и паров в газовой среде в различных диапазонах.

Для улавливания сопутствующих веществ, мешающих анализу, либо для образования с определяемым компонентом летучего продукта, индицируемого порошком, ТИ используются в комплекте с трубками фильтрующими (далее – ТФ). Независимо от состава воздуха использование ТИ в комплекте с ТФ, если это предусмотрено в технической документации, является обязательным во избежание нарушений условий их эксплуатации.

На ТИ нанесена шкала для прямого отсчета показаний, при наличии двух поддиапазонов измерений – две шкалы.

Для прокачивания пробы через ТИ используются аспираторы утвержденного типа поршневые или сильфонные (НП-3М, АМ-5Е, АМ-0059, УГ-2, Drager Accuro, Gastec model DV-100S(DV-110S), KITAGAVA модель АР-20 и др. аналогичные средства измерений).

Партия ТИ представляет собой трубки одной модификации, изготовленные с применением растворов, реагентов и исходных материалов одного приготовления и имеющие один номер.

Общий вид ТИ представлен на рисунке 1.

Конструкцией ТИ пломбировка корпуса не предусмотрена.

Номер партии наносится печатным способом в цифровом формате на каждую трубку и этикетку. Общий вид этикетки с указанием места нанесения номера партии приведен на рисунке 2.

Нанесение знака поверки на ТИ не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид ТИ

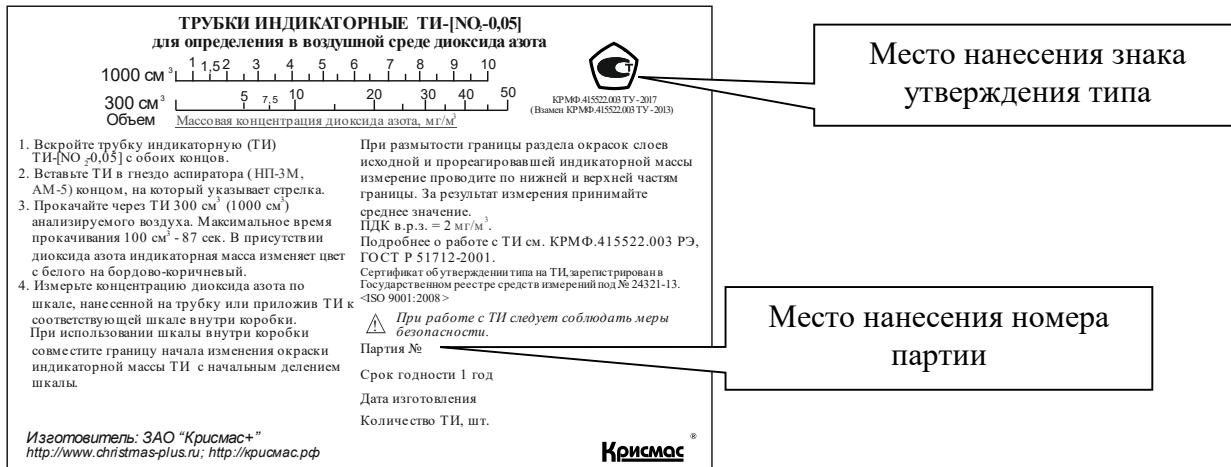


Рисунок 2 – Общий вид этикетки

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Определяемый компонент (ПДК, мг/м ³) ¹⁾	Обозначение модификаций ТИ-[ИК-К]	Диапазоны измерений массовой концентрации, мг/м ³	Назначение ²⁾
Аммиак (20)	ТИ-[NH ₃ -0,005]	от 0,2 до 5,0	В
Аммиак (20)	ТИ-[NH ₃ -0,1]	от 2 до 10 от 10 до 100	В К
Аммиак (20)	ТИ-[NH ₃ -1,0]	от 10 до 100 от 100 до 1000	К А

Продолжение таблицы 1

Определяемый компонент (ПДК, мг/м ³) ¹⁾	Обозначение модификации	Диапазоны измерений массовой концентрации, мг/м ³	Назначение ²⁾
Аммиак (20)	ТИ-[NH ₃ -2,0]	от 10 до 100 от 100 до 2000	К А
Ацетальдегид (5)	ТИ-[ацетальдегид-0,05]	от 1 до 50	К
Ацетальдегид (5)	ТИ-[ацетальдегид-0,1]	от 1 до 30 от 5 до 100	К А
Ацетальдегид (5)	ТИ-[ацетальдегид-2,0]	от 100 до 2000	А
Ацетилен	ТИ-[C ₂ H ₂ -1,2]	от 50 до 1200	В
Ацетилен	ТИ-[C ₂ H ₂ -5,0]	от 200 до 5000	В
Ацетон (800/200)	ТИ-[C ₃ H ₆ O-10,0]	от 100 до 1000 от 200 до 10000	К А
Бензин (300/100) (по гексану)	ТИ-[бензин-4,0]	от 50 до 200 от 200 до 4000	К А
Бензин (300/100) (по гексану)	ТИ-[бензин-6,0]	от 100 до 500 от 500 до 6000	К А
Бензол (15/5)	ТИ-[C ₆ H ₆ -0,03]	от 2 до 30	К
Бензол (15/5)	ТИ-[C ₆ H ₆ -1,5]	от 5 до 200 от 100 до 1500	К А
Бром (0,5)	ТИ-[бром-0,01]	от 0,25 до 10	К, А
Бром (0,5)	ТИ-[Br ₂ -0,01]	от 0,5 до 10	К, А
Бутанол (изобутанол) (30/10)	ТИ-[(i)-BuOH-0,2]	от 5 до 200	К, А
Бутанол (изобутанол) (30/10)	ТИ-[C ₄ H ₉ OH-0,3]	от 5 до 300	К, А
Гексан (300/100)	ТИ-[гексан-0,12]	от 10 до 120	В
Гексан (300/100)	ТИ-[гексан-0,3]	от 10 до 100 от 50 до 300	К, А
Диоксид азота (2)	ТИ-[NO ₂ -0,05]	от 1 до 10 от 5 до 50	К А
Диоксид азота (2)	ТИ-[NO ₂ -0,25]	от 1 до 10 от 10 до 250	К А
Диоксид серы (10)	ТИ-[диоксид серы-0,13]	от 1 до 10 от 10 до 130	К
Диоксид серы (10)	ТИ-[SO ₂ -0,13]	от 2 до 20 от 10 до 130	К
Диоксид серы (10)	ТИ-[SO ₂ -0,19]	от 2 до 20 от 10 до 190	К
Диоксид серы (10)	ТИ-[SO ₂ -2,5]	от 10 до 200 от 100 до 2500	К, А
Диоксид углерода	ТИ-[CO ₂ -2,0 % об.]	от 0,03 до 0,1 % (об.) от 0,1 до 2,0 % (об.)	В
Диоксид углерода	ТИ-[CO ₂ -10,0 % об.]	от 0,2 до 10 % (об.)	В

Продолжение таблицы 1

Определяемый компонент (ПДК, мг/м ³) ¹⁾	Обозначение модификации	Диапазоны измерений массовой концентрации, мг/м ³	Назначение ²⁾
Диоксид углерода	ТИ-[CO ₂ -30,0 % об.]	от 0,2 до 5 % (об.) от 5 до 30 % (об.)	В
Дизельное топливо (в пересчете на декан)	ТИ-[дизельное топливо-6,0]	от 200 до 6000	В
Диэтиловый эфир (900/300)	ТИ-[Et ₂ O-3,0]	от 100 до 500 от 500 до 3000	К А
Керосин (600/300 в пересчете на декан) ³⁾	ТИ-[керосин-4,0]	от 50 до 500 от 100 до 4000	К А
Ксиол (150/50)	ТИ-[ксиол-1,5]	от 5 до 100 от 100 до 1500	К А
Ксиол (150/50)	ТИ-[C ₈ H ₁₀ -1,5]	от 20 до 200 от 100 до 1500	К А
Метанол (15/5)	ТИ-[MeOH-0,3]	от 2 до 50 от 10 до 300	К А
Метанол (15/5)	ТИ-[MeOH-1,0]	от 20 до 1000	А
Озон (0,1)	ТИ-[O ₃ -0,003]	от 0,05 до 0,5 от 0,2 до 3,0	К А
Озон (0,1)	ТИ-[O ₃ -0,015]	от 0,05 до 1,0 от 1,0 до 15,0	К А
Оксид азота (5)	ТИ-[NO-0,05]	от 1 до 10 от 5 до 50	К
Оксид азота (5)	ТИ-[NO-0,25]	от 1 до 10 от 10 до 250	К А
Пропанол (изопропанол) (10)	ТИ-[(i)PrOH-0,2]	от 5 до 200	К, А
Пропанол (изопропанол) (10)	ТИ-[C ₃ H ₇ OH-0,3]	от 5 до 300	К, А
Сероводород (10)	ТИ-[H ₂ S-0,02]	от 0,2 до 5,0 от 0,5 до 20	К А
Сероводород (10 или 3 мг/м ³ в смеси с углеводородами C ₁ – C ₅)	ТИ-[сероводород-0,12]	от 0,5 до 10 от 10 до 120	К А
Сероводород (10 или 3 мг/м ³ в смеси с углеводородами C ₁ – C ₅)	ТИ-[H ₂ S-0,12]	от 2 до 30 от 10 до 120	К А
Сероводород (10)	ТИ-[H ₂ S-0,2]	от 0,5 до 10 от 10 до 200	К А
Сероводород (10)	ТИ-[H ₂ S-1,0]	от 10 до 100 от 100 до 1000	К А
Сероводород (10)	ТИ-[H ₂ S-2,0]	от 10 до 100 от 100 до 2000	К А

Продолжение таблицы 1

Определяемый компонент (ПДК, мг/м ³) ¹⁾	Обозначение модификации	Диапазоны измерений массовой концентрации, мг/м ³	Назначение ²⁾
Сумма оксидов азота (в пересчете на NO ₂) (5) ⁴⁾	ТИ-[NO _x -0,05]	от 1 до 10 от 5 до 50	К
Сумма оксидов азота (в пересчете на NO ₂) (5) ⁴⁾	ТИ-[NO _x -0,25]	от 1 до 10 от 10 до 250	К А
Стирол (30/10)	ТИ-[стирол-3,0]	от 5 до 200 от 200 до 3000	К А
Толуол (150/50)	ТИ-[толуол-2,0]	от 5 до 100 от 100 до 2000	К А
Толуол (150/50)	ТИ-[C ₇ H ₈ -2,0]	от 20 до 200 от 200 до 2000	К А
Трихлорэтилен (30/10)	ТИ-[C ₂ HCl ₃ -0,15]	от 2 до 30 от 5 до 150	К А
Уайт-спирит в пересчете на декан (300 в пересчете на C) ³⁾	ТИ-[уайт-спирит-4,0]	от 50 до 500 от 100 до 4000	К
Углеводороды нефти в пересчете на гексан (900/300 в пересчете на C) ³⁾	ТИ-[C ₆ H ₁₄ -2,0]	от 50 до 2000	К
Углеводороды нефти в пересчете на гексан (900/300 в пересчете на C) ³⁾	ТИ-[C ₆ H ₁₄ -4,0]	от 50 до 200 от 200 до 4000	К
Уксусная кислота (5)	ТИ-[CH ₃ COOH-0,3]	от 2 до 20 от 20 до 300	К А
Уксусная кислота (5)	ТИ-[CH ₃ COOH-2,0]	от 2 до 50 от 50 до 2000	К А
Фенол (1/0,3)	ТИ-[фенол-0,03]	от 0,3 до 30	К. А
Фенол (1/0,3)	ТИ-[фенол-0,3]	от 2 до 50 от 50 до 300	А
Формальдегид (0,5)	ТИ-[HCHO-0,005]	от 0,2 до 5,0	К
Формальдегид (0,5)	ТИ-[HCHO-0,1]	от 1 до 10 от 10 до 100	А
Фтористый водород (0,5/0,1)	ТИ-[HF-0,02]	от 0,2 до 5,0 от 5 до 20	К А
Фтористый водород (0,5/0,1)	ТИ-[HF-0,5]	от 2 до 20 от 20 до 500	А
Хлор (1,0)	ТИ-[Cl ₂ -0,2]	от 0,5 до 10 от 10 до 200	К А
Хлористый водород (5,0)	ТИ-[HCl-0,06]	от 0,3 до 6,0 от 5 до 60	К
Хлористый водород (5,0)	ТИ-[HCl-0,15]	от 1 до 10 от 5 до 150	К А
Хлороформ (10/5)	ТИ-[хлороформ-0,2]	от 2 до 200	К, А

Продолжение таблицы 1

Определяемый компонент (ПДК, мг/м ³) ¹⁾	Обозначение модификации	Диапазоны измерений массовой концентрации, мг/м ³	Назначение ²⁾
Этанол (2000/1000)	ТИ-[EtOH-5,0]	от 200 до 5000	К

¹⁾ ПДК, мг/м³ (максимальная разовая/среднесменная) – предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

²⁾ В графе «Назначение» указаны: К – контроль ПДК воздуха рабочей зоны; А – контроль при аварийных ситуациях; В – определение компонента в воздухе рабочей зоны (при отсутствии ПДК).

³⁾ Формула пересчета на С: $C = C' \times K$ (0,845),
где С' – измеренная по шкале массовая концентрация определяемого вещества, мг/м³;

К – коэффициент пересчета на С, равный 0,844 для керосина, уайт-спирита и дизельного топлива; 0,836 - для углеводородов нефти.

⁴⁾ ПДК суммы оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) - 5 мг/м³

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности (δ), %	± 25 ¹⁾
Время прокачивания объема 100 см ³ анализируемой пробы через ТИ, указанные в таблице 1, с	от 10 до 120
Конкретное значение времени прокачивания приведено на этикетке	

¹⁾ ТИ, предназначенные для контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соответствуют Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», п. 4.43.

Таблица 3 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальное значение объема пробы анализируемого воздуха	в соответствии с маркировкой, нанесенной на ТИ
Габаритные размеры и допускаемое отклонение для ТИ, мм: – длина	125±5
– диаметр	4,50±0,25
Габаритные размеры и допускаемое отклонение для ТФ, мм: ТФ-C ₂ H ₂ , ТФ-Et ₂ O, ТФ-SO ₂ – длина	80±5
– диаметр	6,0±0,5

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	Значение
ТФ- C_3H_6O , ТФ-(i)-BuOH, ТФ-(i)-PrOH, ТФ- C_2HCl_3 , ТФ-HCl, ТФ-хлороформ	
– длина	125±5
– диаметр	4,50±0,25
ТФ- NO_x	
– длина	80±5
– диаметр	4,50±0,25
Масса 10 шт. и допускаемое отклонение, г, не более:	
для ТИ	35±4
для ТФ- C_2H_2	25±4
для ТФ- C_3H_6O	31±4
для ТФ-(i)-BuOH, ТФ-(i)-PrOH	33±2
для ТФ- NO_x	20±2
для ТФ- SO_2	25±2
для ТФ-HCl, ТФ-HF, ТФ- хлороформ	33±4
для ТФ- C_2HCl_3	35±4
для ТФ-Et ₂ O	35±2
Условия эксплуатации:	
- диапазон температуры окружающей среды, °C	от +10 до +35
- диапазон относительной влажности окружающей среды, %	от 30 до 95
- диапазон атмосферного давления, кПа	от 84,6 до 106,7
- пределы допускаемого относительного отклонения объема пробы от номинального значения, %	±5
- содержание неизмеряемых компонентов в анализируемой среде	в соответствии с таблицей 2 КРМФ.415522.003 РЭ
Примечание – При использовании трубок ТИ-[C_6H_{14} -2,0], ТИ-[C_6H_{14} -4,0] для определения предельных углеводородов нефти (C_3 - C_{10}), за исключением (C_6), погрешность не нормируется	

Таблица 4 – Показатели надёжности

Наименование характеристики	Значение
Средний срок сохраняемости, мес	
- для трубок модификаций ТИ-[C_7H_8 -2,0], ТИ-[CH_3COOH -2,0], [CH_3COOH -0,3], ТИ-[C_2H_2 -1,2], ТИ-[C_2H_2 -5,0], ТИ-[C_3H_6O -10,0], ТИ-[O_3 -0,003], ТИ-[O_3 -0,015], ТИ-[C_8H_{10} -1,5], ТИ-[C_6H_6 -0,03], ТИ-[C_6H_6 -1,5], ТИТИ-[SO_2 -0,13], ТИ-[SO_2 -0,19], ТИ-[SO_2 -2,5], ТИ-[CO_2 -2,0 %об.], ТИ-[CO_2 -30,0 %об.], ТИ-[Et_2O -3,0], ТИ-[H_2S -0,12], ТИ-[H_2S -1,0], ТИ-[H_2S -2,0]	24
- для трубок модификаций ТИ-[толуол-2,0], ТИ-[ксилол-1,5], [диоксид серы-0,13], ТИ-[CO_2 -10,0 %об.], ТИ-[H_2S -0,02], ТИ-[сероводород-0,12], ТИ-[H_2S -0,2]	18
- для остальных ТИ	12
ТИ ремонту не подлежат	

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на этикетки (чертежи КРМФ.754463.003-КРМФ.754463.032) и на титульный лист руководства по эксплуатации КРМФ.415522.003 РЭ.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность ТИ модификаций ТИ-[NH₃-0,005], ТИ [NH₃-0,1], ТИ-[NH₃-1,0], ТИ-[NH₃-2,0], ТИ-[ацетальдегид-0,05], ТИ-[ацетальдегид-0,1], ТИ-[ацетальдегид-2,0], ТИ-[бензин-4,0], ТИ-[бензин-6,0], ТИ-[C₆H₆-0,03], ТИ-[C₆H₆-1,5], ТИ-[бром-0,01], ТИ-[Br₂-0,01], ТИ-[гексан-0,12], ТИ-[гексан-0,3], ТИ-[NO₂-0,05], ТИ-[NO₂-0,25], ТИ-[CO₂-2,0 % об.], ТИ-[CO₂-10,0 % об.], ТИ-[CO₂-30,0 % об.], ТИ-[дизельное топливо-6,0], ТИ-[керосин-4,0], ТИ-[ксилол-1,5], ТИ-[C₈H₁₀-1,5], ТИ-[MeOH-0,03], ТИ-[MeOH-1,0], ТИ-[O₃-0,003], ТИ-[O₃-0,015], ТИ-[H₂S-0,02], ТИ-[H₂S-0,12], ТИ-[сероводород-0,12], ТИ-[H₂S-0,2], ТИ-[H₂S-1,0], ТИ-[H₂S-2,0], ТИ-[стирол-3,0], ТИ-[толуол-2,0], ТИ-[C₇H₈-2,0], ТИ-[уайт-спирит-4,0], ТИ-[C₆H₁₄-2,0], ТИ-[C₆H₁₄-4,0], ТИ-[CH₃COOH-0,3], ТИ-[CH₃COOH-2,0], ТИ-[фенол-0,03], ТИ-[фенол-0,3], ТИ-[HCHO-0,005], ТИ-[HCHO-0,1], ТИ-[HF-0,02], ТИ-[Cl₂-0,2], ТИ-[EtOH-5,0]

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Комплект трубок индикаторных ТИ-[ИК-К]	КРМФ.413549.001	20 (15, 10, 5) ¹⁾
Футляр или кассета полиэтиленовая	КРМФ.323363.001 СБ КРМФ.323366.001	1 1
Этикетка	КРМФ.754463.007	1
Руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом	КРМФ.415522.003РЭ	1 экз.
Методика поверки ²⁾	-	1 экз.

¹⁾ Номенклатура и количество индикаторных трубок определяются Заказчиком.

²⁾ Поставляется по запросу заказчика.

Таблица 6 – Комплектность ТИ модификаций ТИ-[C₃H₆O-10,0], ТИ-[(i)-BuOH-0,2], ТИ-[C₄H₉OH-0,3], ТИ-[(i)-PrOH-0,2], ТИ-[C₃H₇OH-0,3], ТИ-[C₂HCl₃-0,15], ТИ-[HF-0,5], ТИ-[HCl-0,06], ТИ-[HCl-0,15], ТИ-[хлороформ-0,2]

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Комплект трубок индикаторных ТИ-[ИК-К]	КРМФ.413549.001	20 (15, 10, 5) ¹⁾
Трубки фильтрующие	КРМФ.418539.002	20 (15, 10, 5)
Футляр или кассета полиэтиленовая	КРМФ.323363.001 СБ КРМФ.323366.001	1 1
Этикетка	КРМФ.754463.007	1
Руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом	КРМФ.415522.003РЭ	1 экз.
Методика поверки ²⁾	-	1 экз.
Трубка полимерная: d=5±1 мм, l=40±3 мм		1

¹⁾ Номенклатура и количество индикаторных трубок определяются Заказчиком.

²⁾ Поставляется по запросу заказчика.

Таблица 7 – Комплектность ТИ модификаций ТИ-[C₂H₂-1,2], ТИ-[C₂H₂-5,0], ТИ-[SO₂-0,13], ТИ-[диоксид серы-0,13], ТИ-[SO₂-0,19], ТИ-[SO₂-2,5], ТИ-[Et₂O-3,0], ТИ-[NOx-0,05], ТИ-[NOx-0,25]

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Комплект трубок индикаторных ТИ-[ИК-К]	КРМФ.413549.001	20 (15, 10, 5) ¹⁾
Трубки фильтрующие	КРМФ.418539.002	4 (3, 2, 1)
Футляр или кассета полиэтиленовая	КРМФ.323363.001 СБ КРМФ.323366.001	1 1
Этикетка	КРМФ.754463.007	1
Руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом	КРМФ.415522.003РЭ	1 экз.
Методика поверки ²⁾	-	1 экз.
Трубка полимерная: d=5±1 мм, l=40±3 мм	-	1

¹⁾ Номенклатура и количество индикаторных трубок определяются Заказчиком.
В комплект поставки индикаторных трубок может входить (по согласованию с заказчиком)
²⁾ Поставляется по запросу заказчика

Таблица 8 – Комплектность ТИ модификаций ТИ-[NO-0,05], ТИ-[NO-0,25]

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Комплект трубок индикаторных ТИ-[ИК-К]	КРМФ.413549.001	20 (10) ¹⁾
Трубки фильтрующие	КРМФ.418539.002	2 (1)
Футляр или кассета полиэтиленовая	КРМФ.323363.001 СБ КРМФ.323366.001	1 1
Этикетка	КРМФ.754463.007	1
Руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом	КРМФ.415522.003РЭ	1 экз.
Методика поверки ²⁾	-	1 экз.
Трубка полимерная: d=5±1 мм, l=40±3 мм	-	1

¹⁾ Номенклатура и количество индикаторных трубок определяются Заказчиком. В комплект поставки индикаторных трубок может входить (по согласованию с заказчиком)
²⁾ Поставляется по запросу заказчика

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 6 «Выполнение измерений и вычисление результата» документа КРМФ.415522.003 РЭ «Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 г. № 2315;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (п. 4.43);

ГОСТ Р 51712-2001 Трубки индикаторные. Общие технические условия;

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками;

КРМФ.415522.003 ТУ-2022 «Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]. Технические условия».

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Крисмас+» (ЗАО «Крисмас+»)

ИНН 7838390626

Адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 102

Телефон: +7 (812) 575-50-81, +7 (812) 575-57-91, факс: +7 (812) 325-34-79

E-mail: info@christmas-plus.ru

Web-сайт: www.christmas-plus.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

E-mail: info@vniim.ru

Web-сайт: www.vniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314555.