

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» сентября 2024 г. № 2213

Регистрационный № 42442-09

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Меры напряжённости магнитного поля экранированные М-117А

Назначение средства измерений

Меры напряженности магнитного поля экранированные М-117А (далее – мера) предназначены для воспроизведения напряжённости постоянного и переменного магнитных полей в рабочем пространстве меры.

Описание средства измерений

Принцип действия меры основан на преобразовании постоянного (переменного) электрического тока, протекающего по обмотке меры, в напряжённость постоянного (переменного) магнитного поля. Значение напряжённости магнитного поля H в рабочем объёме меры пропорционально значению тока I в обмотке $H = K \cdot I$. Коэффициент пропорциональности K называется коэффициентом преобразования (или постоянной) меры.

Конструктивно мера состоит из ферромагнитного экрана, в геометрическом центре которого находится каркас с катушкой меры.

Ферромагнитный экран состоит из двух соосных цилиндров, выполненных из пермаллоя и помещенных в защитный кожух, что обеспечивает ослабление в рабочем объеме меры не менее, чем в 2000 раз напряженности внешнего магнитного поля, направленного перпендикулярно оси экрана.

Каркас и катушка меры выполнены из пластмассы. На катушке симметрично относительно ее центра расположены две основные и две вспомогательные обмотки. Основные обмотки формируют магнитное поле в рабочем объеме меры. Вспомогательные обмотки компенсируют поле основных обмоток вне меры. В центре катушки находится цилиндрический рабочий объем, геометрический центр которого совпадает с геометрическим центром каркаса меры. Относительно каркаса катушка может находиться в одном из двух положений – продольная ось рабочего объема совпадает с продольной осью каркаса меры или перпендикулярна продольной оси каркаса меры.

В боковой стенке катушки расположено сквозное гнездо для крепления сменной вставки, предназначенное для размещения преобразователей средств измерений напряжённости магнитного поля или измерительных катушек магнитной индукции.

К источнику тока мера подключается с помощью соединительных проводов, идущих от обмоток меры.



Рисунок 1 – Мера напряженности магнитного поля экранированная М-117А

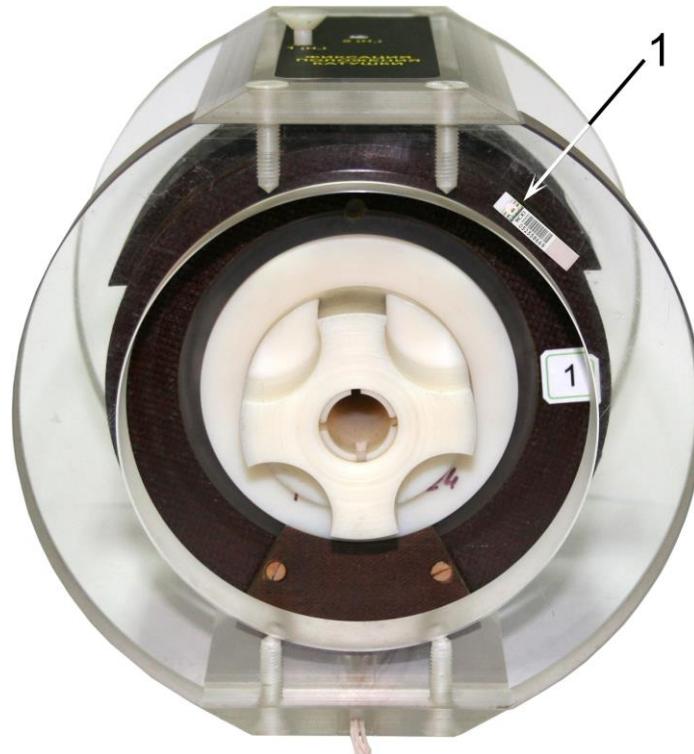


Рисунок 2 – Каркас с катушкой меры напряженности магнитного поля экранированной М-117А
1 – место для размещения поверительного клейма в виде наклейки

Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон воспроизводимых значений напряжённости постоянного магнитного поля (среднеквадратических значений напряженности переменного магнитного поля), А/м	от 0 до 1000 *
Значение коэффициента преобразования (постоянной) меры, 1/м	от 140 до 180 **
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента преобразования (постоянной) меры, %	±1
Рабочий объём меры	цилиндр диаметром 16 мм и длиной 16 мм
Неоднородность напряжённости магнитного поля в рабочем объёме меры, %, не более	0,3
Рабочий диапазон частот, кГц	от 0 до 10
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	10000
Установленный срок службы, лет	10
Масса с экраном, кг, не более	102
Габаритные размеры с экраном (длина×ширина×высота), мм, не более	1200×600×600
Климатические условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	20±5 от 30 до 80 от 84 до 106 (от 630 до 795)
* Для обеспечения воспроизведения мерой напряженности постоянного (переменного) магнитного поля во всём диапазоне необходимо для питания меры применять источник постоянного (переменного) тока с пределами регулирования напряжения не менее 10 В (40 В), тока – не менее 8 А.	
** Действительное значение коэффициента преобразования (постоянной) меры указывается в формуляре.	

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульных листах формуляра и руководства по эксплуатации и методом наклейки этикетки на торцевую поверхность каркаса катушки меры.

Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1. Мера напряженности магнитного поля экранированная М-117А в составе: - магнитный экран - каркас с катушкой	МКИЯ.422541.004	1 1
2. Вставка в сборе	ММН 317/24	1
3. Вставка метрологическая	МП 0907.10	1
4. Кольцо вставки метрологической	МП 0907.20	2
5. Фиксатор	ММН 317/07	1
6. Демагнетизатор ДМ-117А	МКИЯ.422289.004	1
7. Щит транспортный	МЭМ 0820.20	2
8. Болт М10×12 . 9.016 по ГОСТ 7805-70		22
9. Шайба 10 65Г 02.9 по ГОСТ 6402-70		22
10. Шайба Ø28×Ø11		22
11. Опора центрующая	МЭМ 0820.30	1
12. Штанга размагничивания	МЭМ 0820.40	1
13. Болт М8×25 . 9.016 по ГОСТ 7805-70		2
14. Шайба 865Г 02.9 по ГОСТ 6402-70		2
15. Шайба 8 03.016 по ГОСТ 11371-78		2
16. Провод соединительный 1,5 м		3
17. Транспортная тара меры М-117А	М-117/Я1	1
18. Транспортная тара демагнетизатора ДМ-117А	М-117/Я2	1
19. Мера напряженности магнитного поля экранированная М-117А. Руководство по эксплуатации	МКИЯ.422541.004 РЭ	1
20. Мера напряженности магнитного поля М-117А. Формуляр	МКИЯ.422541.004 ФО	1
21. Меры напряженности магнитного поля экранированные М-117А. Методика поверки	МКИЯ.422541.004 МП	1

Сведения о методиках (методах) измерений

МКИЯ.422541.004 РЭ «Мера напряженности магнитного поля экранированная М-117А. Руководство по эксплуатации»

Нормативные документы, устанавливающие требования к мерам напряженности магнитного поля экранированным М-117А

1) СТО 20883295-011-2008 «Мера напряженности магнитного поля экранированная М-117А. Стандарт организации»

2) ГОСТ 8.030-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции, магнитного потока, магнитного момента и градиента магнитной индукции»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОАКУСТИКА»
(ООО «МИКРОАКУСТИКА»)
Юридический адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 27
Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 27
телефон (343) 389-03-10, 341-63-11, факс (343) 389-03-10
E-mail: akustika@etel.ru www.mikroakustika.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)
Адрес: 620990, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 2а
Телефон (343) 350-25-83, факс (343) 350-40-81
E-mail: uraltest@uraltest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30058-13.