

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «14» августа 2024 г. № 1874

Регистрационный № 64273-16

Лист № 1
Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Калибраторы давления автоматические «ЭЛЕМЕР-АКД-12К», «ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ»

Назначение средства измерений

Калибраторы давления автоматические «ЭЛЕМЕР-АКД-12К», «ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ» (далее по тексту - АКД-12 или калибраторы) предназначены для воспроизведения (при использовании встроенного или внешнего источника давления - компрессора, баллона со сжатым газом или вакуумного насоса) и измерений давления, электрических сигналов силы и напряжения постоянного тока.

Описание средства измерений

Принцип работы АКД-12 заключается в:

- воспроизведении значения эталонного давления;
- измерении значения эталонного давления;
- измерении выходного сигнала поверяемых (калибруемых или градуируемых) датчиков давления в виде силы и напряжения постоянного тока и по HART-протоколу;
- проведении автоматической поверки датчиков давления по нескольким точкам;
- формировании протокола поверки;
- произведении подстройки и градуировки датчиков давления по HART-протоколу;
- произведении проверки (тестирования) реле;
- обеспечении сбора, хранения, архивирования и передачи данных в персональный компьютер.

Конструктивно АКД-12 представляют собой лабораторные приборы с полностью автоматизированным процессом измерения и обработки результатов. Их основными функциональными частями являются встроенный одноплатный компьютер с сенсорным экраном, пневматическая система (ПС), плата сопряжения и питания, 4-х канальный модуль измерений вышеуказанных электрических сигналов и цифровых сигналов HART-протокола (ИМ).

Сенсорный экран предназначен для отображения измеренных значений давления, выходных сигналов поверяемых датчиков давления, информации о датчиках давления, параметров поверки, служебной системной информации, для настройки самого АКД-12, а также для проведения поверки и подстройки датчиков давления (для модификации с ИМ).

ПС под управлением одноплатного компьютера задает и поддерживает заданное значение давления.

Плата сопряжения и питания осуществляет питание эталонных датчиков, электропневмоклапанов и принимает цифровой сигнал датчиков давления.

Измерительный модуль ИМ с поддержкой HART-протокола имеет четыре гальванически связанных канала, предназначенных для питания поверяемых датчиков давления и измерения выходного токового сигнала 4-20 мА и напряжения 0-100 мВ, 0-10 В.

Калибраторы изготавливаются в двух модификациях: «ЭЛЕМЕР-АКД-12К» - без ИМ, «ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ» - с ИМ.

Фотографии общего вида калибраторов представлены на рисунке 1 и обозначено (1) место нанесения клейма поверителя и (2) место пломбирования крышки корпуса пленочной пломбой.

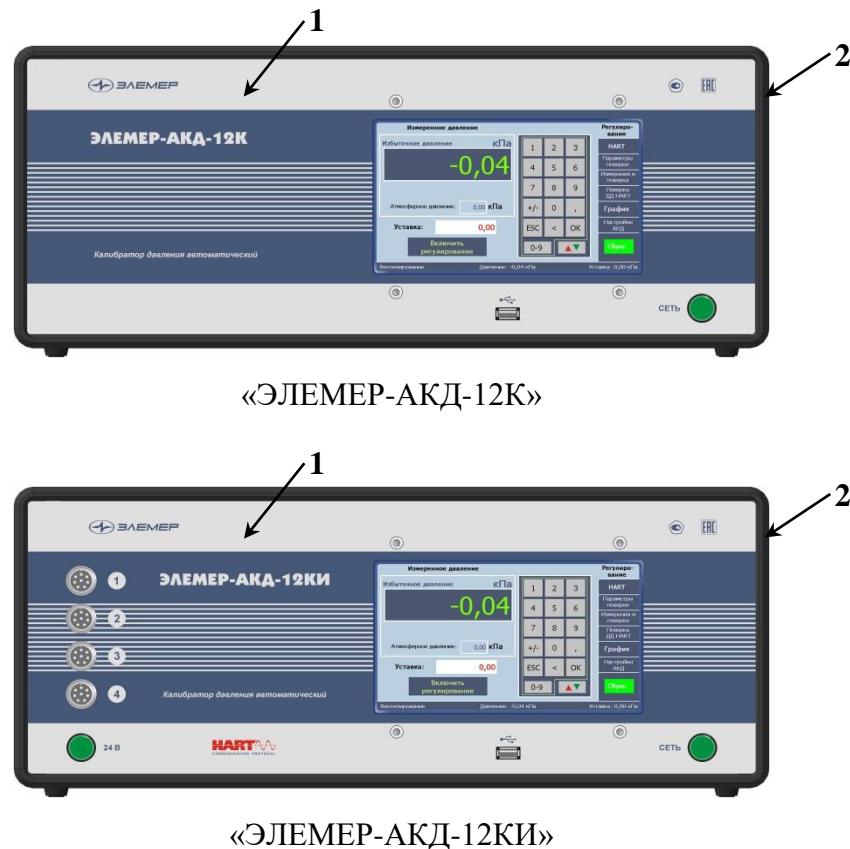


Рисунок 1

Знак поверки наносится на корпус и (или) свидетельство о поверке, и (или) в паспорте.

Программное обеспечение

В калибраторах предусмотрено внутреннее и внешнее программное обеспечение (ПО).

Внутреннее ПО состоит из встроенной в калибратор и ИМ метрологически значимой части ПО. Внутреннее ПО является фиксированным, незагружаемым и может быть изменено только на предприятии-изготовителе.

Уровень защиты внутреннего ПО от преднамеренного и непреднамеренного доступа соответствует уровню «высокий» по рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 - данное ПО защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Внешнее ПО, предназначено для взаимодействия калибраторов с компьютером и не оказывает влияния на метрологические характеристики калибраторов. Внешнее ПО служит для конфигурирования, осуществления пользователем градуировки, калибровки, поверки и получения данных измерения в процессе эксплуатации калибраторов. Конфигурирование включает установку параметров связи калибраторов с компьютером. ПО также предусматривает возможность выдачи текстовых сообщений о состоянии калибраторов и возникающих в процессе их работы ошибках и способах их устранения.

Идентификационные данные внутреннего программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	cePressCon.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 0.30 ^(*)
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Примечание: ^(*) - и более поздние версии.

Идентификационные данные внешнего программного обеспечения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	arm_akd.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.37.00 ^(*)
Цифровой идентификатор программного обеспечения	по номеру версии

Примечание: ^(*) - и более поздние версии.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики калибраторов приведены в таблицах 3 и 4, ИМ - в таблице 5.

Таблица 3

Код модели	Вид измеряемого давления	Диапазон измерений №1	Диапазон измерений №2
031	абсолютное	от 0 до 120 кПа	—
131	избыточное	от 0 до 100 кПа	—
132	избыточное	от 0 до 100 кПа	от 0 до 25 кПа
151	избыточное	от 0 до 600 кПа	—
161	избыточное	от 0 до 2,5 МПа	—
162	избыточное	от 0 до 2,5 МПа	от 0 до 0,6 МПа
171	избыточное	от 0 до 6,0 МПа	—
172	избыточное	от 0 до 6,0 МПа	от 0 до 2,5 МПа
171Е	избыточное	от 0 до 10 МПа	—
172Е	избыточное	от 0 до 10 МПа	от 0 до 2,5 МПа
321	избыточное - разрежение	от -10 до +10 кПа	—
351	избыточное - разрежение	от -100 до +600 кПа	—
352	избыточное - разрежение	от -100 до +600 кПа	от -100 до 160 кПа
851	абсолютное	от 0 до 600 кПа	—
	избыточное - разрежение	от -100 до +600 кПа	
852	абсолютное	от 0 до 600 кПа	от 0 до 250 кПа
	избыточное - разрежение	от -100 до +600 кПа	от -100 до +160 кПа

Код модели	Вид измеряемого давления	Диапазон измерений №1	Диапазон измерений №2
861	абсолютное	от 0 до 2,5 МПа	—
	избыточное - разрежение	от -0,1 до +2,5 МПа	
862	абсолютное	от 0 до 2,5 МПа	от 0 до 0,6 МПа
	избыточное - разрежение	от -0,1 до +2,5 МПа	от -0,1 до +0,6 МПа
Примечание * - По согласованию возможно изготовление с другим диапазоном № 2, не превышающим указанного в Таблице 3.			

Таблица 4

Код модели	Диапазон измерений № 1 (поддиапазон измерений давления)	Диапазон измерений № 2 (поддиапазон измерений давления)	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности		
			A0	A	B
031	от 0 до 120 кПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 48 кПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 48 до 120 кПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
131	от 0 до 40 кПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 40 до 100 кПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
132	от 0 до 40 кПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	-	от 0 до 25 кПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P_B$	$\pm 0,00050 \cdot P_B$
	от 40 до 100 кПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
151	от 0 до 240 кПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 240 до 600 кПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
161	от 0 до 2,5 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 1 МПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 1 до 2,5 МПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
162	от 0 до 2,5 МПа	от 0 до 0,6 МПа	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 1 МПа	от 0 до 0,24 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 1 до 2,5 МПа	от 0,24 до 0,6 МПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
171	от 0 до 6,0 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 2,4 МПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 2,4 до 6,0 МПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
172	от 0 до 6,0 МПа	от 0 до 2,5 МПа	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 2,4 МПа	от 0 до 1 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 2,4 до 6,0 МПа	от 1 до 2,5 МПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
171E	от 0 до 10 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 4 МПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 4 до 10 МПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
172E	от 0 до 10 МПа	от 0 до 2,5 МПа	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 4 МПа	от 0 до 1 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 4 до 10 МПа	от 1 до 2,5 МПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
321	от -10 до +10 кПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P_B$	$\pm 0,00050 \cdot P_B$
351	от -100 до +240 кПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 240 до 600 кПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $

Продолжение таблицы 4

Код модели	Диапазон измерений № 1 (поддиапазон измерений давления)	Диапазон измерений № 2 (поддиапазон измерений давления)	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности		
			Индекс модели		
352	-	от -100 до -64 кПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
	от -100 до +240 кПа	от -64 до +64 кПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 240 до 600 кПа	от 64 до 160 кПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
851	от 0 до 600 кПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 240 кПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 240 до 600 кПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
	от -100 до +600 кПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от -100 до +240 кПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 240 до 600 кПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
852	от 0 до 600 кПа	от 0 до 250 кПа	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 240 кПа	от 0 до 100 кПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 240 до 600 кПа	от 100 до 250 кПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
	от -100 до +600 кПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	-	от -100 до -64 кПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
	от -100 до 240 кПа	от -64 до +64 кПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 240 до 600 кПа	от 64 до 160 кПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
861	от 0 до 2,5 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 1 МПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 1 до 2,5 МПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
	от -0,1 до +2,5 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от -0,1 до +1 МПа	-	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 1 до 2,5 МПа	-	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
862	от 0 до 2,5 МПа	от 0 до 0,6 МПа	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от 0 до 1 МПа	от 0 до 0,24 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 1 до 2,5 МПа	от 0,24 до 0,6 МПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $
	от -0,1 до +2,5 МПа	от -0,1 до +0,6 МПа	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	-	-
	от -0,1 до +1 МПа	от -0,1 до +0,24 МПа	-	$\pm 0,0001 \cdot P_B$	$\pm 0,0002 \cdot P_B$
	от 1 до 2,5 МПа	от 0,24 до 0,6 МПа	-	$\pm 0,00025 \cdot P $	$\pm 0,00050 \cdot P $

Примечания: 1) P_B - верхний предел измерений диапазона № 1 или № 2.

2) P - измеренное значение давления.

Таблица 5

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений
Ток	от 0 до 25 мА	$\pm(10^{-4} \cdot I + 1) \text{ мкА}$
Напряжение	от 0 до 100 мВ	$\pm(7 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3) \text{ мкВ}$
	от 0 до 10 В	$\pm(1,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,3) \text{ мВ}$
	от 0 до 1 В	$\pm(1,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,03) \text{ мВ}$

Питание АКД-12 осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением, В:

220.

Габаритные размеры, мм, не более:

– длина	470;
– ширина	410;
– высота	200.
Масса, кг, не более для:	
– моделей х3х, х5х	14;
– моделей х6х, х7х	17.
Средняя наработка на отказ, ч, не менее:	100000.
Средний срок службы, лет, не менее:	12.
Рабочие условия эксплуатации:	
– диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С:	от плюс 10 до плюс 35.
– атмосферное давление, кПа:	от 84 до 106,7;
– относительная влажность при температуре 35 °С и ниже, %, не более:	98.

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель калибраторов термотрансферным способом, а также на руководство по эксплуатации НКГЖ.408749.007РЭ и паспорт НКГЖ.408749.007ПС - типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

Калибратор давления автоматический «ЭЛЕМЕР-АКД-12К»	- 1 шт.
Сетевой провод	- 1 шт.
Кабели соединительные:	
КИ №05 I1 (для «ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ»)	- 1 шт.
КИ №08 I2 (для «ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ»)	- 4 шт.
КТ2 (для «ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ»)	- 1 шт.
USB АВ	- 1 шт.
Диск с программным обеспечением «АРМ АКД-12» (при выборе опции «НБ» поставляется ноутбук с установленным программным обеспечением)	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 экз.
Паспорт	- 1 экз.
Талон на гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание	- 1 экз.
Методика поверки	- 1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации НКГЖ.408749.007РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к калибраторам давления автоматическим «ЭЛЕМЕР-АКД-12К», «ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ»

ГОСТ Р 8.802-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 Мпа;

ГОСТ Р 8.840-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне $1 - 1 \cdot 10^6$ Па;

ТУ 4381-130-13282997-2015. Калибраторы давления автоматические «ЭЛЕМЕР-АКД-12К», «ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ». Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»)
ИИН 5044003551
Юридический адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 7, стр. 1
Телефон (факс): (495) 925-51-47 ((499) 710-00-01)
E-mail: elemer@elemer.ru
Web-сайт www.elemer.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru
Web-сайт: www.vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.