

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «14» августа 2024 г. № 1875

Регистрационный № 77597-20

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Уровнемеры радарные «A FLOW» серии L-RDB

Назначение средства измерений

Уровнемеры радарные «A FLOW» серии L-RDB предназначены для измерений уровня жидкых сред и сыпучих материалов (в зависимости от модели).

Описание средства измерений

Принцип действия уровнемеров заключается в генерировании высокочастотного сигнала, частота излучения которого во время измерений линейно возрастает от 0,5 ГГц. Излучаемый сигнал отражается от поверхности измеряемой среды и принимается с небольшой временной задержкой. На основании частоты посланных и принятых сигналов рассчитывается разница частот, используемая при дальнейшей обработке сигнала. Разница частот прямо пропорциональна расстоянию до поверхности измеряемой среды. Разница частот трансформируется в частотный спектр посредством преобразования Фурье для идентификации сигнала в промежуточной частоте. Конструктивно уровнемеры состоят из электронного блока, размещенного в корпусе, и антенны. К электронному блоку уровнемеров подключен ЖК-дисплей, который предназначен для отображения результатов измерений, текущих настроек и конфигурирования.

Уровнемеры радарные «A FLOW» серии L-RDB имеют различные исполнения:

L-RDBA - для измерений уровня жидкости и сыпучих материалов с рупорной герметизированной антенной;

L-RDBB - для измерений уровня жидкости с линзовой герметизированной антенной;

L-RDBC - для измерений уровня жидкости и сыпучих материалов с рупорной антенной;

L-RDBD - для измерений уровня жидкости и сыпучих материалов с рупорной антенной;

L-RDBE - для измерений уровня жидкости и сыпучих материалов с линзовой герметизированной антенной;

L-RDBF - для измерений уровня жидкости и сыпучих материалов с рупорной герметизированной антенной;

L-RDBG - для измерений уровня жидкости с линзовой герметизированной антенной;

L-RDBH - для измерений уровня жидкости и сыпучих материалов с рупорной антенной;


L-RDBI - для измерений уровня жидкости и сыпучих материалов с рупорной антенной;

L-RDBJ - для измерений уровня жидкости с линзовой герметизированной антенной.

Настройка уровнемеров и отображение результатов измерений обеспечивается с помощью ЖК-дисплея, либо посредством аналогового выходного сигнала 4-20 мА.

Общий вид уровнемеров радарных «A FLOW» серии L-RDB представлен на рисунке 1.

Место нанесения знака
утверждения типа

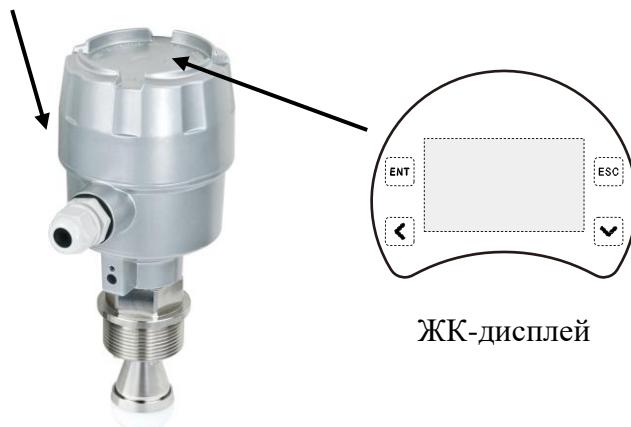

L-RDBA, L-RDBF



L-RDBB, L-RDBG



L-RDBC, L-RDBH



L-RDBD, L-RDBI



L-RDBE, L-RDBJ

Рисунок 1 – Общий вид уровнемеров радарных «A FLOW» серии L-RDB.

Пломбирование уровнемеров радарных «A FLOW» серии L-RDB не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение уровнемеров радарных «A FLOW» серии L-RDB служит для преобразования измеренного расстояния в аналоговый выходной сигнал 4-20 мА или цифровой сигнал. Программное обеспечение позволяет настраивать параметры для фильтрации, сглаживания и адаптации к условиям применения уровнемеров.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений: соответствует уровню «низкий» по Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	AFine
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Y170410
Цифровой идентификатор ПО	-
Алгоритм расчета цифрового идентификатора	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики уровнемеров радарных «A FLOW» серии L-RDB

Наименование характеристики	Значение									
	L-RDBA	L-RDBB	L-RDBC	L-RDBD	L-RDBE	L-RDBF	L-RDBG	L-RDBH	L-RDBI	L-RDBJ
Диапазон измерений уровня жидкости, м	от 0,5 до 30	от 0,5 до 30	от 0,5 до 40	от 0,5 до 70	от 0,5 до 20	от 0,5 до 20	от 0,5 до 20	от 0,5 до 30	от 0,5 до 35	от 0,5 до 15
Диапазон измерений уровня сыпучих материалов, м	от 0,5 до 20	-	от 0,5 до 30	от 0,5 до 50	от 0,5 до 15	от 0,5 до 10	-	от 0,5 до 20	от 0,5 до 30	-
Цена деления, мм	1									
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня в диапазоне до 20 м включ., мм	$\pm 3,0$					$\pm 5,0$			$\pm 3,0$	$\pm 5,0$
Пределы допускаемой погрешности измерений уровня, приведенной к верхнему пределу измерений, в диапазоне св. 20 м, %	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	-	-	-	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	-

Таблица 3 – Основные технические характеристики уровнемеров радарных «A FLOW» серии L-RDB

Продолжение таблицы 3

Условия эксплуатации: -температура окружающей среды, °C	от -40 до +90
-относительная влажность воздуха, %	90
Выходной сигнал, mA	от 4 до 20
Срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа

наносится на корпус уровнемеров методом наклейки и на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность уровнемеров радарных «A FLOW» серии L-RDB приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность уровнемеров радарных «A FLOW» серии L-RDB

Наименование	Обозначение	Количество
Уровнемер радарный	«A FLOW» серии L-RDB	1 шт.
Паспорт	ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	РЭ	1 экз.
Методика поверки	МП 1011-7-2019	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 8.477-82 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений уровня жидкости;

ТУ 26.51.52.120-005-74081055-2017 Уровнемеры радарные «A FLOW» серии L-RDB производства ООО «МВиФ», г. Москва.

Изготовитель

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (ООО «МВиФ»)

ИНН 7714561565

Адрес места осуществления деятельности: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 49, помещ./эт./ком. I/5/25

Телефон (факс): +7 (495) 589-6109, 7 (495) 988-6444

Web-сайт: www.mvif.ru

E-mail: mail@mvif.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»

Телефон (факс): +7 (843) 272-70-62 / 272-00-32

Web-сайт: www.vniir.org

E-mail: office@vniir.org

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310592.