

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
ФГБУ «ВНИИОФИ»

Е.А. Гаврилова  
*Согласовано* 2024 г.



**«ГСИ. Аттенюаторы оптические перестраиваемые FVA-600**

**Методика поверки»**

**МП 022.Ф3-24**

Главный метролог  
ФГБУ «ВНИИОФИ»

*С.Н. Негода*  
«29» *июня* 2024 г.

Москва  
2024 г.

## **1 Общие положения**

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на аттенюаторы оптические перестраиваемые FVA-600 (далее по тексту - аттенюаторы), предназначенные для внесения ослабления мощности в оптических кабелях и оптических компонентах в одномодовых волоконно-оптических линиях передачи, и устанавливает методы их первичной и периодической поверки

1.2 По итогам проведения поверки должна обеспечиваться прослеживаемость, в соответствии с государственной поверочной схемой утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.12.2019 № 2862, к государственному первичному специальному эталону единиц длины и времени распространения сигнала в оптическом волокне, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения для волоконно-оптических систем передачи информации ГЭТ 170 - 2024.

1.3 Поверка аттенюаторов выполняется методом прямых измерений.

1.4 Метрологические характеристики аттенюаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики аттенюаторов

Наименование характеристики	Значение
Максимальное значение устанавливаемого ослабления, дБ, не менее	65
Собственные вносимые потери на длинах волн градуировки, дБ, не более*	1,5
Нелинейность установки ослабления на длинах волн градуировки, дБ**	
- в диапазоне установки ослабления до 59,99 включ., дБ	0,2
- в диапазоне установки ослабления св. 59,99 до 65 включ., дБ	0,5
Уровень обратных потерь, дБ, не менее	45

\* без учета потерь на коннекторах  
\*\* длины волн градуировки - 1310, 1550 нм.

## **2 Перечень операций поверки средства измерений**

2.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	8
Проверка программного обеспечения средства измерения	Да	Да	9
Определение метрологических характеристик средства измерений			10
Определение собственных вносимых потерь на длинах волн градуировки	Да	Да	10.1

Определение максимального значения устанавливаемого ослабления; определение нелинейности установки ослабления на длинах волн градуировки	Да	Да	10.2
Определение уровня обратных потерь	Да	Да	10.3
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	11

2.2 При получении отрицательных результатов при проведении хотя бы одной операции поверка прекращается.

2.3 Допускается проведение периодической поверки в сокращенном объеме на меньшем числе поддиапазонов измерений и меньшего числа величин. Поверка в сокращенном объеме проводится на основании письменного заявления владельца средства или лица, представившего средство измерения на поверку, оформленного в произвольной форме.

### **3 Требования к условиям проведения поверки**

3.1 Все операции поверки проводят при следующих условиях:

- температура окружающей среды,  $^{\circ}\text{C}$  .....  $20 \pm 5$
- относительная влажность воздуха, % .....  $65 \pm 15$
- атмосферное давление, кПа ..... от 84 до 106
- напряжение питания сети, В .....  $220 \pm 22$
- частота, Гц .....  $50 \pm 0,5$

3.2 Помещение, где проводится поверка, должно быть чистым и сухим. Допускаемый перепад температуры при проведении поверки – не более  $2^{\circ}\text{C}$ .

### **4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку**

4.1 К проведению поверки допускают лиц, изучивших настоящую методику поверки и руководство по эксплуатации (далее – РЭ) поверяемого аттенюатора и средств поверки, а также их правила хранения и применения, и имеющих опыт работы с высокоточными средствами измерений в области волоконно-оптических систем передачи информации; прошедших обучение на право проведения поверки по требуемому виду измерений.

4.2 Поверку средства измерений осуществляют аккредитованные в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

### **5 Метрологические и технические требования к средствам поверки**

5.1 При проведении первичной и периодической поверок применяются средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Средства поверки

Операция поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	<p>Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне от 15 до 25 °C с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,2 °C.</p> <p>Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне до 80 % с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 3 %.</p> <p>Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106 кПа с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,2 кПа</p>	Измерители – регистраторы параметров микроклимата «ТКА – ПКЛ» модификации ТКА-ПКЛ(26)-Д, рег. № 76454-19
	<p>Средства измерений частоты переменного тока в диапазоне от 40 до 60 Гц с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более <math>\pm (0,012 \cdot f_{изм} + 3 \cdot k)</math> Гц, где <math>f_{изм}</math> – измеряемое значение частоты переменного тока, Гц, <math>k</math> – значение единицы младшего разряда, Гц, равное 0,01 Гц.</p> <p>Средства измерений напряжения переменного тока в диапазоне до 600 В с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более <math>\pm (0,008 \cdot U_{изм} + 4 \cdot k)</math> В, где <math>U_{изм}</math> – измеряемое значение напряжения переменного тока, В, <math>k</math> – значение единицы младшего разряда, В, равное 0,1 В.</p>	Мультиметры цифровые серии DT модификации DT-9963, рег. № 58550-14
п. 10 Определение метрологических характеристик средства измерений	Эталоны средней мощности и ослабления оптического излучения в волоконно-оптических системах передачи, не ниже уровня рабочего эталона по государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Федерального агентства по	Государственный рабочий эталон единиц средней мощности и ослабления непрерывного и импульсно-модулированного лазерного излучения в волоконно-оптических системах передачи в диапазоне

Операция поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
	<p>техническому регулированию и метрологии от 05.12.2019 № 2862, в диапазоне измерений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средней мощности оптического излучения: от <math>10^{-10}</math> до <math>10^{-2}</math> Вт;</li> <li>- длин волн исследуемого излучения: от 600 до 1700 нм;</li> <li>- пределы допускаемой относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в диапазоне от <math>10^{-10}</math> до <math>2 \cdot 10^{-3}</math> Вт: <math>\pm 2,5\%</math>;</li> <li>- в диапазоне от <math>2 \cdot 10^{-3}</math> до <math>10^{-2}</math> Вт: <math>\pm 3,5\%</math>;</li> <li>- пределы допускаемой относительной погрешности измерений относительных уровней мощности:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в диапазоне от <math>10^{-10}</math> до <math>2 \cdot 10^{-3}</math> Вт: <math>\pm 1,2\%</math>;</li> <li>- в диапазоне от <math>10^{-5}</math> до <math>10^{-4}</math> Вт: <math>\pm 0,5\%</math></li> </ul> </ul> </ul>	<p>от <math>10^{-10}</math> до 1 Вт на длинах волн от 500 до 1700 нм.</p> <p>3.1.ZZA.0100.2017 (далее – РЭСМ)</p>
	<p>Эталоны обратных потерь в волоконно-оптических системах передачи не ниже уровня рабочего эталона по государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.12.2019 № 2862, в диапазоне измерений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-рабочие длины волн: 1310 нм и 1550 нм;</li> <li>-предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерений обратных потерь измерителем обратных потерь: 1 дБ.</li> </ul>	<p>Рабочий эталон обратных потерь в ВОСП «РЭОП», рег. № 35981-07</p>

5.2 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение необходимых метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

5.3 Средства измерений, используемые при проведении поверки, должны быть аттестованы (проверены) в установленном порядке.

## **6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки**

6.1 При проведении поверки соблюдаются требования, установленные ГОСТ 12.1.040-83, ГОСТ 31581-2012 и правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, указанные в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н. Оборудование, применяемое при поверке, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91. Воздух рабочей зоны должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 при температуре помещения, соответствующей условиям испытаний для легких физических работ.

6.2 Система электрического питания системы должна быть защищена от колебаний и пиков сетевого напряжения, искровые генераторы не должны устанавливаться вблизи поверяемого аттенюатора.

6.3 Помещение, в котором проводится поверка, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

## **7 Внешний осмотр средства измерений**

7.1 Комплектность поверяемого аттенюатора должна соответствовать комплектности, приведенной в нормативной документации (РЭ и описание типа (далее – ОТ)).

7.2 При внешнем осмотре должно быть установлено:

- наличие маркировки, подтверждающей тип и идентифицирующей поверяемый аттенюатор;
- отсутствие на наружных поверхностях поверяемого аттенюатора повреждений, влияющих на его работоспособность;
- отсутствие ослаблений элементов конструкции, сохранность пломб, чистота разъемов;
- целостность волоконно-оптических кабелей и разъемов.

7.3 Аттенюатор считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если корпус, внешние элементы, органы управления и индикации не повреждены, отсутствуют механические повреждения и ослабления элементов конструкции, а комплектность соответствует таблице состава РЭ и ОТ.

## **8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений**

8.1 Устанавливают на рабочем месте поверяемый аттенюатор.

8.2 Проверяют условия окружающей среды.

8.3 Протирают специальным тампоном, смоченным изопропиловым спиртом (ГОСТ 9805-84), оптический разъем поверяемого аттенюатора. Протирают специальной салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом, торцы волоконно-оптических кабелей, используемых при проведении поверки.

8.4 Подготавливают поверяемый аттенюатор к работе согласно его РЭ. Проводят прогрев всех включенных приборов в течение получаса если иное не указано в их РЭ.

8.5 Аттенюатор считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если прибор вышел на рабочий режим в соответствии с РЭ.

## **9 Проверка программного обеспечения средства измерений**

9.1 Проверяют соответствие заявленных идентификационных данных ПО сведениям, приведенным в ОТ на аттенюатор.

9.2 Включают аттенюатор и дожидаются загрузки главного меню.

9.3 Идентификационное наименование, номер версии ПО можно увидеть на экране монитора аттенюатора. (рис.1)



Рисунок 1 – Наименование и номер версии (идентификационный номер) ПО

9.4 Аттенюатор считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если идентификационный номер версии ПО соответствует значению, приведенному в таблице 4.

Таблица 4 – Идентификационные данные ПО


Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	LE 0275
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	3.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО	-

## 10 Определение метрологических характеристик средства измерений


10.1 Определение собственных вносимых потерь на длинах волн градуировки.

10.1.1 Проводят предварительный прогрев источника излучения из состава РЭСМ на длине волны 1310 нм в течение 15 минут.

10.1.2 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 2а.

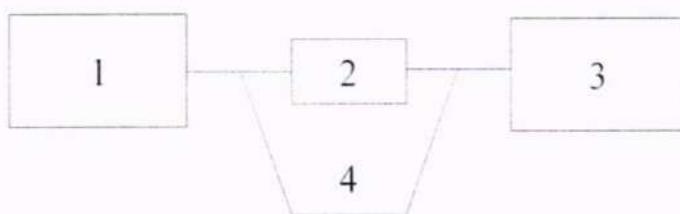

a

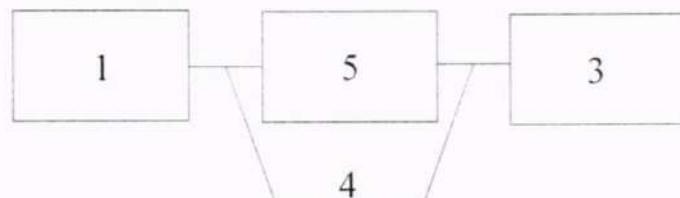

б

1 – источник излучения, стабилизированный из состава РЭСМ с длинами волн 1310 нм, 1550 нм; 2 – волоконно-оптический соединитель; 3 – ваттметр из состава РЭСМ; 4 – волоконно-оптический кабель; 5 – исследуемый аттенюатор

Рисунок 2 – Блок-схема установки для определения собственных вносимых потерь, максимального значения устанавливаемого ослабления и нелинейности установки ослабления на длинах волн градуировки

10.1.3 Переводят ваттметр 3 и исследуемый аттенюатор 5 в режим измерений на длине волны 1310 нм.

10.1.4 Переводят измеритель мощности 3 в режим измерений относительных уровней мощности (ref), при этом он показывает 0 дБ.

10.1.5 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 2б.

10.1.6 Регулировкой исследуемого аттенюатора 5 устанавливают минимальное значение ослабления.

10.1.7 Регистрируют показание ваттметра 3  $P_{01}$  в дБ, получая отрицательное значение, которое соответствует значению собственных вносимых потерь.

10.1.8 Проводят операции по п.п. 10.1.2 – 10.1.7 еще четыре раза.

10.1.9 Проводят операции по п.п. 10.1.1 – 10.1.8 на длине волны 1550 нм.

10.2 Определение максимального значения устанавливаемого ослабления; определение нелинейности установки ослабления на длинах волн градуировки

10.2.1 Проводят предварительный прогрев источника излучения из состава РЭСМ на длине волны 1310 нм в течение 15 минут.

10.2.2 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 2б.

10.2.3 Переводят ваттметр 3 и исследуемый аттенюатор 5 в режим измерений на длине волны 1310 нм.

10.2.4 Регулировкой исследуемого аттенюатора 5 устанавливают минимальное значение ослабления.


10.2.5 Переводят ваттметр 3 в режим измерений относительных уровней мощности (*ref*), при этом он показывает 0 дБ.

10.2.6 Регулировкой ослабления последовательно увеличивают значение ослабления на 3 - 5 дБ и каждый раз регистрируют показания ваттметра 3  $P_{ij}$  в дБ и исследуемого аттенюатора  $A_{ij}$ , пока не будет достигнуто предельное значение устанавливаемого ослабления для исследуемого аттенюатора. Измерения проводят пять раз ( $i=1,2,3,4,5$ ) для каждой  $j$ -й точки диапазона ( $j=1,2,\dots,M$ ), устанавливая значение ослабления исследуемого аттенюатора при подходе от меньшего значения ослабления к большему и от большего к меньшему.

10.2.7 Проводят операции по п.п. 10.2.1 – 10.2.6 на длине волны 1550 нм.

10.3 Определение уровня обратных потерь

10.3.1 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 3.

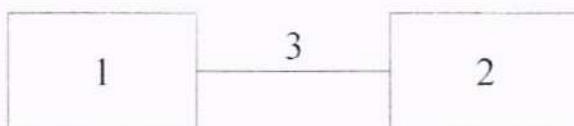

1 – измеритель обратных потерь из состава РЭОП (далее – ИОП);

2 – исследуемый аттенюатор; 4 – волоконно-оптический кабель.

Рисунок 3 – Блок-схема установки для определения уровня обратных потерь

10.3.2 Переводят ИОП и исследуемый аттенюатор в режим измерений на длине волны 1310 нм.

10.3.3 Устанавливают на поверяемом аттенюаторе минимальное значение ослабления. Проводят измерение уровня обратных потерь ИОП.

10.3.4 Проводят операции по п.п. 10.3.2 – 10.3.3 при значении ослабления 30 дБ и при максимальном значении ослабления аттенюатора.

10.3.5 Проводят операции по п.п. 10.3.1 – 10.3.4 на длине волны 1550 нм.

10.3.6 Аттенюатор считается прошедшим поверку, если для обеих длин волн на всех значениях ослабления полученное значение уровня обратных потерь составляет не менее приведенного в таблице 1.

## **11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям**

11.1 Обработка результатов определения собственных вносимых потерь на длинах волн градуировки.

11.1.1 Определяют значение собственных вносимых потерь  $A_0$  по формуле (1) для длин волн 1310 и 1550 нм:

$$A_0 = -\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 P_{0i} \quad (1)$$

11.1.2 Аттенюатор считается прошедшим поверку, если полученное значение собственных вносимых потерь для обеих длин волн не превышает указанного в таблице 1.

11.2 Обработка результатов определения максимального значения устанавливаемого ослабления; определения нелинейности установки ослабления на длинах волн градуировки 1310 и 1550 нм.

11.2.1 Определяют нелинейность установки ослабления  $\theta_A$  по формуле (2):

$$\theta_A = \max_j \{|\theta_j|\} + \theta_{oo} \quad (2)$$

где  $\theta_{oo}$  – погрешность измерений относительных уровней мощности РЭСМ (0,05 дБ) (из паспорта РЭСМ).

$\theta_j$  – средняя разность показаний РЭСМ и поверяемого прибора в  $j$ -той точке измерений, вычисляемая по формуле (3):

$$\theta_j = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (P_{ij} + A_{ij}) \quad (3)$$

11.2.2 Определяют максимальное значение устанавливаемого ослабления для исследуемого аттенюатора  $A_M$  по формуле (4):

$$A_M = -\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 P_{im} \quad (4)$$

где  $P_{im}$  – показания ваттметра РЭСМ при предельном достигнутом ослаблении исследуемого аттенюатора по п. 10.2.6.

Аттенюатор считается прошедшим поверку, если для обеих длин волн полученное значение нелинейности установки ослабления не превышает указанного в таблице 1, а максимальное значение устанавливаемого ослабления составляет не менее 65 дБ.

## **12 Оформление результатов поверки**

12.1 Результаты поверки оформляются протоколом поверки. Рекомендуемая форма протокола поверки приведена в приложении А. Протокол может храниться на электронных носителях.

12.2 Аттенюатор считается прошедшим поверку с положительным результатом и допускается к применению, если все операции поверки пройдены с положительным результатом и полученные значения метрологических характеристик удовлетворяют требованиям аттенюатору в соответствии с его описанием типа, а также соблюдены требования по защите средства измерений от несанкционированного вмешательства. В ином случае аттенюатор считается прошедшим поверку с отрицательным результатом и не допускается к применению.

12.3 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, с учетом требований методики поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средства измерений метрологическим требованиям) выдает свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утвержденными приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510

12.4 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, с учетом требований методики поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средства измерений метрологическим требованиям) выдает извещение о непригодности к применению средства измерений

12.5 Сведения о результатах поверки (как положительных, так и отрицательных) передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Начальник лаборатории отделения Ф-3



И.С. Королев

Старший научный сотрудник отделения Ф-3



А.И. Глазов

**Приложение А**  
(Рекомендуемое)  
Форма протокола поверки  
**ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ (ПЕРИОДИЧЕСКОЙ) ПОВЕРКИ №**  
**от \_\_\_\_\_ 20 г.**

**Аттенюатор оптический перестраиваемый FVA-600**  
(регистрационный № \_\_\_\_\_, год выпуска)

Заводской номер:

Изготовитель:

Владелец СИ:

Применяемые средства поверки:

Рабочий эталон единицы средней мощности  
оптического излучения «РЭСМ»  
МП 022.Ф3-24 «ГСИ. Аттенюаторы  
оптические перестраиваемые FVA-600.  
Методика поверки»

Применяемая методика поверки:

Место проведения поверки:

Условия поверки:

- температура окружающей среды:
- относительная влажность воздуха:
- атмосферное давление:
- напряжение сети питания:
- частота сети питания:

Проведение поверки:

1. Вешний осмотр
2. Опробование
3. Идентификация программного обеспечения
4. Определение метрологических характеристик аттенюатора:

Полученные результаты измерений метрологических характеристик аттенюатора:

Таблица А.1 – Результаты определения метрологических характеристик

Определение собственных вносимых потерь на длинах волн градуировки, п. 10.1 МП				
Длина волны градуировки, нм	Измеренное значение, дБ	Среднее измеренное значение, дБ	Допускаемое значение, дБ, не более	Результат
1310			1,5	
1550			1,5	

Определение максимального значения устанавливаемого ослабления, п. 10.2 МП					
Длина волны градуировки, нм	Измеренное значение, дБ	Среднее измеренное значение, дБ	Допускаемое значение, дБ, не менее	Результат	
1310			65		
1550			65		

Определение нелинейности установки ослабления на длинах волн градуировки, п. 10.2 МП						
Длина волны градуировки, нм	Номинальное значение ослабления, дБ	Разность показаний РЭСМ и поверяемого прибора, дБ	Значение нелинейности установки ослабления, дБ	Допускаемое значение, дБ, не более	Результат	
1310			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:	0,2		
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:	0,5		
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:	0,2		
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
1550			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:	0,5		
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления до 59,99 дБ:			
			- в диапазоне установки ослабления от 60 до 65 дБ:			

Определение уровня обратных потерь, п. 10.3 МП

Длина волны градуировки, нм	Измеренное значение, дБ	Допускаемое значение, дБ, не менее	Результат
1310		45	
1550		45	

5. Заключение по результатам поверки:

Поверитель:

Подпись

Фамилия И.О.

Руководитель:

Подпись

Фамилия И.О.