

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «16» июня 2025 г. № 1188

Регистрационный № 78624-20

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства весоизмерительные автоматические ТВС

Назначение средства измерений

Устройства весоизмерительные автоматические ТВС (далее — средство измерений) предназначены для измерений массы.

Описание средства измерений

Принцип действия средства измерений основан на использовании гравитационного притяжения. Сила тяжести объекта измерений вызывает деформацию чувствительного элемента средства измерений, которая преобразуется им в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный массе объекта измерений. Этот сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию, математической обработке электронными устройствами средства измерений с автоматическим определением измеренного значения массы.

Результаты измерений отображаются в визуальной форме на дисплее средства измерений и/или передаются в виде цифрового электрического сигнала через цифровой интерфейс связи.

Средство измерений представляет собой весы автоматического действия для автоматического динамического и/или статического взвешивания и конструктивно состоит из следующих функциональных узлов:

- конвейер взвешивания — роликовый конвейер, опирающийся на четыре тензорезисторных весоизмерительных датчика (далее — датчика) и оснащенный оптическим датчиком нахождения объекта измерений на конвейере; в составе конвейера взвешивания используются датчики весоизмерительные тензорезисторные FX, CO, TA, изготовитель «SENSOCAR, S.A.», Испания (регистрационный № 60720-15); датчики весоизмерительные тензорезисторные BS, BSA, BSS, BSH, HBS, BCA и BCM, изготовитель «CAS Corporation», Корея (регистрационный № 51261-12);

- один или несколько роликовых конвейеров, закрепленных на отдельной раме или на общей раме с конвейером взвешивания, для транспортировки объекта измерений на конвейер взвешивания (подающий конвейер);

- один или несколько роликовых конвейеров, закрепленных на отдельной раме или на общей раме с конвейером взвешивания, для транспортировки объекта измерений с конвейера взвешивания (выходной конвейер);

- устройство обработки аналоговых данных (далее — УОАД), выполняющее функции аналого-цифрового преобразования сигналов датчиков, их первичной математической обработки. Используются приборы весоизмерительные серии SGM800 (SGM820), изготовитель «PENKO Engineering B.V.», Нидерланды;

- панель оператора, обеспечивающая хранение параметров настройки, управление процессом взвешивания, отображение результатов измерений, оснащенная сенсорным дисплеем, совмещающим функции показывающего устройства и клавиатуры управления

средством измерений, и оснащенная цифровыми интерфейсами связи для подключения различных периферийных устройств (например, сканеров штрих-кодов, печатающих устройств, устройств (систем, модулей) для определения габаритных размеров).

Панель оператора, УОАД (электронные устройства), устройства питания и коммутации размещены в электрическом шкафу (стойке) или пульте управления.

Сигнальные кабели датчиков подаются в УОАД через соединительную коробку.

Средства измерений выпускаются в четырех модификациях, отличающихся метрологическими и техническими характеристиками в соответствии с таблицами 2, 3.

Модификации средства измерений имеют обозначение вида:

TBC-[Max]

где:

Max: максимальная нагрузка, кг: 1500; 3000; 4500 или 6000.

Внешний вид средства измерений представлен на рисунке 1.


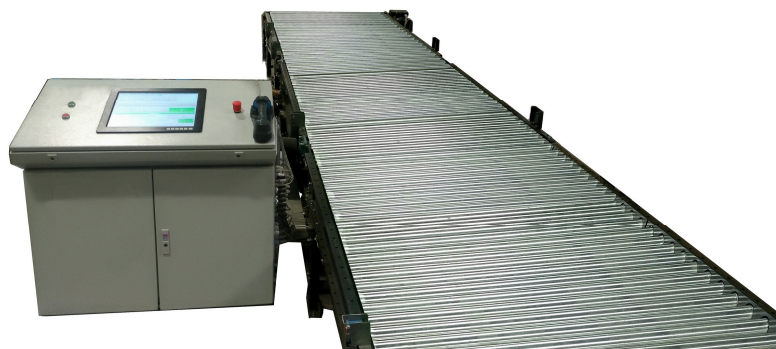


Рисунок 1 – Общий вид средства измерений (пример исполнения с размещением электронных устройств, устройств питания и коммутации в пульте управления)

Внешний вид УОАД и схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

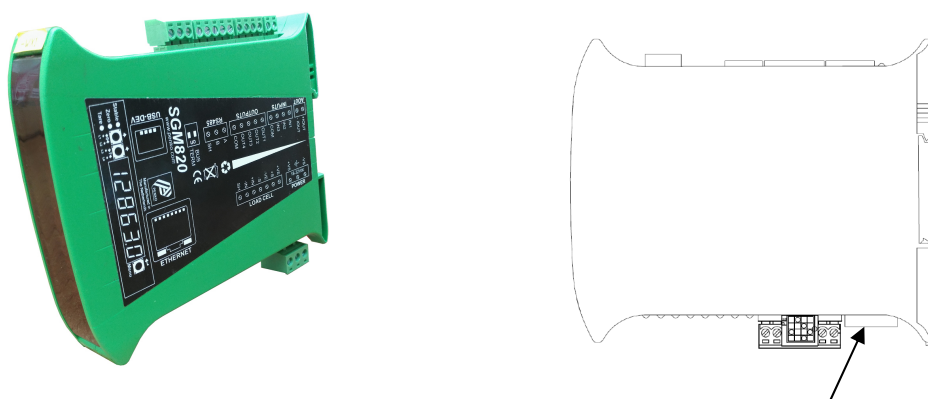

Разрушаемая наклейка, закрывающая доступ к разъемам сигнальных кабелей (кабелей питания) и предотвращающая несанкционированный доступ для замены УОАД

Рисунок 2 — Общий вид УОАД и схема пломбировки от несанкционированного доступа

На маркировочной табличке средства измерений указываются следующие основные данные:

- торговая марка изготовителя или его полное наименование;

- обозначение модификации;
- знак утверждения типа;
- действительная цена деления шкалы;
- заводской (серийный) номер весов;
- максимальная нагрузка Max;
- минимальная нагрузка Min.

Заводской номер наносится методом гравировки на маркировочную табличку в виде буквенно-цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр и/или букв латинского и кириллического алфавитов.

Пример маркировочной таблички представлен на рисунке 3.


  ООО «СКАМАТИК» Т. 7 (499) 500 9689	
Наименование:	Устройство весоизмерительное автоматическое ТВС
Обозначение типа (модификация):	ТВС – 6000
Заводской номер:	ТВС6000-Д-01
Максимальная нагрузка (Max), кг:	6000
Минимальная нагрузка (Min), кг:	40
Действительная цена деления (шкалы), кг:	2
Диапазон температур, рабочий:	От 0 С до +40 С
Дата выпуска	20.05.20
Номер ТУ:	ТУ 28.99.39–001–20590179–2017

Рисунок 3 – Пример маркировочной таблички

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке (если применимо, в соответствии с действующим законодательством).

Программное обеспечение

Метрологически значимая часть программного обеспечения (далее — ПО) средства измерений является встроенной, хранится в энергонезависимом запоминающем устройстве УОАД.

Функциональная часть ПО является встроенной, хранится в энергонезависимом запоминающем устройстве панели оператора.

Для защиты от несанкционированного доступа к метрологически значимой части ПО, параметрам настройки и регулировки средства измерений, а также измерительной информации используются следующие средства:

- «TAS counter» — несбрасываемый счетчик событий настройки метрологически значимых параметров УОАД;
- «CAL counter» — несбрасываемый счетчик событий регулировки УОАД.

Для защиты от несанкционированного доступа к функциональной части ПО, параметрам настройки, а также измерительной информации, используется:

- невозможность изменения (в том числе загрузки) ПО без применения специализированного оборудования изготовителя и без изменения его идентификационных данных;

– разграничение прав доступа к режимам работы средства измерений с помощью пароля.

Идентификационными признаками ПО служат номер версии ПО и цифровой идентификатор ПО, которые доступны для просмотра при включении УОАД. Идентификационные данные функциональной части ПО доступны для просмотра при работе средства измерений в пункте меню «О программе».

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077—2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	ПО УОАД	функциональное ПО
Идентификационное наименование ПО	—	—
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.0.0.96	1.0.0.1
Цифровой идентификатор ПО	AEA7-b382	—

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение			
	TBC-1500	TBC-3000	TBC-4500	TBC-6000
Максимальная нагрузка, Max, кг	1500	3000	4500	6000
Минимальная нагрузка, Min, г	10	20	40	40
Цена деления шкалы (d), кг	0,5	1	2	2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, кг, при нагрузке m , выраженной через цену деления d (в том числе после задействования устройства тарирования):				
от Min до $500d$ включ.	± 1	± 2	± 4	± 4
св. $500d$ до $2000d$ включ.	$\pm 1,5$	± 3	± 6	± 6
св. $2000d$ до Max включ.	± 2	± 4	± 8	± 8

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение			
	TBC-1500	TBC-3000	TBC-4500	TBC-6000
Диапазон выборки массы тары (в статическом режиме, при наличии устройства тарирования), не более	100 % Max			
Точность устройства установки показаний на нуль, в том числе при работе устройства выборки массы тары	$\pm 0,25d$			
Диапазон предварительного задания массы тары, не более	100 % Max			
Скорость движения ленты конвейера взвешивания (v), м/мин, не более	12	12	12	12

Наименование характеристики	Значение			
	TBC-1500	TBC-3000	TBC-4500	TBC-6000
Параметры электрического питания от сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц	от 187 до 242 от 49 до 51			
Напряжение питания УОАД от источника постоянного тока, В	от 18 до 34,2			
Габаритные размеры средства измерений, мм, не более – высота – ширина – длина	1500 3000 10000			
Масса средства измерений, кг, не более	3000			
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность (без конденсации влаги), %, не более	от -10 до +40 80			

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе средства измерений методом гравировки (или с помощью наклейки), а также на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Устройство весоизмерительное автоматическое ТВС	—	1 шт.
Руководство по эксплуатации	—	1 экз.
Методика поверки	—	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 4 «Инструкция по эксплуатации» документа «Устройства весоизмерительные автоматические ТВС. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 4 июля 2022 г № 1622 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы»;

ТУ 28.99.39–001–20590179–2017 «Устройства весоизмерительные автоматические ТВС. Технические условия».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «СКАМАТИК» (ООО «СКАМАТИК»)
ИНН 7701377400
Юридический адрес: 105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 2, помещ. 1Н/3
Адрес места осуществления деятельности: 105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 2, помещ. 1Н/3
Телефон/факс: (499) 50-09-689
E-mail: info@scamatic.ru
Web-сайт: scamatic.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон/факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru
Web-сайт: www.vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.