

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «07» июля 2025 г. № 1381

Регистрационный № 83619-21

Лист № 1  
Всего листов 6

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Датчики температуры ДТМ

#### Назначение средства измерений

Датчики температуры ДТМ (далее – датчики) предназначены для автоматических непрерывных измерений температуры твердых, сыпучих, жидких сред и влажности газовоздушной среды во взрывоопасных зонах предприятий горнодобывающей и нефтегазовой промышленности в составе системы газоаналитической шахтной многофункциональной «Микон III» разработки ООО «Ингортех», других измерительных системах и автоматизированных системах контроля.

#### Описание средства измерений

Датчики являются многофункциональными, многоканальными (в зависимости от исполнения) приборами непрерывного действия для измерения температуры.

Принцип действия датчиков температуры ДТМ при измерении температуры основан на зависимости характеристик металлического или полупроводникового элемента от температуры, при измерении влажности основан на зависимости емкостного полимерного элемента от влажности.

Датчики выпускаются в пяти исполнениях ДТМ-1, ДТМ-2, ДТМ-3, ДТМ-4 и ДТМ-П, – отличающиеся конструкцией и метрологическими характеристиками.

Датчики в исполнении ДТМ-1 (2, 3, 4) представляют собой защитную оболочку со съемными крышками. На оболочке располагаются кабельные вводы для линий питания и сигнальных линий. В защитной оболочке располагаются электронные модули, служащие для формирования выходных сигналов и для обработки и отображения информации. Датчики могут быть оборудованы дисплеем.

Датчики в исполнении ДТМ-1 (2) имеют встроенный первичный измерительный преобразователь температуры и влажности, расположенный в нижней части защитной оболочки. Датчики в исполнении ДТМ-3 (4) комплектуются датчиками ДТМ-П, которые используются в качестве первичных измерительных преобразователей.

К датчикам в исполнении ДТМ-3 (4) возможно подключение до 10 датчиков температуры в исполнении ДТМ-П.

Код заказа датчиков с расшифровкой:

ДТМ	–	П
1		2

где 1 – наименование устройства: ДТМ;  
2 (1 символ) – обозначение типа средства измерений:

П – одноканальный первичный измерительный преобразователь температуры («П» может не указываться);

1 – одноканальный измерительный преобразователь температуры с дополнительными функциями индикации давления и относительной влажности газообразной смеси, внешний интерфейс – напряжение постоянного тока (0,4-2,0) В;

2 – одноканальный измерительный преобразователь температуры и относительной влажности с дополнительной функцией индикации давления газообразной смеси, внешний интерфейс – цифровой RS-485;

3 – четырехканальный измерительный преобразователь температуры, внутренний интерфейс – цифровой, комплектуется ДТМ-П код: 01.КК.ДДД, внешний интерфейс – напряжение постоянного тока (0,4-2,0) В;

4 – десятиканальный измерительный преобразователь температуры, внутренний интерфейс – цифровой, комплектуется ДТМ-П код: 01.КК.ДДД, внешний интерфейс – цифровой RS-485.

Исполнение ДТМ-П имеют дополнительные модификации, обозначенные с помощью кода со следующей структурой:

Код:	ТТ	.	КК	.	ДДД
	1	2	3		

где 1 (2 символа) – тип измерительного преобразователя (от 00 до ZZ):

01 – цифровой MicroLAN;

02 – Pt100;

03 – Pt500

2 (2 символа) – обозначение типа корпуса (от 00 до 09):

01 – прямой корпус;

02 – угловой корпус;

3 (3 символа) – длина погружной части, мм: 030, 045, 085, 120, 155, 195, 270, 300, 310, 320.

Отображение результатов измерений доступно в исполнениях ДТМ-1, ДТМ-2, ДТМ-3.

Датчики ДТМ-П, ДТМ-4 не имеют индикации.

Общий вид датчиков температуры ДТМ приведен на рисунках 1 - 6.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт датчиков в соответствии с действующим законодательством. Датчики имеют заводские номера, обеспечивающие идентификацию каждого экземпляра, номер наносится методом гравировки на идентификационной табличке на лицевой стороне датчиков.

Идентификационная табличка на корпусе датчиков представлена на рисунке 7.

Предусмотрено пломбирование от несанкционированного доступа, защита от несанкционированного доступа обеспечивается посредством нанесения бумажной пломбы на самоклеющейся основе на боковые поверхности корпуса датчика. Схема пломбировки представлена на рисунке 8.



Рисунок 1 – Датчик температуры ДТМ исполнение ДТМ-1



Рисунок 2 – Датчик температуры ДТМ исполнение ДТМ-2



### Рисунок 3 – Датчик температуры ДТМ исполнение ДТМ-3



Рисунок 4 – Датчик температуры ДТМ исполнение ДТМ-4



Рисунок 5 – Датчик температуры ДТМ исполнение ДТМ-П (Код исполнения ТТ.01.ДДД)



Рисунок 6 – Датчик  
температуры  
ДТМ исполнение ДТМ-П  
(Код исполнения  
ТТ.02.ДДД)



Рисунок 7 – Идентификационная табличка на корпусе датчиков

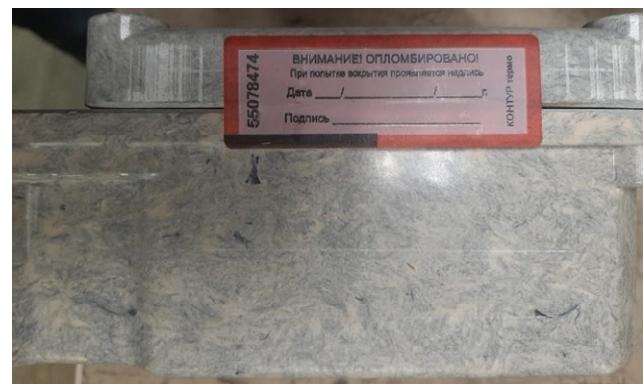


Рисунок 8 – Способ пломбирования датчиков

## Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) состоит из внутреннего ПО, встроенного в датчики, и внешнего ПО.

Внутреннее ПО, встроенное в датчики, является метрологически значимым.

Идентификационные данные ПО указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные встроенного ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
ДТМ-1	
Идентификационное наименование ПО	041410.001.06.002 dtm1 20160422 rls
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	М3: 1.0.15 МН3: 20160422
ДТМ-2	
Идентификационное наименование ПО	041410.001.06.002 dtm2 20181108 rls
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	М3: 2.0.31 МН3: 20181108
ДТМ-3	
Идентификационное наименование ПО	041410.001.06.002 dtm3 20180130 rls
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	М3: 3.0.12 МН3: 20180130
ДТМ-4	
Идентификационное наименование ПО	041410.001.06.002 dtm4 20170517 rls
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	М3: 4.0.21 МН3: 20170517

Конструкция датчиков исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

## Метрологические и технические характеристики

Метрологические и основные технические характеристики датчиков приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры, °C - для исполнений ДТМ-П (код: 01.КК.ДДД), ДТМ-3, ДТМ-4 - для исполнений ДТМ-1, ДТМ-2 - для исполнений ДТМ-П (код: 02.КК.ДДД, код: 03.КК.ДДД)	от – 10 до + 85 от – 10 до + 35 от – 10 до + 150
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C: - для исполнений ДТМ-1, ДТМ-2, ДТМ-3, ДТМ-4 - для исполнений ДТМ-П (код: 01.КК.ДДД) - для исполнений ДТМ-П (код: 02.КК.ДДД, код: 03.КК.ДДД)	± 0,5 ± 1,0 ± 2,5
Диапазон измерений относительной влажности для исполнения ДТМ-2 <sup>1)</sup> , %	от 10 до 100

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности <sup>1)</sup> , %:	
- в диапазоне от 10 % до 90 % включ.	± 4,0
- в диапазоне св. 90 % до 100 %	± 6,0
<sup>1)</sup> Диапазон измерений и пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности датчиком ДТМ-2 в условиях эксплуатации при атмосферном давлении выше 119,7 кПа не нормируются.	

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации датчиков:	
- температура окружающего воздуха, °С	
- для исполнений ДТМ-1, ДТМ-2, ДТМ-3, ДТМ-4	от – 20 до +40
- для исполнений ДТМ-П (код: 01.КК.ДДД, 02.КК.ДДД)	от – 20 до +125
- для исполнений ДТМ-П (код: 03.КК.ДДД)	от – 20 до +250
- атмосферное давление, кПа	от 87,6 до 130,0
- относительная влажность окружающего воздуха, %	от 0 до 100
Габаритные размеры, мм, не более:	
- для исполнений ДТМ-П без кабеля (длина×диаметр)	320×20
- для исполнений ДТМ-1, ДТМ-2, ДТМ-3, ДТМ-4 (длина×ширина×высота)	320×165×98
Масса, кг, не более:	
- для исполнений ДТМ-П	0,4
- для исполнений ДТМ-1, ДТМ-2, ДТМ-3, ДТМ-4	2,7
Ток потребления (при номинальном напряжении питания), мА, не более	30
Потребляемая мощность, мВ·А, не более	360
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	от 8 до 14
Время прогрева, мин, не более	10
Уровень и вид взрывозащиты	РО Ex ia I Ma X
Степень защиты от внешних воздействий (по ГОСТ 14254)	IP54
Срок службы, лет, не менее	6
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	20 000

**Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом, а также на идентификационную табличку на лицевой стороне датчиков методом гравировки.

**Комплектность средства измерений**

Комплект поставки датчиков приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Комплект поставки датчиков

Наименование	Обозначение	Количество
Датчики температуры	ДТМ*	1 шт.
Руководство по эксплуатации	ИГТ.301013.000.00.000РЭ	1 экз.
Паспорт	ИГТ.301013.000.00.000ПС	1 экз.
Методика поверки	-	1 экз.
Примечание – *	В соответствии с заказом	

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в разделе 1.5 «Устройства и работа» руководства по эксплуатации ИГТ.301013.000.00.000РЭ.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2024 г. № 2712 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2023 г. № 2415 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов»;

ТУ 26.51.51.110-028-44645436-2020 «Датчики температуры ДТМ. Технические условия».

### **Правообладатель**

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные горные технологии»  
(ООО «Ингортех»)

ИНН 6659026925

Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 100, оф. 1

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные горные технологии»  
(ООО «Ингортех»)

ИНН 6659026925

Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 100, оф. 1

Телефон: +7 (343) 318-01-71

E-mail: info@ingortech.ru

### **Испытательный центр**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»  
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, помещ. VII, ком. 6

Телефон: +7 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312126.

### **в части вносимых изменений**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

Адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 2а

Телефон: 8 (343) 236-30-15

E-mail: uraltest@uraltest.ru

Web-сайт: www.uraltest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30058-13.