

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «14» января 2025 г. № 51

Регистрационный № 94331-25

Лист № 1
Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры показывающие дифференциальные ТМД-6

Назначение средства измерений

Манометры показывающие дифференциальные ТМД-6 (далее – дифманометры) предназначены для измерений разности давлений воздуха и негорючих газов.

Описание средства измерений

Принцип действия дифманометра основан на уравновешивании разности давлений силами упругой деформации чувствительного элемента (мембранны).

Измеряемая разность давлений воздействует на мембранны и вызывает ее деформацию. Передача смещения измерительного элемента приводит к изменению положения магнита относительно спирали на оси стрелки и угловому перемещению указателя стрелки относительно шкалы.

Дифманометры изготавливаются в металлическом корпусе, с чувствительным элементом в виде мембранны, калиброванной пружины, магнита, спирали с высокой магнитной проницаемостью и органического стекла с фиксирующим кольцом. Дифманометры выпускаются в одном исполнении. Присоединение дифманометров к процессу универсальное, присоединение штуцеров к корпусу дифманометров может осуществляться как в радиальном, так и в осевом направлении.

Структура условного обозначения дифманометров при заказе и в документации другой продукции (расшифровка буквенного кода приведена в таблице 1):

Манометр показывающий дифференциальный ТМД-6-БВГ(диапазон)Д.Г.Е.

Таблица 1 – Расшифровка буквенного кода заказа дифманометров

Место в обозначении кода	Наименование характеристики	Значение характеристики
Б	Условное обозначение номинального диаметра корпуса	«5» – 100 мм
ВГ	Серия прибора	В – Материал корпуса: «1» – углеродистая сталь; «2» – нержавеющая сталь; «3» – алюминий Г – Материал штуцера: «0» – медный сплав; «1» – нержавеющая сталь.

Продолжение таблицы 1

Место в обозначении кода	Наименование характеристики	Значение характеристики
(диапазон)	Диапазон измерений разности давлений	в соответствии с таблицей 2
Д	Максимальное статическое давление	в соответствии с таблицей 2
G	Размер резьбы присоединительных штуцеров	«2xG1/8»; «2xG1/4»; «2xG1/2»; «2xNPT1/8»; «2xNPT1/4»; «2xNPT1/2»; «2xM12×1,5»; «2xM18×1,5»
E	Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности	«2,0» – ±2,0 %; «3,0» – ±3,0 %; «4,0» – ±4,0 %

Пример для заказа:

Манометр показывающий дифференциальный ТМД-6-530(0–20Па)100кПа.2xNPT1/8.4,0

(Манометр показывающий дифференциальный ТМД-6 с номинальным диаметром корпуса 100 мм из алюминия, с присоединительными штуцерами из медного сплава, с диапазоном измерений разности давлений от 0 до 20 Па с максимальным статическим давлением 100 кПа, на присоединительных штуцерах дюймовая трубная коническая резьба NPT1/8, с пределами допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности ±4,0 %).

Общий вид манометров представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид манометров показывающих дифференциальных ТМД-6

Защита от несанкционированного доступа осуществляется пломбированием путем нанесения на кольцо и боковую поверхность корпуса прибора специальной наклейки, которая разрушается при попытке ее удалить и вскрыть корпус. Пломбирование корпуса дифманометра ограничивает доступ к внутренним элементам конструкции. Схема пломбировки дифманометров предотвращающая доступ к элементам конструкции, представлена на рисунке 2.

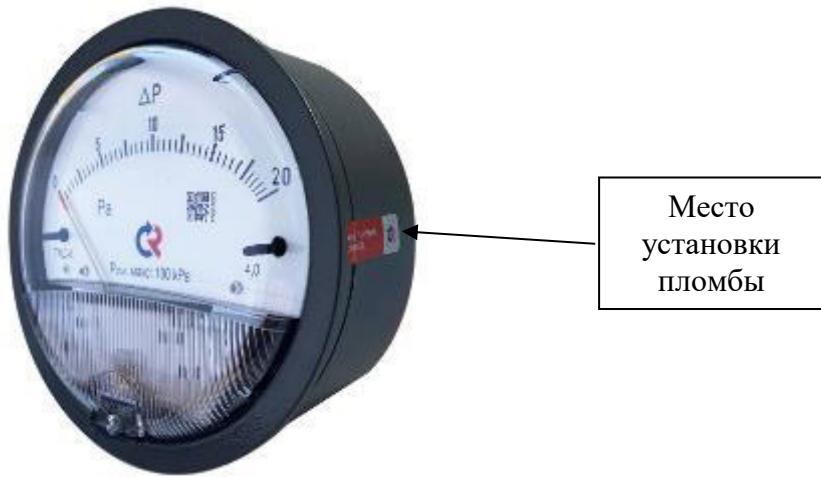


Рисунок 2 – Схема пломбировки дифманометров от несанкционированного доступа

Заводской номер в виде цифрового и (или) цифро-буквенного обозначения, состоящего из арабских цифр и (или) букв(ы) латинского алфавита и арабских цифр, а также QR-кода, наносится на циферблат дифманометра методом струйной печати или лазерной гравировки в соответствии с рисунком 3.

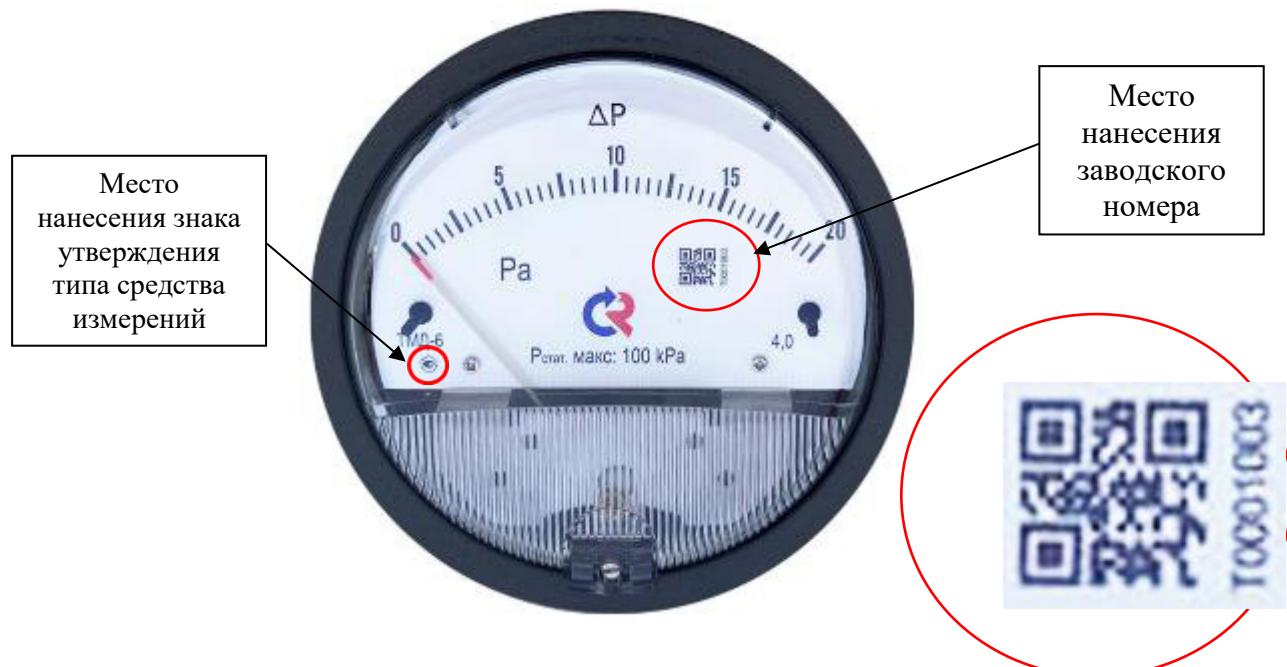


Рисунок 3 – Места нанесения заводского номера
и знака утверждения типа средства измерений

Знак поверки дифманометров в виде оттиска наносится на корпус манометра (краской, наклейкой). Место нанесения знака поверки на корпус манометра указано на рисунке 4.



Рисунок 4— Места нанесения знака поверки на корпус средства измерений

Метрологические и технические характеристики
приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики		
Диапазон измерений разности давлений ⁴⁾	от -125 до 125 Па; от 0 до 250 Па; от -250 до 250 Па; от 0 до 300 Па; от 0 до 500 Па; от 0 до 750 Па; от 0 до 1000 Па; от 0 до 1,5 кПа; от 0 до 2 кПа; от 0 до 2,5 кПа; от 0 до 3 кПа; от 0 до 4 кПа; от 0 до 5 кПа; от 0 до 6 кПа; от 0 до 7 кПа; от 0 до 8 кПа; от 0 до 9 кПа; от 0 до 10 кПа; от 0 до 15 кПа; от 0 до 20 кПа; от 0 до 25 кПа; от 0 до 30 кПа; от -0,5 до 0,5 кПа; от -1 до 1 кПа; от -1,25 до 1,25 кПа; от -1,5 до 1,5 кПа	от -50 до 50 Па; от -60 до 60 Па; от 0 до 125 Па; от -100 до 100 Па	от 0 до 20 Па; от 0 до 30 Па; от -30 до 30 Па; от 0 до 60 Па
Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности, %	$\pm 2,0$	$\pm 3,0$	$\pm 4,0$

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение характеристики		
Вариация показаний, %, не более	$\pm 2,0^{1)}$	$\pm 3,0^{2)}$	$\pm 4,0^{3)}$
Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10°C , %, не более	$\pm 0,1$		
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$ - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от +21 до +25 от 30 до 80 от 84 до 106,7		
Температура измеряемой среды для дифманометров, $^{\circ}\text{C}$:	от -7 до +60		
Максимальное статическое давление, кПа	100		
Диаметр корпуса (Д), мм, не более	121		
Ширина корпуса (Ш), мм, не более	60		
Масса, кг, не более	0,55		
Примечания:	<p>1 – Для дифманометров с пределами допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности $\pm 2,0\%$.</p> <p>2 – Для дифманометров с пределами допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности $\pm 3,0\%$.</p> <p>3 – Для дифманометров с пределами допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности $\pm 4,0\%$.</p> <p>4 – Диапазон измерений равен диапазону показаний. Приведен ряд значений характеристики, конкретный диапазон измерений разности давлений из приведенных рядов указывается в паспорте дифманометра.</p> <p>5 – Приборы могут изготавливаться с другими единицами измерения давления, допущенными к применению в Российской Федерации, а для приборов, поставляемых на экспорт, также с другими единицами измерений по запросу заказчика.</p>		

Знак утверждения типа

наносится на циферблат манометра типографским способом в соответствии с рисунком 3 и на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Манометр показывающий дифференциальный ТМД-6	в соответствии с заказом	1 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации	НСРП.406123.026ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	НСРП.406123.026РЭ	по требованию
Принадлежности по заказу: клапанные блоки, кронштейны, отборные устройства, трехходовые краны, переходники (адаптеры) и др.	-	по требованию

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в разделе 2 «Описание» эксплуатационного документа НСРП.406123.026ПС.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений разности давлений до $1 \cdot 10^5$ Па, утвержденная приказом Росстандарта от 31 августа 2021 г. № 1904;

Манометры показывающие дифференциальные ТМД-6. Технические условия НСРП.406123.026ТУ.

Правообладатель

Закрытое акционерное общество «РОСМА» (ЗАО «РОСМА»)

ИНН 4719015564

Юридический адрес: 188382, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, гп. Вырица, Сиверское ш., д. 168

Телефон: +7 (812) 325-25-08

E-mail: info@rosma.spb.ru

Web-сайт: <https://www.rosma.spb.ru>

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «РОСМА» (ЗАО «РОСМА»)

ИНН 4719015564

Юридический адрес: 188382, Ленинградская обл., Гатчинский р-н,
гп. Вырица, Сиверское ш., д. 168

Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 5, лит. В

Адрес места осуществления деятельности: 197229, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная
Лахта, д. 48, к. 4, лит. А

Телефон: +7 (812) 325-25-08

E-mail: info@rosma.spb.ru

Web-сайт: <https://www.rosma.spb.ru>

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие
«Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 88, стр. 8

Телефон (факс): +7 495-491-78-12

E-mail: sittek@mail.ru; mce-info@mail.ru

Web-сайт: <https://www.kip-mce.ru>

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311313.

