

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «16» июля 2025 г. № 1445

Регистрационный № 95900-25

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дозаторы пипеточные автоклавируемые одноканальные ЛЕНПИПЕТ

Назначение средства измерений

Дозаторы пипеточные автоклавируемые одноканальные ЛЕНПИПЕТ (далее – дозаторы) предназначены для измерения объема жидкостей.

Описание средства измерений

Принцип действия дозаторов основан на создании в съемном, герметично надеваемом на штуцер дозатора наконечнике попаременно вакуума или избыточного давления, в результате чего в наконечнике набирается или сливается из него дозируемая жидкость. Вакуум и избыточное давление создаются при перемещении поршня, расположенного в герметично уплотненном цилиндре. Объем дозы дозаторов определяется диаметром поршня и его перемещением.

Дозаторы представляют собой механические поршневые одноканальные устройства с варьируемыми объемами доз.

Значение объема дозы дозаторов задается путем вращения кольца для установки объема и отображается на цифровом дисплее, встроенным в рукоятку дозаторов. Значение диапазона объема дозирования дозаторов маркируется на их рукоятке.

Для работы дозаторов используются сменные наконечники. Каждый дозатор оснащен системой сброса наконечника, которая приводится в действие с помощью отдельной кнопки, расположенной на корпусе дозатора.

Дозаторы выпускаются в 9 модификациях: ДПАОП-1-0,1-2,5, ДПАОП-1-0,5-10, ДПАОП-1-2-20, ДПАОП-1-5-50, ДПАОП-1-10-100, ДПАОП-1-20-200, ДПАОП-1-100-1000, ДПАОП-1-500-5000, ДПАОП-1-1000-10000, отличающихся диапазонами дозирования, дискретностью установки объема доз, вариантами исполнения корпуса. Все модификации дозаторов полностью автоклавируемые.

Корпус дозаторов изготовлен из пластика, окрашен в цвета в соответствии с технической документацией производителя. Каждая модификация дозаторов имеет разные цвета кнопок для нажатия в зависимости от объема.

Серийный номер и обозначение модификации дозатора наносятся на рукоятку дозатора способом лазерной печати, а также на маркировочную этикетку типографским способом. Маркировочная этикетка расположена на упаковке дозатора в виде наклейки. Серийный номер имеет буквенно-цифровой формат.

Общий вид дозаторов и место нанесения серийного номера на дозаторы представлено на рисунке 1. Общий вид маркировочной этикетки и место нанесения серийного номера и знака утверждения типа представлено на рисунке 2.

Пломбирование и нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрены.



Рисунок 1 – Общий вид дозаторов

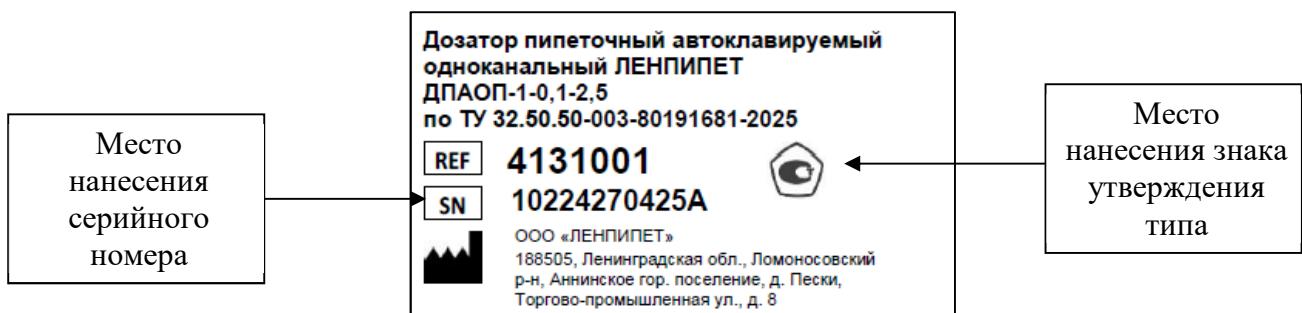


Рисунок 2 – Общий вид маркировочной этикетки дозаторов

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Обозначение модификации дозатора	Диапазон объемов дозирования, мкл	Дискретность установки объема, мкл	Значения объемов дозирования при поверке, мкл	Пределы допускаемой относительной систематической погрешности*, %	Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения случайной погрешности*, %
ДПАОП-1-0,1-2,5	от 0,1 до 2,5	0,002	2,5	±6,0	5,0
			0,20	±20,0	7,0
ДПАОП-1-0,5-10	от 0,5 до 10	0,01	10	±2,0	1,5
			1	±7,0	5,0
ДПАОП-1-2-20	от 2 до 20	0,02	20	±3,0	0,8
			2	±5,0	2,0
ДПАОП-1-5-50	от 5 до 50	0,05	50	±1,5	0,6
			5	±2,5	1,5
ДПАОП-1-10-100	от 10 до 100	0,1	100	±1,5	0,6
			10	±2,0	1,0
ДПАОП-1-20-200	от 20 до 200	0,2	200	±1,5	0,6
			20	±3,0	0,8
ДПАОП-1-100-1000	от 100 до 1000	1	1000	±1,0	0,4
			100	±1,5	0,6
ДПАОП-1-500-5000	от 500 до 5000	5	5000	±1,0	0,4
			500	±1,0	0,4
ДПАОП-1-1000-10000	от 1000 до 10000	10	10000	±1,0	0,4
			1000	±1,0	0,4

* В промежуточных точках между заданными значениями объемов дозирования при поверке показатели точности соответствуют значениям, установленным для верхних значений объемов дозирования при поверке в абсолютной форме.

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры дозаторов, длина дозаторов без наконечников, мм, не более	280
Масса дозаторов без наконечников, г, не более	130
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более	от +15 до +30 80

Таблица 3 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Средний срок службы, лет	4
Средняя наработка на отказ, циклов	100000

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом и на маркировочную этикетку типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1 Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ЛЕНПИПЕТ	В соответствии с заказом	1 шт.
2 Пенал упаковочный	–	1 шт.
3 Смазка	–	1 шт.
4 Фильтр	–	4 шт.
5 Пинцет для фильтра	–	1 шт.
6 Кольцо уплотнительное	–	2 шт.
7 Наконечник	–	2 шт.
8 Методика поверки	–	1 шт.
9 Руководство по эксплуатации	–	1 шт.
10 Паспорт	–	1 шт.

Примечания:

1. Позиция 4 и 5 комплектуется только с одноканальными дозаторами модификаций ДПАОП-1-100-1000, ДПАОП-1-500-5000 и ДПАОП-1-1000-10000.
2. Для позиции 7 количество варьируется в зависимости от модификации.
3. Поставка может осуществляться в любых сочетаниях дозаторов и соответствующих им наконечников.
4. По требованию потребителя наконечники поставляются по отдельному заказу, в отдельной упаковке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе «Порядок работы» документа «Дозаторы пипеточные автоклавируемые одноканальные ЛЕНПИПЕТ. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместительности при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, утвержденная приказом Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356;

ТУ 32.50.50-003-80191681-2025 «Дозаторы пипеточные автоклавируемые одноканальные ЛЕНПИПЕТ». Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская пипетка»
(ООО «ЛЕНПИПЕТ»)
ИНН 7816738532
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 19, лит. И, помещ. 5Н, оф. 1В

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская пипетка»
(ООО «ЛЕНПИПЕТ»)
ИИН 7816738532

Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 19, лит. И, помещ. 5Н,
оф. 1В

Адрес места осуществления деятельности: 188505, Ленинградская обл., Ломоносовский
р-н, гп. Аннинское, д. Пески, ул. Торгово-Промышленная, стр. 8

Испытательный центр

Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологии имени Д.И. Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева»)

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311373.

