

СОГЛАСОВАНО
Директор НПОДО «ФАРМЭК»
B.B. Малнач
« 31 » 03 2025

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора БелГИМ
Ю.В. Козак

« 08 » 05 2025

Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь
БЛОКИ ДАТЧИКОВ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ФСТ-03В2 Т
Методика поверки
МРБ МП.4247-2025
Листов 14

Разработчик:
Ведущий инженер
по метрологии
НПОДО «ФАРМЭК»
В.М. Корень
« 31 » 03 2025

Минск, 2025



КОПИЯ ВЕРНА

Настоящая методика поверки (далее – МП) распространяется на блоки датчиков термокatalитические ФСТ-03В2 Т (далее – БД) производства НПОДО «ФАРМЭК», Республика Беларусь, по [1] и устанавливает методы и средства первичной и последующей поверки.

В зависимости от исполнения, предназначены для непрерывного автоматического измерения концентрации метана или пропана, или водорода, или довзрывных концентраций горючих газов и паров.

БД обеспечивает передачу измеренной концентрации по интерфейсу типа А, или по аналоговому интерфейсу (4–20) мА, или (0–2) В.

Обязательные метрологические требования, предъявляемые к БД, приведены в приложении А.

1 Нормативные ссылки

В настоящей МП использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 181–2023 (33240) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ТКП 427-2022 (33240) Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 13045-81 Ротаметры. Общие технические условия;

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности;

ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов.

Примечание - При пользовании настоящей МП целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящей МП следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	последующей поверке
1 Внешний осмотр	8.1	да	да
2 Опробование	8.2	да	да
2.1 Проверка функционирования	8.2.1	да	да
2.2 Идентификация программного обеспечения	8.2.2	да	нет
3 Определение метрологических характеристик	8.3	да	да
3.1 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности по поверочному компоненту	8.3.1	да	да
4 Оформление результатов поверки	9	да	да

Примечание – Если при проведении той или иной операции поверки получают отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Номер пункта МП	Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики
1	2
6	<p>Термогигрометр testo 625. Диапазон измерений относительной влажности от 5 % до 95 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 3 \%$, диапазон измерений температуры от минус 10 °C до плюс 60 °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,6 \%$ C</p> <p>Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 по [2]. Диапазон измерений от 80 до 106 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,2 \text{ кПа}$</p> <p>Насадка - диаметр 30,5 мм (внутренний)</p>
8.1 – 8.3.4	<p>Стандартные образцы состава газовых смесей (далее - CO): CH₄ – воздух, C₃H₈ – воздух, H₂-воздух, C₆H₁₄ - воздух</p> <p>Воздух класса 0 по ГОСТ 17433</p> <p>Секундомер электронный «Интеграл С-01» [3] Диапазон измерений от 0 с до 9 ч 59 мин 59,99 с Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности $\pm(9,6 \cdot 10^{-6} T_x + 0,01)$, где T_x – значение измеренного интервала времени, с</p> <p>Ротаметр РМ-А-0,063ГУЗ, ГОСТ 13045 Верхний предел измерений 0,063 м³/ч, кл. т. 4</p> <p>Вентиль точной регулировки ВТР, АПИ4.463.002</p> <p>Трубка поливинилхлоридная (ПВХ), 6×15 мм [4]</p> <p>Источник питания регулируемый (0-25) В, (0-1) А</p> <p>Калибратор токовой петли РЗУ-420. Основная приведенная погрешность $\pm 0,1 \%$; $\pm 1,0 \%$</p> <p>Мультиметр цифровой серии Multicon Mxx, тип M11 Основная погрешности $\pm(0,01U + 5 \text{ е.м.п.})$; $\pm(0,02 I + 5 \text{ е.м.п.})$</p>
8.1 – 8.3.4	<p>Устройство отображения концентрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - блок питания и сигнализации ФСТ-03В1 (далее – БПС) – U 230 В; - тестер А - интерфейса – U + 5 В $\pm 5 \%$; - модуль калибровки – Ue + 5 В $\pm 5 \%$
Примечания	
1 При проведении поверки допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.	
2 При проведении поверки на территории Российской Федерации допускается применение секундометра механического 3кл. по ТУ 25-1819.0021-90 или ТУ 25-1894.003-90.	
3 Отношение погрешности средств поверки и погрешности поверяемого БД должно быть не более 1:3.	
4 Все эталоны должны иметь действующие знаки поверки и (или) свидетельства о поверке (калибровке). СО в баллонах под давлением должны иметь действующие сертификаты.	



4 Требования к квалификации поверителей

К проведению измерений при поверке и (или) обработки результатов измерений допускают лиц, имеющих необходимую квалификацию в области обеспечения единства измерений.

5 Требования безопасности

5.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

5.2 При работе со СО в баллонах под давлением необходимо соблюдать требования, изложенные в [5].

5.3 Лица, проводящие поверку, должны быть ознакомлены и соблюдать правила безопасной работы с БД согласно [6] и средствами поверки, приведенными в эксплуатационной документации (далее – ЭД) на них.

5.4 Все работы по эксплуатации и поверке БД должны проводиться с соблюдением требований ТКП 427, ТКП 181.

6 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- | | |
|--|---------------|
| - температура окружающего воздуха, °С | 20 ± 5 ; |
| - относительная влажность окружающего воздуха, % | от 30 до 80; |
| - атмосферное давление, кПа | от 80 до 106. |

7 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- готовят БД к работе в соответствии с требованиями ЭД [6];
- проверяют наличие паспортов и сроки годности СО;
- баллоны с СО выдерживают в помещении, где проводится поверка, в течение 24 ч в соответствии с паспортами (сертификатами) на баллоны;
- проводят сборку схем, которые приведены в приложениях Б и В;
- проверяют соответствие условий требованиям раздела 6.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие БД следующим требованиям:

- комплектность должна соответствовать установленной в описании типа;
- маркировка соответствует требованиям описания типа в части идентификации типа интерфейса и типа сенсора;
- отсутствие видимых дефектов (повреждение корпуса и др.), влияющих на безопасность проведения поверки или результат поверки.

8.1.2 Результаты внешнего осмотра считают положительными при соответствии БД всем требованиям 8.1.1.

8.2 Опробование


БД поверяют в зависимости от исполнения, а именно от типа интерфейса БД.

Интерфейс определяют исходя из маркировки БД.

Система идентификации БД: ФСТ-03В2 Т.уза

Вторая характеристическая цифра (z) обозначает тип интерфейса блока датчика:

0 – А-интерфейс для связи с устройством отображения концентрации (далее – УОК);

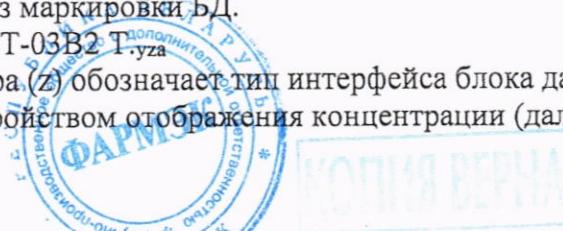

1 – аналоговый интерфейс (4-20) мА (А-интерфейс для связи с УОК является технологическим и используется для настройки БД);

2 – аналоговый интерфейс (0-2) В (А-интерфейс для связи с УОК является технологическим и используется для настройки БД).

8.2.1 Проверка функционирования

БД с А-интерфейсом проверяют следующим образом.

Включить УОК.

Присоединить поверяемый БД к УОК по схеме, указанной в приложении В. После прогрева БД убедиться, что на отсчетном устройстве УОК правильно отображается тип БД (газа) и концентрация равна 0, либо не превышает 0,5 от основной погрешности БД.

БД с аналоговым интерфейсом (4-20) мА или (0-2) В проверяют следующим образом.

Собрать схему, указанную в приложении Б. При подключении БД на калибраторе токовой петли должны отображаться значения тока в диапазоне от 3,9 мА до 4,1 мА, а на мультиметре должны отображаться значения напряжения в диапазоне от 1,95 В до 2,05 В.

8.2.2 Идентификация программного обеспечения

Проверку проводить в следующем порядке:

– подключить БД к УОК;

– убедиться, что на информационном табло УОК отображается номер версии программного обеспечения (далее – ПО) и цифровой идентификатор ПО.

Результаты поверки считаются положительными, если идентификационные данные встроенного ПО БД соответствуют номеру версии ПО не ниже, указанного в таблице Г.1 приложения Г и в описании типа.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Проверка диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности по поверочному компоненту

Проверку диапазона измерений и определение основной абсолютной погрешности в диапазоне температур (20 ± 5) °C проводится с использованием СО, содержащим поверочный компонент в трех точках диапазона измерений. Номинальное содержание определяемого компонента, соответствующее точкам диапазона измерений, и пределы допускаемых отклонений от него приведены в таблице 3. Время подачи СО для определяемых компонентов 2 мин.

Таблица 3 – Содержание определяемого компонента

Номер СО	Содержание определяемого компонента, соответствующее точкам диапазона измерений, %
1	10 ± 10
2	50 ± 10
3	90 ± 10

Примечание – В качестве СО № 1 допускается использовать воздух класса 0 по ГОСТ 17433.

При поверке по интерфейсу типа А собрать схему подачи стандартного образца (приложение В).

Подсоединить к схеме баллон с СО № 1.

Включить и прогреть БД на воздухе. На УОК должно отображаться значение «0». При необходимости произвести подстройку нуля в соответствии с ЭД. Допускается отображение концентрации, не превышающей 0,5 от основной погрешности БД.

Открыть вентиль баллона. Вентилем точной регулировки установить расход СО, равный ($0,3 \pm 0,1$) л/мин.



На вход БД подают СО в последовательности № 1-2-3 (соответственно подаваемому компоненту и диапазону измерений таблицы 3) в течение 2 мин, время контролируют секундомером.

Фиксируют значение концентрации определяемого компонента (C_ϕ), индицируемое на УОК. Затем определяют основную погрешность по поверочному компоненту.

Рассчитать основную абсолютную погрешность БД ΔC , % (об.) (% НКПР) по каждому компоненту, для которых нормированы пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по формуле

$$\Delta C = C_\phi - C_{CO}, \quad (1)$$

где C_ϕ – значение концентрации определяемого компонента, индицируемое на УОК, % (об.) (% НКПР);

C_{CO} – концентрация определяемого компонента по паспорту на СО, % (об.) (% НКПР).

При поверке по аналоговому интерфейсу (4-20) мА или (0-2) В собрать схему измерения (приложение Б) и схему подачи стандартного образца (приложение В).

Подсоединить к схеме баллон с СО № 1.

Включить и прогреть БД на воздухе. При необходимости произвести подстройку нуля в соответствии с ЭД.

Открыть вентиль баллона. Вентилем точной регулировки установить расход СО, равный $(0,3 \pm 0,1)$ л/мин.

На вход БД подают СО в последовательности № 1-2-3 (соответственно подаваемому компоненту и диапазону измерений таблицы 3) в течение 2 мин, время контролируют секундомером.

Фиксируют установившиеся значения тока на калибраторе токовой петли (4-20) мА или значения напряжения (0-2) В на мультиметре при подаче каждого СО.

При поверке по аналоговому интерфейсу (4-20) мА рассчитать измеренное значение концентрации определяемого компонента C_ϕ , % (об.) (% НКПР) по формуле

$$C_\phi = \frac{(I_\phi - 4) \cdot C_{20}}{16}, \quad (2)$$

где I_ϕ – измеренное значение тока, мА;

C_{20} – концентрация, соответствующая верхней границе диапазона измерений определяемого компонента, % (об.) (% НКПР).

Определяют основную абсолютную погрешность по поверочному компоненту по формуле (1) настоящей методики.

При поверке по аналоговому интерфейсу (0-2) В рассчитать измеренное значение концентрации определяемого компонента C_ϕ % (об.) (% НКПР) по формуле:

$$C_\phi = \frac{(U_\phi - 0,4) \cdot C_2}{1,6}, \quad (3)$$

где U_ϕ – измеренное значение напряжения, В;

C_2 – концентрация, соответствующая верхней границе диапазона измерений определяемого компонента, % (об.) (% НКПР).

Определяют основную абсолютную погрешность по поверочному компоненту по формуле (1) настоящей методики.

БД считают прошедшим поверку, если пределы допускаемой погрешности БД не превышают значений, указанных в таблице А.1 (приложение А).

9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки заносятся в протокол, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Д.

9.2 При положительных результатах первичной поверки БД, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, на БД и в паспорт [6] наносят знак поверки и (или) выдают свидетельство о поверке по форме, установленной [7].

При положительных результатах последующей поверки БД, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, на БД наносят знак поверки и (или) выдают свидетельство о поверке по форме, установленной [7].

9.3 При отрицательных результатах первичной поверки БД, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, выдают заключение о непригодности по форме, установленной [7].

При отрицательных результатах последующей поверки БД, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, выдают заключение о непригодности по форме, установленной [7], ранее нанесенный знак поверки подлежит уничтожению путем приведения его в состояние, непригодное для дальнейшего применения, предыдущее свидетельство о поверке прекращает свое действие.



Приложение А
(обязательное)

**Обязательные метрологические требования к блокам датчиков
термокатализитическим ФСТ-03В2 Т**

Обязательные метрологические требования к блокам датчиков термокатализитическим ФСТ-03В2 Т приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 - Обязательные метрологические требования к БД ФСТ-03В2 Т



Обозначение блока датчика термокатализитического	Диапазон измерений концентрации	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$
ФСТ-03В2 Т.yza CH ₄	от 0 % (об.) до 2,50 % (об.)	$\pm 0,22\%$ (об.)
ФСТ-03В2 Т.yza C ₃ H ₈	от 0 % (об.) до 1,00 % (об.)	$\pm 0,08\%$ (об.)
ФСТ-03В2 Т.yza H ₂	от 0 % (об.) до 2,0 % (об.)	$\pm 0,2\%$ (об.)
ФСТ-03В2 Т.yza Ex*	от 0 % НКПР до 50 % НКПР	$\pm 5\%$ НКПР

*Нормирование метрологических характеристик при измерении довзрывных концентраций Ех на термокатализитическом сенсоре производится по гексану. В соответствии с ГОСТ IEC 60079-29-1 НКПР для гексана равен 1,0 % (об.).



Приложение Б (обязательное)

Схемы для проверки режимов работы БД и соответствующих им значений тока с интерфейсом (4-20) мА или напряжения с интерфейсом (0-2) В

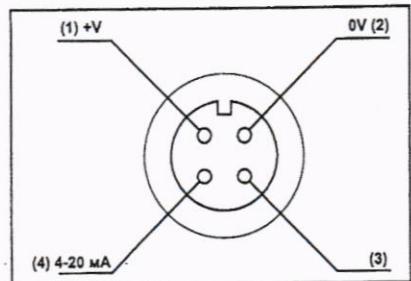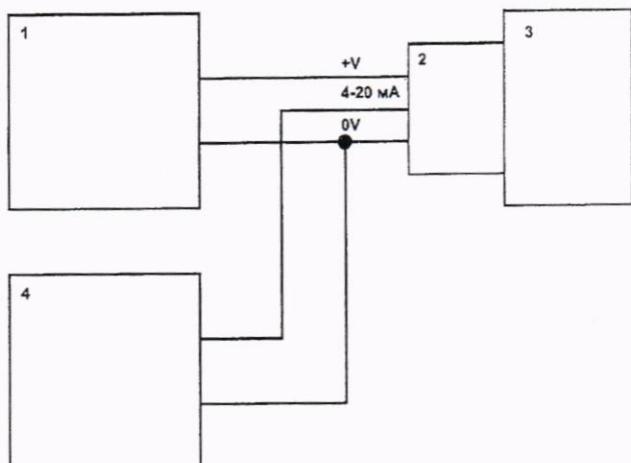

Распайка розетки РY07-04Т


- 1 – источник питания 12 В или канал УОК;
- 2 – розетка РY07-04Т;
- 3 – блок датчика;
- 4 – мультиметр или калибратор токовой петли.

Рисунок Б.1 - Схема измерения напряжения мультиметром или измерения тока калибратором токовой петли



Приложение В
(обязательное)

Схема подачи стандартного образца

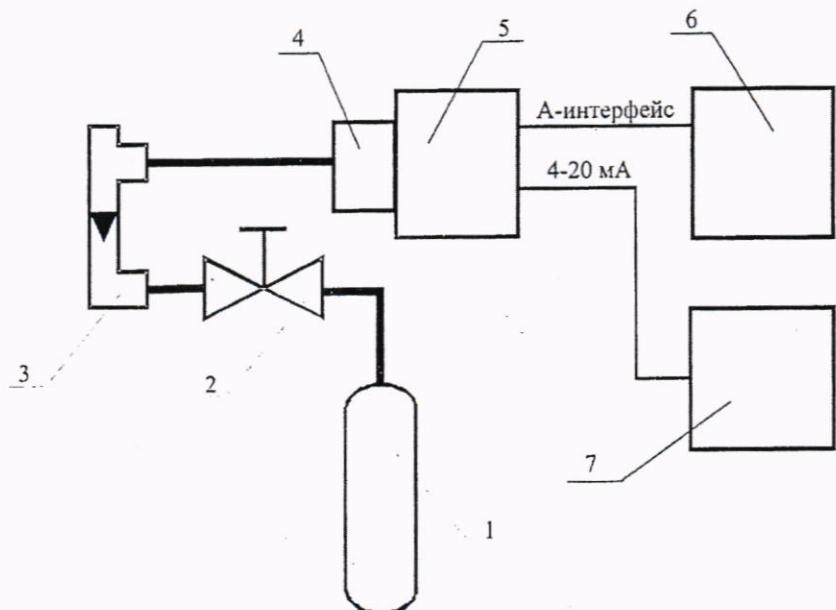

- 1 – баллон с СО;
- 2 – вентиль точной регулировки;
- 3 – ротаметр;
- 4 – микрокамера;
- 5 – поверяемый блок датчика;
- 6 – УОК для интерфейса типа А;
- 7 – калибратор токовой петли для интерфейса (4-20) мА или мультиметр для интерфейса (0-2) В (схема подключения согласно приложению Б).

Рисунок В.1 – Схема подачи стандартного образца



- 1 – УОК, например БПС или тестер А-интерфейса;
- 1.1 – адаптер А-интерфейса (например, модуль калибровки),
- 1.2 – устройство индикации;
- 2 – БД ФСТ-03В2.

Рисунок В.2 - Структурная схема устройства отображения концентрации



Приложение Г
(обязательное)
Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные ПО блоков датчиков термокатализических ФСТ-03В2 Т представлена в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Обозначение блока датчика термокатализического	Номер версии ПО (идентификационный номер)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма метрологической части исполняемого кода)
ФСТ-03В2 Т _{yz1} CH ₄	5.31	0x125A
	5.41	0x27E3
	5.51	0x0239
ФСТ-03В2 Т _{yz3} CH ₄	5.33	0x4A48
	5.43	0x73E1
	5.53	0x6EDA
ФСТ-03В2 Т _{yz1} C ₃ H ₈	5.31	0x54AD
	5.41	0x4AEC
	5.51	0x723E
ФСТ-03В2 Т _{yz3} C ₃ H ₈	5.33	0x3AEC
	5.43	0x25B1
	5.53	0x65C9
ФСТ-03В2 Т _{yz1} Ex	5.31	0x6FE6
	5.41	0x682D
	5.51	0xEAC4
ФСТ-03В2 Т _{yz3} Ex	5.33	0x4B1C
	5.43	0x43E1
	5.53	0x8547
ФСТ-03В2 Т _{yz1} H ₂	5.31	0x9CE1
	5.41	0x84EA
	5.51	0x51DE



Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ № _____

Поверки № _____

Наименование и тип средства измерений

Принадлежащего _____

Изготовитель НПОДО «ФАРМЭК»

Дата проведения поверки _____

Проверка проводится по МРБ МП.

Д.1 Условия проведения поверки:

– температура окружающего воздуха _____

– относительная влажность окружающего воздуха _____

– атмосферное давление _____

Д.2 Применяемые средства поверки

Таблица Д.1

Наименование средства измерений, тип	Основные параметры	Заводской номер	Дата очередной поверки, калибровки

Применяемые СО

Таблица Д.2

№ СО	Компоненты, входящие в СО	Содержание определяемых компонентов, % (об.) либо % НКПР		Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения СО, % (об.) либо % НКПР
		номинальное значение	допускаемое отклонение	
1				
2				
3				

Д.3 Результаты поверки

Д.3.1 Внешний осмотр _____

Д.3.2 Опробование _____

Д.3.3 Определение метрологических характеристик:

Таблица Д.3.1

Диапазон измерений компонента	Действительное содержание определяемых компонентов, % (об.) либо % НКПР	Значение концентрации определяемого компонента, индцируемое на УОК, % (об.) либо % НКПР	Абсолютная погрешность ΔC , % (об.) либо % НКПР	Пределы допускаемых значений, % (об.) либо % НКПР

Таблица Д.3.2

Диапазон измерений компонента	Концентрации, соответствующие току 4-20 мА или напряжению 0-2 В	Измеренное значение тока, мА или напряжения, В	Абсолютная погрешность ΔC , % (об.) либо % НКПР	Пределы допускаемых значений, % (об.) либо % НКПР

Д.4 Заключение _____

Д.5 Свидетельство о поверке (заключение о непригодности) № _____

Д.6 Поверитель _____

подпись

расшифровка подписи



Библиография

- [1] ТУ BY 100162047.038-2018. Блоки датчиков термокatalитические ФСТ-03В1 Т и ФСТ-03В2 Т. Технические условия
- [2] ТУ 25-11.1513-79 Барометр-анероид метеорологический БАММ-1
- [3] ТУ РБ 100231303.011 – 2002 Секундомер электронный «Интеграл С-01»
- [4] ТУ 64-2-286-79 Трубки медицинские поливинилхлоридные
- [5] Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ 28 января 2016 г. № 7
- [6] 100162047.038 ПС. Паспорт. Блоки датчиков термокatalитические ФСТ-03В2 Т
- [7] Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений. Утверждены постановлением Госстандарта от 21 апреля 2021 г. № 40.



Лист регистрации изменений

