

Регистрационный № 61424-15

Лист № 1
Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Установки измерительные «ОЗНА - Vx»

Назначение средства измерений

Установки измерительные «ОЗНА-Vx» (далее – установки) предназначены для непрерывных автоматизированных измерений массового расхода и массы скважинной жидкости, массы и массового расхода скважинной жидкости без учета воды и попутного нефтяного газа, массы нетто нефти, а также объемного расхода и объема попутного нефтяного газа в составе нефтегазоводяной или газоконденсатной смеси без предварительной сепарации многофазного потока, для измерений объемного расхода и объема природного и попутного нефтяного газа при добыче, подготовке и транспортировке газа с применением расходомеров многофазных Vx Spectra, расходомеров многофазных Vx 88 и расходомеров многофазных Vx (далее – расходомеры Vx).

Описание средства измерений

В установке используется бессепарационный прямой метод динамических измерений, основанный на использовании комбинации трубы Вентури и гамма-измерителя фракций, в спектре излучения которого используются два характерных энергетических пика. При прохождении потока в трубе Вентури возникает перепад давления, что позволяет измерять полный массовый и объемный расход потока, а гамма-измеритель фракций предоставляет данные о соотношении фракций нефти, газа и воды. Для измерений давления и температуры потока используются средства измерений с цифровым выходом. Вычислительное устройство расходомеров Vx производит расчет расхода фракций смеси - нефти, газа и воды на основе специально разработанной комплексной (гидродинамической, термодинамической и ядерной) физической модели, учитывающей особенности многофазного потока, включая присущую ему нестабильность.

Для учета неоднородности потока нефтегазоводяной смеси по времени и по сечению, расходомер Vx производит измерения параметров потока с частотой 45 Гц. Результаты, накопленные в течение 1 с, в дальнейшем подвергаются статистической обработке. Результаты измерений расходов фаз потока и его фракций сохраняются в памяти управляющего компьютера.

Для регистрации накопленных за определенный интервал времени значений массы скважинной жидкости, нефти и воды, а также объема газа расходомер Vx имеет функцию измерения интервалов времени.

Установки включают в себя блок(и) технологический(ие) (далее – БТ) и блок(и) аппаратный(ые) (далее – БА), оснащенные системами жизнеобеспечения (обогрев, освещение, вентиляция и пожаро-газосигнализация). Также установки могут иметь в своем составе отдельный

блок переключения скважин (далее - БПС). БТ, БА и БПС выполняются в виде блок-боксов, которые могут быть изготовлены на одном или отдельных рамных основаниях.

Установка может быть выполнена в виде одного блока путем размещения оборудования БА в БТ во взрывозащищенных оболочках.

БА и БТ могут быть закрытого (с укрытием) или открытого исполнения (без укрытия или с быстротъемными панелями, защищающими от атмосферных осадков, ветра и др.).

В случае открытого исполнения блоков система жизнеобеспечения не применяется или может включать не все компоненты в зависимости от технических требований. Установка может быть скомпонована в блок-боксах заказчика.

В состав конкретной установки могут входить другие дополнительные функциональные блоки, не выполняющие измерительной функции. Количество и исполнение блоков установки определяется в зависимости от количества подключаемых скважин и необходимости реализации дополнительных функций, помимо измерительных.

Установки могут изготавливаться как в стационарном, так и в мобильном варианте исполнения.

Основными элементами БТ является измерительная линия и распределительный модуль. В состав измерительной линии, оборудованной ручными и электроуправляемыми органами переключения потока, входит один или несколько расходомеров Vx. Распределительный модуль обеспечивает автоматическое поочередное подключение скважин к измерительной линии посредством системы трехходовых кранов или переключателя скважин многоходового (ПСМ), приводимого в действие электроуправляемым приводом. При этом продукция остальных скважин направляется в общий трубопровод. Распределительный модуль также оснащен байпасной линией для неавтоматизированного подключения скважин к измерительной линии при помощи задвижек.

Вариант исполнения установки выбирается на этапе анализа условий измерений в зависимости от ожидаемых величин расхода и свойств нефтегазоводяной смеси, а также выходных параметров установки.

В состав БТ могут входить:

- расходомеры многофазные Vx (регистрационный № 42779-09);
- расходомеры многофазные Vx 88 (регистрационный № 48745-11);
- расходомеры многофазные Vx Spectra (регистрационный № 60560-15);
- вспомогательные средства измерений (измерительные преобразователи (датчики) давления и температуры, манометры и термометры показывающие);
- переключатель(и) скважин ПСМ или БПС;
- привод(ы) гидравлический(ие) ГП-1М;
- ручные задвижки и/или краны/клапана запорные/трехходовые с электроприводами;
- линия байпасная;
- коллектор общий;
- входные и выходные линии для последовательного подключения эталонов;
- дренажная линия;
- фильтр;
- клапан обратный;
- система жизнеобеспечения (отопление, освещение и вентиляция);
- система определения загазованности и оповещения;
- система пожарной сигнализации;
- система охранной сигнализации.

БА осуществляет сбор, обработку, регистрацию, отображение, хранение полученных результатов измерений в архиве и их передачу в АСУТП верхнего уровня, а также управляет контрольно-измерительными приборами, автоматикой, системой жизнеобеспечения, охранной и пожарной сигнализацией.

В состав БА могут входить:

- шкаф силовой (далее – ШС);
- шкаф(ы) вспомогательный(ые);

- блок измерений и обработки информации (далее – БИОИ);
- система жизнеобеспечения (отопление, освещение и вентиляция);
- система пожарной сигнализации;
- система охранной сигнализации.

БИОИ выполнен на базе отдельных модулей ввода/вывода, и/или программируемых логических контроллеров (далее - ПЛК) и/или измерительно-вычислительного комплекса (далее – ИВК), и/или средства человеко-машинного интерфейса (далее - HMI), называемого также операторской панелью.

ИВК может быть реализован на базе встраиваемых компьютеров (Embedded Computer, без HMI), промышленных панельных компьютеров (Industry Panel Computer, совмещено с HMI) производства FIREFLY TECHNOLOGY CO, LTD (КНР), с операционной системой (ОС Linux\WinCE\QNX и т.п.), зарегистрированных как Вычислительные машины FIREFLY. Основные применяемые модели серий EC-A (EC-A3399ProC, EC-A3399C, EC-A3568J, EC-A3288C и др.), IPC (IPC-M10R800-A3568J, IPC-M10R800-A3399C, IPC-M10R800-A3288C и др.) и их аналоги на базе процессоров ARM64.

ИВК может выполнять функции и заменять собой в составе БИОИ промышленный ПЛК (в случае использования совместно с отдельными модулями ввода-вывода) и/или HMI, но может использоваться и вместе с ними, в зависимости от состава конкретного исполнения БИОИ.

Если БА не применяется, то возможны следующие конфигурации:

- ШС и/или БИОИ общепромышленного исполнения могут быть установлены удаленно в помещениях и/или на специально отведенных площадках на объекте заказчика;
- ШС и/или БИОИ взрывозащищенного исполнения могут быть установлены в БТ установки;
- ШС и/или БИОИ взрывозащищенного исполнения могут быть смонтированы вне установки на специально отведенных площадках на объекте заказчика.

Номенклатура контроллеров, применяемых в установках, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Номенклатура применяемых контроллеров

Наименование, тип	Регистрационный №
Контроллеры SCADAPack 32/32P, 314/314E, 330/334 (330/334E), 350/357 (350E/357E), 312, 313, 337E, 570/575	69436-17
Контроллеры программируемые DirectLOGIC, CLICK, Productivity 2000, Productivity 3000, Protos X, Terminator	65466-16
Системы управления модульные B&R X20	57232-14
Контроллеры программируемые SIMATIC S7-300	15772-11
Модули измерительные контроллеров программируемых SIMATIC S7-1500	60314-15
Контроллеры измерительные ControlWave Micro	63215-16
Контроллеры SCADAPack	86492-22
Устройства центральные процессорные системы управления B&R X20	84558-22
Контроллеры программируемые логические BRIC	82839-21
Контроллеры программируемые логические АБАК ПЛК	63211-16
Контроллеры программируемые логические Unistream	62877-15
Контроллеры программируемые логические MKLogic200 A	85559-22
Контроллеры измерительные K15	75449-19
Модули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов MDS	37445-09
Модули автоматики NL	75710-19
Контроллеры программируемые ЭЛСИ-TMK	62545-15
Системы распределенного ввода вывода CREVIS/СУЭР	80690-20

Внешний вид и схема пломбирования установки представлены на рисунках 1-3.

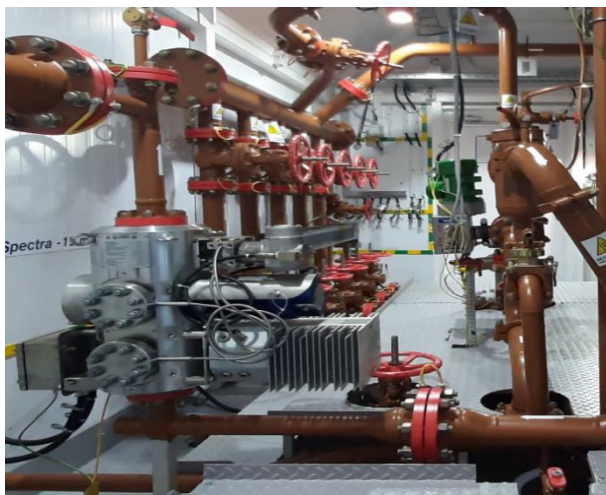


Рисунок 1 – Внешний вид оборудования БТ многоскважинной установки



Рисунок 2 – Внешний вид оборудования БА общепромышленного исполнения



Заводской номер



Пломба службы качества



Заводской номер



Пломба службы качества

Рисунок 3 – Внешний вид и схема пломбирования БТ и БА установки

Заводской номер установки указывается на металлической табличке, закрепленной на наружной поверхности БА и БТ, или на наружной поверхности блок-бокса заказчика, методом лазерной гравировки. В случае открытого исполнения заводской номер установки указывается на металлической табличке, закрепленной на БИОИ.

Формат нанесения заводского номера – цифровой. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Программное обеспечение

Комплекс программного обеспечения (далее – ПО) установок реализован в БИОИ.

Комплекс ПО состоит из следующих компонентов:

1. ПО ЧМИ* - человеко-машинный интерфейс (при наличии НМИ в составе БИОИ);
2. ПО АСУ* – автоматизированная система управления;
3. ПО СПД – сбор и передача данных;
4. ПО ВПД – вычислитель параметров дебита.

Примечание:

* - не является метрологически значимым модулем.

Комплекс ПО (метрологически значимые модули) выполняет функции:

ПО СПД:

- обеспечение управления процессом измерений при помощи команд, подаваемых дистанционно – с верхнего уровня АСУТП эксплуатирующего предприятия;
- обеспечение сбора, хранения, обработки и передачи первичных данных расходомеров Vх, других средств измерений и КИПиА, входящих в состав установок;
- обеспечение хранения результатов измерений в энергонезависимой памяти ПЛК/ИВК в течение года и более;
- обеспечение защищенной передачи результатов измерений в локальный НМИ, на верхний уровень АСУТП эксплуатирующего предприятия по цифровым сетям, выгрузки на цифровые носители;

ПО ВПД:

- обеспечение обработки данных расходомеров Vх, других средств измерений и КИПиА, входящих в состав установок, и вычисления результатов измерений согласно аттестованной методики измерений.

Размещение компонентов ПО осуществляется в ИВК или в ПЛК (при отсутствии ИВК в составе БИОИ).

Идентификационные данные ПО установок приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	ПО СПД	ПО ВПД
Идентификационное наименование ПО	IS.VX.101	IS.VX.201
Номер версии (идентификационный номер) ПО	2.xxxxxx ¹⁾	2.zzzzzz ¹⁾
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	уууу ²⁾ .0B83	kkkk ²⁾ .69E1
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC-16	CRC-16
Примечания:		
¹⁾ – номер подверсии из шести десятичных цифр, предназначен для отслеживания исходных текстов ПО СПД \ ПО ВПД в системе контроля версий производителя, может быть любым;		
²⁾ – служебный идентификатор ПО СПД \ ПО ВПД из четырех шестнадцатеричных цифр, расположен перед контрольной суммой, может быть любым.		

Уровень защиты ПО установок от непреднамеренных и преднамеренных изменений «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014 «Рекомендации по метрологии. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения»

Механическая защита от несанкционированного доступа к ПЛК\ИВК осуществляется пломбированием наклеек на корпус встраиваемого компьютера ИВК и\или ПЛК БИОИ для предотвращения вскрытия корпуса и выполнения операции замены системного программного обеспечения (ОС встраиваемого компьютера ИВК, firmware ПЛК и т.п.), как показано на рисунках 4 и 5.

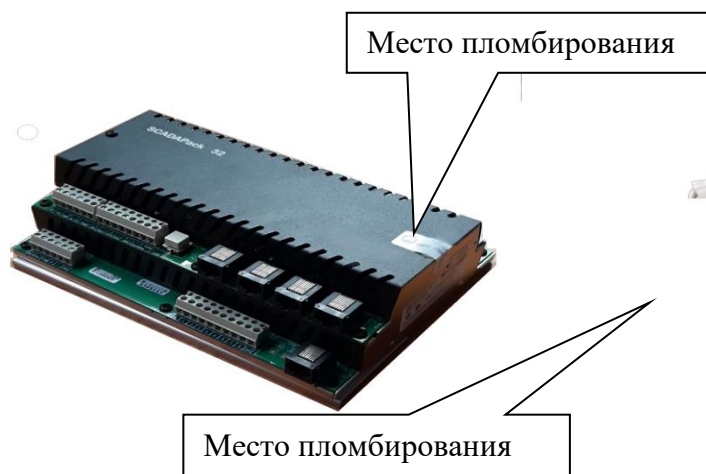


Рисунок 4 – Схема пломбирования корпуса ПЛК

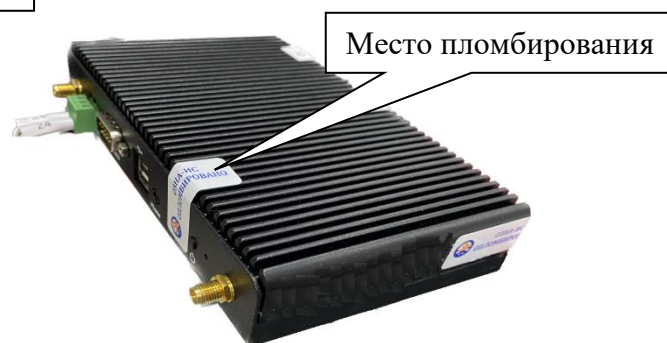


Рисунок 5 – Схема пломбирования корпуса встраиваемого компьютера ИВК

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики установок приведены в таблицах 3, 4, 5, показатели надежности приведены в таблице 6.

Таблица 3 – Метрологические характеристики установок

Наименование характеристики	Значение
Диапазон массового расхода скважинной жидкости, т/ч ^{1),2)}	от 0,01 до 662,40
Диапазон объемного расхода газа в рабочих условиях в составе многофазного потока, м ³ /ч ¹⁾	от 0,1 до 4400,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы и массового расхода скважинной жидкости, %	± 2,5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема и объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям, в составе многофазного потока, %:	± 5,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы и массового расхода скважинной жидкости без учета воды и попутного нефтяного газа, при содержании воды (в объемных долях), %: - от 0 до 70 % - от 70 до 95 % - св. 95 %	± 6,0 ± 15,0 не нормируется
¹⁾ детальная информация по диапазону измерений и оптимальному режиму эксплуатации для каждой установки приведена в эксплуатационной документации;	
²⁾ для расходомеров многофазных Phase Watcher Vx нормируется объемный расход жидкости, м ³ /ч, для определения метрологических характеристик установок необходим пересчет в массовый расход жидкости с учетом параметров измеряемой среды.	

Таблица 4 – Технические характеристики установок при применении различных модификаций расходомеров Vx

	Модификация расходомеров Vx		
	Vx Spectra	Vx Spectra Снегирь	Phase Watcher Vx
	Vx 19; Vx 29; Vx 40; Vx 65; Vx 88	Vx 19R; Vx 19RH; Vx 29R; Vx 29RH; Vx 40R; Vx 40RH; Vx 65R; Vx 65RH; Vx 88R; Vx 88RH	Vx 29; Vx 52; Vx 88
Рабочая среда	нефтегазоводяная или газоконденсатная смесь, нефть, попутный газ, природный газ		
Объемный расход жидкости в составе нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, м³/ч	-		от 6,0 до 730,0 ¹⁾
Давление рабочей среды, МПа, не более ¹⁾	34,5	6,3 ²⁾	34,0
Температура рабочей среды, °С	от -46 до +121	от -40 до +90	от -20 до +150
Температура окружающей среды, °С	от -40 до +85	от -40 до +45	от -20 до +85
Вязкость дегазированной жидкой фазы, мПа·с	от 0,1 до 30000 ³⁾		
Объемное содержание воды (WLR), %	от 0 до 100 включ.		
Объемное содержание свободного газа в потоке (GVF), %	от 0 до 100 включ.		
¹⁾ подробная информация приведена в паспорте на установку; ²⁾ типоразмер в исполнении (RH) модификации Vx Spectra Снегирь выпускается с рабочим давлением 16,0 МПа ³⁾ рекомендуемый диапазон вязкости жидкости в рабочих условиях не более 2000 мПа·с; возможно измерение жидкости более высокой вязкости, при условии проведения специальной калибровки			

Таблица 5 – Технические характеристики установок

Наименование характеристики	Значение
Род тока	Переменный
Напряжение питания, В	380/220
Допустимое отклонение от номинального напряжения, %	от минус 15 до плюс 10
Частота, Гц	50 ± 0,4
Потребляемая мощность, кВт·А, не более	20
Маркировка взрывозащиты	II Gc IIA T3 X
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP54

Таблица 6 – Показатели надежности установок

Наименование характеристики	Значение
Средняя наработка на отказ, ч, не более	131400
Срок службы, лет, не менее	20

Знак утверждения типа

наносится на металлические таблички, укрепленные на БТ и БА-блоках, методом лазерной маркировки или аппликацией, а также типографским или иным способом на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта.

Комплектность средства измерений

Комплектность установок приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Комплектность установки

Наименование	Кол-во	Примечание
Установка измерительная «ОЗНА-Vх»	1	В соответствии с заказом
в том числе*: - блок технологический - блок аппаратный - блок переключения скважин	- - -	
Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП)	1	Согласно ведомости ЗИП
Комплект эксплуатационных документов (РЭ, ПС)	1	Согласно ведомости эксплуатационных документов
Комплект монтажных частей (далее – КМЧ)	1	Согласно ведомости КМЧ
* Обозначение установки и блоков, входящих в ее состав, выбирается исходя из конфигурации установки, определяемой заказом		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документах «ГСИ. Масса скважинной жидкости, объем попутного нефтяного газа. Методика измерений с применением установок измерительных «ОЗНА-Vх» АО «ОЗНА-Измерительные системы». (Свидетельство об аттестации от 09.08.2021 г. № 01.00257 – 2013/10809-21); «ГСИ. Масса нефти и объем попутного нефтяного газа. Методика измерений с применением установок измерительных «ОЗНА-Vх» на лицензионных участках ООО «АнгараНефть» (Свидетельство об аттестации от 09.12.2025 г. № RA.RU.314707/10809-25).

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (перечень, п. 6.2.1, п. 6.5)

ГОСТ Р 8.1016-2022 «ГСИ. Измерения количества нефтегазоводяной смеси и ее компонентов. Общие метрологические и технические требования» (п. 6.2)

ГОСТ 8.637- 2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массового расхода многофазных потоков»

ТУ 3667-094-00135786-2009 «Установки измерительные «ОЗНА-Vх». Технические условия»

Изготовитель

Акционерное общество «ОЗНА - Измерительные системы»

(АО «ОЗНА - Измерительные системы»)

ИНН 0265037983

Адрес: 452606, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, зд. 60

Тел./факс: (34767) 7-01-03

E-mail: ms@ozna.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии – филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

(ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 19

Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7 «а»

Телефон: +7(843) 272-70-62

Факс: +7(843)272-00-32

E-mail: office@vniir.org

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU 310592

В части вносимых измерений

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева»

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 19

Адрес места осуществления деятельности: 420088, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»

Телефон (факс): (843) 272-70-62, (843) 272-00-32

Web-сайт: vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.314555