
**МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА МНОГОЗНАЧНЫЕ Р3026**


**Внесены
в Государственный
реестр
под № 8478—81**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 28 октября
1981 г.**

**Выпуск разрешен
до 01.07.87**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Меры электрического сопротивления постоянного тока многозначные Р3026 предназначены для использования в качестве регулируемой меры сопротивления в цепях постоянного тока.

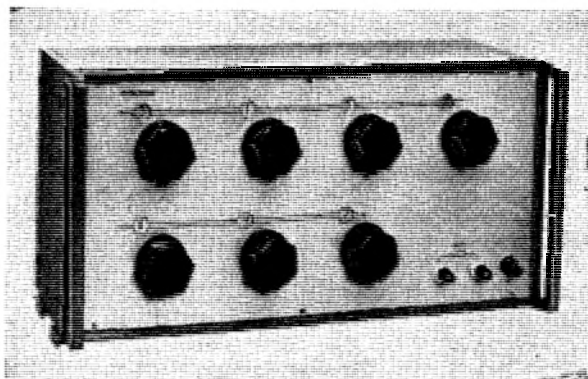

ОПИСАНИЕ

Меры построены по схеме, обеспечивающей подключение с помощью переключателей к выходным зажимам сопротивления любого значения от 0,01 до 111111,1 Ом.

Мера содержит семь декадных переключателей, смонтированных на монтажной плате прямоугольного металлического корпуса. В пяти декадах (от 10×10000 до 1×1 Ом) использованы фольговые резисторы, обладающие малыми (от -3 до $10 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) температурными коэффициентами сопротивления и высокой стабильностью во времени.

Меры выпускаются трех модификаций с обозначениями Р3026-1; Р3026-2 и Р3026-3, отличающиеся друг от друга классом точности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цена ступени младшей декады 0,01 Ом.

Число декад 7.

Классы точности: Р3026-1 0,002; Р3026-2 0,005; Р3026-3 0,01.

Мощность рассеивания на ступень: Р3026-1 0,005; Р3026-2 0,01; Р3026-3: 0,05 Вт.

Габаритные размеры $485 \times 240 \times 250$ мм.

Масса 11 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с каждой мерой поставляют: принадлежности для ухода за переключателями; техническое описание и инструкцию по эксплуатации; формуляр.

ПОВЕРКА

Методика поверки мер изложена в ГОСТ 8.001—80 и СТ СЭВ 593—77.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривало НПО «Метрология».

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.