

ОКП 42 2861 5

Группа П32


СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ФГУ "Ставропольский ЦСМ"

*В.И. Зеренков*

"3" 2007 г.

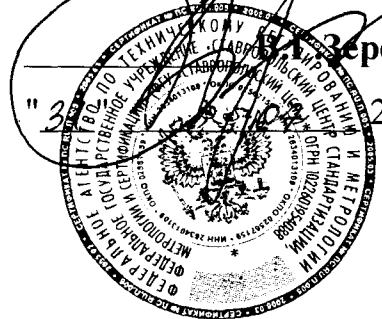

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Концерн Энергомера"

*В.И. Поляков*

" " 2007 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ ИНЕС.121-07

об изменении "3" ИНЕС.411152.082 Д1

ар 30939-07

|                                                                          |                      |          |                    |                       |                     |                  |                      |          |        |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------|--------|-------------------|--|
| КИЭП<br>"Энергомера"                                                     | Извещение            |          | Обозначение        |                       | Причина             |                  | Шифр                 | Лист     | Листов |                   |  |
|                                                                          | ИНЕС.121-07          |          | ИНЕС.411152.082 Д1 |                       | Введение исполнений |                  | -                    | 2        | 2      |                   |  |
|                                                                          | Дата выпуска         |          | Срок изм.          |                       |                     | Срок действия ПИ |                      |          |        |                   |  |
| Указание о заделе                                                        | Задела нет           |          |                    |                       |                     |                  | Указание о внедрении |          |        |                   |  |
|                                                                          |                      |          |                    |                       |                     |                  | Внедрить с           |          |        |                   |  |
| Изм.<br><b>3</b>                                                         | Содержание изменения |          |                    |                       |                     |                  | Применяемость        |          |        |                   |  |
| Лиcты 2, 4, 5 изм. "2" аннулировать и заменить листами 2, 4, 5 изм. "3". |                      |          |                    |                       |                     |                  |                      |          |        |                   |  |
| CE 101                                                                   |                      |          |                    |                       |                     |                  |                      |          |        |                   |  |
| ИНЕС.411152.082                                                          |                      |          |                    |                       |                     |                  |                      |          |        |                   |  |
| Разослать по картотеке БТД                                               |                      |          |                    |                       |                     |                  |                      |          |        |                   |  |
| Приложение                                                               |                      |          |                    |                       |                     |                  |                      |          |        |                   |  |
| -                                                                        |                      |          |                    |                       |                     |                  |                      |          |        |                   |  |
| Составил                                                                 |                      | Проверил |                    | Т. контр.             |                     | Н. контр.        |                      | Утвердил |        | Предст. заказчика |  |
| Гриценко                                                                 |                      | Щцкин    |                    | Беспалова             |                     | 23.07.           |                      |          |        |                   |  |
| Подлинник исправил                                                       |                      |          |                    | Контр. копию исправил |                     |                  |                      |          |        |                   |  |

Настоящая методика поверки предназначена для проведения поверки счетчиков однофазных однотарифных электроэнергетики СЕ 101, класса точности 1 и 2 (в дальнейшем - счетчики).

Методика устанавливает объем, условия испытаний, методы и средства экспериментального исследования метрологических характеристик счетчиков и порядок оформления результатов поверки.

Межповерочный интервал - 16 лет.

## 1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции поверки, указанные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Операция                                                                              | Номер пункта настоящей методики поверки | Обязательность выполнения операции при поверке |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                       |                                         | первичной                                      | периодической |
| Внешний осмотр                                                                        | 7.1                                     | Да                                             | Да            |
| Проверка электрической прочности изоляции                                             | 7.2                                     | Да                                             | Да            |
| Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и испытательного выхода | 7.3                                     | Да                                             | Да            |
| Проверка стартового тока                                                              | 7.4                                     | Да                                             | Да            |
| Проверка без тока нагрузки                                                            | 7.5                                     | Да                                             | Да            |
| Определение метрологических характеристик                                             | 7.6                                     | Да                                             | Да            |

1.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки счетчик бракуют и его поверку прекращают.

1.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, счетчик вновь представляют на поверку.

## 2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Средства поверки                                                      | Номер пункта настоящей методики поверки | Основные технические характеристики средства поверки                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Универсальная пробойная установка УПУ-10                              | 7.2                                     | Частота 50 Гц; испытательное напряжение до 10 кВ; погрешность установки напряжения $\pm 4\%$                                                                                                                             |
| Установка ЭНЕРГОМЕРА СУ001/Х-ХХ-Р0 (в дальнейшем - установка СУ001 *) | 7.3...7.6                               | Основная погрешность $\delta = \pm 0,24\%$ при $\cos \varphi = 1$ , $\delta = \pm 0,32\%$ при $\cos \varphi = 0,5$ ; диапазон напряжений (100..264) В; диапазон частот (47,5..52,5) Гц; диапазон силы тока (0,01..120) А |
| Секундомер СОСпр-26                                                   | 7.2, 7.4, 7.5                           | 60 с; 60 мин, класс точности 2                                                                                                                                                                                           |

**Внимание.** \* - В качестве датчика тока в счетчике применен шунт. Цепь тока соединена с цепью напряжения внутри счетчика. В связи с этим, установка СУ001 должна эксплуатироваться с блоком гальванической развязки.

2.2 Допускается применение других средств поверки, по метрологическим характери-

стикам не уступающих указанным в п. 2.1.

2.3 Используемые средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с нормативными документами по ГОСТ Р 8.568-97.

### 3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К поверке счетчиков допускают лиц, аттестованных в качестве поверителей в установленном порядке в соответствии с ПР 50.2.012-94.

## 4 Требования безопасности

4.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

4.2 При проведении поверки счетчиков необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в эксплуатационных документах на поверочную установку.

4.3 К работе на поверочной установке следует допускать лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний. Специалист, осуществляющий поверку счетчиков, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

## 5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха ( $23 \pm 2$ ) °С;

относительная влажность воздуха (30...80) %;

атмосферное давление (84...106) кПа или (630...795) мм рт.ст.;

внешнее магнитное поле – отсутствует;

частота измерительной сети ( $50 \pm 0,5$ ) Гц;

форма кривой тока и напряжения – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 5 %;

отклонение значения фазного напряжения от среднего значения  $\pm 1$  %;

отклонение значения силы тока от среднего значения  $\pm 1$  %.

5.2 На первичную поверку следует предъявлять счетчики, принятые ОТК организации-изготовителя или уполномоченным на то представителем организации, проводившим ремонт.

5.3 На периодическую поверку следует предъявлять счетчики по истечении 16 лет с момента предыдущей поверки, а также счетчики, которые были подвергнуты регулировке или ремонту.

## 6 Подготовка к поверке

Проверяют работоспособность средств поверки и готовят к работе поверочную установку согласно эксплуатационным документам на нее.

## 7 Проведение поверки

### 7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют комплектность, маркировку, наличие схемы подключения счетчика на крышке зажимов, отметки о приемке счетчика ОТК (при первичной поверке) или отметки о предыдущей поверке (при периодической поверке), а также соответствие внешнего вида счетчика требованиям ГОСТ Р 52320-2005.

Цифры роликового электромеханического счетного механизма не должны выходить за пределы окошек более чем на 1/5 своей высоты (это требование не относят к крайнему справа ролику, а также к другим роликам, если они в данный момент вращаются вместе с крайним справа роликом или при переходе через нуль).

На корпусе и крышке зажимов счетчика должны быть места для навески пломб, все

крепящие винты должны быть в наличии, резьба винтов должна быть исправна, а механические элементы хорошо закреплены.

## 7.2 Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции при воздействии напряжением переменного тока проводят в последовательности и в соответствии с режимами, установленными в таблице 5 ГОСТ Р 52322-2005 для счетчиков классов точности 1 и 2.

Счетчик не должен иметь пробоя или перекрытия изоляции испытываемых цепей.

## 7.3 Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и испытательного выхода

7.3.1 Счетчик подключают к поверочной установке в соответствии с его схемой подключения и эксплуатационными документами на поверочную установку и прогревают при  $P_{ном}$ . Время прогрева счетчика должно быть не менее 2 мин.

Опробование работы счетного механизма заключается в следующем:

- светодиод, включающийся одновременно с испытательным выходным устройством, при включении токовых цепей в прямом направлении (коэффициент мощности равен 1) и при обратном направлении (коэффициент мощности равен минус 1) работает непрерывно (частота включения пропорциональна входной мощности), и при этом показания счетного механизма возрастают.

7.3.2 Правильность работы счетного механизма счетчика проверяют по приращению показаний счетного механизма счетчика и числу включений светодиода включающегося с частотой испытательного выходного устройства (числу импульсов на испытательном выходе).

Результат проверки считают положительным, если на каждое изменение состояния счетного механизма происходит  $n$  срабатываний светодиода в соответствии с формулой:

$$n = \frac{C}{K \cdot 10^{(m-1)}} \quad (7.1)$$

где  $C$  – постоянная счетчика (число импульсов испытательного выходного устройства счетчика на 1 кВт·ч), имп./кВт·ч;

$K = 10$  для электронного счетного механизма;

$K = 200$  для электромеханического счетного механизма;

$m$  – число разрядов от запятой справа.

7.3.3 Опробование и проверка работы испытательных выходов заключаются в установлении их работоспособности – наличия выходного сигнала, регистрируемого соответствующими устройствами поверочной установки.

## 7.4 Проверка стартового тока

Проверку стартового тока (порога чувствительности) счетчика проводят на поверочной установке при номинальном напряжении и коэффициенте мощности, равном единице, для каждого из направлений.

Результаты проверки считают положительными, если при токе запуска 0,01 А для счетчика с базовым током 5 А и при токе запуска 0,02 А для счетчика с базовым током 10 А светодиод, включающийся с частотой испытательного выходного устройства, включится хотя бы один раз за время наблюдения  $T$ , мин. определенное по формуле:

$$T = \frac{1,2 \cdot 6 \cdot 10^4}{C \cdot U_{ном} \cdot I_n \cdot \cos \varphi}, \quad (7.2)$$

где  $C$  – постоянная счетчика, имп/кВт·ч;

$U_{ном}$  – номинальное напряжение, В;

$I_n$  – стартовый ток, А;

$\cos \varphi$  – коэффициент мощности.

### 7.5 Проверка без тока нагрузки

Проверку без тока нагрузки (самохода) проводят на поверочной установке. К цепям напряжения счетчика прилагают напряжение, значение которого равно 115 % номинального значения, при этом ток в токовых цепях счетчика отсутствует.

Счетчик считают выдержавшим проверку, если за время испытаний  $\Delta t$ , мин, вычисленное по формуле не было зарегистрировано более одного включения светодиода, включающегося с частотой испытательного выходного устройства.

$$\Delta t \geq \frac{R \cdot 10^6}{C \cdot U_{\text{ном}} \cdot I_{\text{макс}}}, \quad (7.3)$$

где  $C$  – постоянная счетчика, имп/кВт·ч;

$U_{\text{ном}}$  – номинальное напряжение, В;

$I_{\text{макс}}$  – максимальный ток, А;

$R$  – коэффициент, равный 600 для счетчиков классов точности 1 и равный 480 для счетчиков класса точности 2.

### 7.6 Определение метрологических характеристик

7.6.1 Основную относительную погрешность счетчика определяют на поверочной установке для каждого из направлений измеряемой электрической энергии при номинальном напряжении.

7.6.2 Значения силы тока (далее – ток) и коэффициента мощности, а также соответствующие им пределы допускаемой основной относительной погрешности, выраженные в процентах, указаны в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Номер<br>испы-<br>тания | Информативные параметры<br>входного сигнала |                       |          | Предел допускаемого зна-<br>чения основной относи-<br>тельной погрешности, %,<br>счетчиков класса точности |       | Время<br>измере-<br>ния, с |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|                         | напряжение, %<br>от номинального            | ток, %<br>от базового | cos φ    | 1                                                                                                          | 2     |                            |
| 1                       | 115                                         | 5                     | 1,0      | ± 1,5                                                                                                      | ± 2,5 | 20                         |
| 2                       |                                             | 10                    | 0,5(инд) |                                                                                                            | -     |                            |
| 3                       | 0,8(емк)                                    |                       |          |                                                                                                            |       |                            |
| 4                       | 100                                         | 100                   | 1,0      | ± 1,0                                                                                                      | ± 2,0 |                            |
| 5                       | 75                                          | I <sub>МАКС</sub>     | 0,5(инд) |                                                                                                            | -     |                            |
| 6                       |                                             |                       | 0,8(емк) |                                                                                                            |       |                            |
| 7                       |                                             |                       |          |                                                                                                            |       |                            |

7.6.3 Значение основной относительной погрешности поверяемого счетчика определяют по показаниям вычислителя погрешности поверочной установки.

Результаты поверки считают положительными, если полученные значения основной относительной погрешности при всех токах нагрузки не превышают значений пределов допускаемой основной относительной погрешности, установленных в таблице 7.1.

### 8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки вносят в протокол, форма которого приведена в приложении А.

8.2 Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в соответствующем разделе формуляра, заверенной оттиском поверительного клейма установленной формы.

При проведении поверки на автоматизированной установке с распечаткой результатов поверки решение о признании пригодности счетчика принимают на основании распечатки протокола поверки, выданной автоматизированной установкой.

Счетчик пломбируют оттиском поверительного клейма установленной формы на оп-

ределенных для этого местах.

8.3 Положительные результаты периодической поверки счетчиков оформляют записью в соответствующем разделе формуляра по желанию владельца счетчика, выдают свидетельство о поверке установленной формы, гасят клеймо предыдущей поверки и пломбируют счетчик с оттиском поверительного клейма установленной формы на определенных для этого местах.

8.4 При отрицательных результата поверки оформляют извещение о непригодности установленной формы с указанием причин. Клеймо и свидетельство предыдущей поверки гасят. В формуляр вносят запись о непригодности с указанием причин.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей поверку)

**Протокол поверки счетчика**

Счетчик типа \_\_\_\_\_ Год выпуска \_\_\_\_\_ Изготовитель \_\_\_\_\_

Принадлежит \_\_\_\_\_

Основные технические характеристики по ТУ 4228-054-22136119-2005

- класс точности или предел допускаемой основной относительной погрешности \_\_\_\_\_

- номинальное напряжение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- номинальный ток \_\_\_\_\_

Дата предыдущей поверки \_\_\_\_\_

Поверочная установка типа \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,

свидетельство о поверке установки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г.,

срок действия до \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г.; эталонный счетчик типа \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_, предназначена для поверки счетчиков типа \_\_\_\_\_ и  
класса точности \_\_\_\_\_ при соотношении основных относительных по-  
грешностей эталонного и поверяемого счетчиков, не превышающем \_\_\_\_\_.

Результаты поверки:

Внешний осмотр \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Проверка изоляционных свойств \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и испытательных  
выходов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Проверка отсутствия самохода \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Проверка порога чувствительности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Результаты определения основной относительной погрешности:

| Напряжение, В | Нагрузка, % номи-<br>нального тока | cos φ | Основная относитель-<br>ная погрешность, % | Примечание |
|---------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|
|               |                                    |       |                                            |            |
|               |                                    |       |                                            |            |
|               |                                    |       |                                            |            |
|               |                                    |       |                                            |            |
|               |                                    |       |                                            |            |
|               |                                    |       |                                            |            |

Заключение \_\_\_\_\_

Поверку провел \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)