


**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»**

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

А.Н.Пронин
М.п. «15» 06 2026 г.



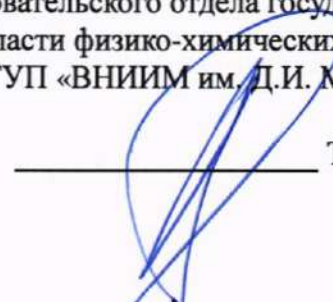
Государственная система обеспечения единства измерений

Системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ
на участке производства минеральных удобрений АО «Апатит» в г. Череповец


Методика поверки

МП 242-2629-2026

Заместитель руководителя
научно-исследовательского отдела государственных
эталонов в области физико-химических измерений
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»


Т.Б. Соколов

Инженер 2-ой категории научно-исследовательского
отдела Государственных эталонов в области
физико-химических измерений


К.А. Заречнов

Санкт-Петербург

2026 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ на участке производства минеральных удобрений АО «Апатит» в г. Череповец (далее – системы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Методика поверки обеспечивает прослеживаемость поверяемых измерительных каналов (далее – ИК) системы к Государственным первичным эталонам единиц величин:

- Государственный первичный эталон единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ 154-2019 в соответствии с Приказом Росстандарта от 31.12.2020 г. № 2315;

- Государственный первичный эталон единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 °С ГЭТ 34-2020 и Государственный первичный эталон единицы температуры - Кельвина в диапазоне от 0,3 до 273,16 К ГЭТ 35-2026 в соответствии с Приказом Росстандарта от 29.01.2026 № 147;

- Государственный первичный эталон единицы давления для области абсолютного давления в диапазоне $1 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^7$ Па ГЭТ 101-2025 в соответствии с приказом Росстандарта от 05.12.2025 № 2667;

- Государственный первичный специальный эталон единицы скорости воздушного потока ГЭТ 150-2012 в соответствии с приказом Росстандарта от 25.11.2019 № 2815.

Методы, обеспечивающие реализацию методики поверки: прямое измерение поверяемым средством измерений величины, воспроизводимой рабочим эталоном или стандартным образцом; непосредственное сличение поверяемого средства измерений с эталоном той же единицы величины.

Допускается проведение периодической поверки отдельных ИК на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, с обязательной передачей информации об объеме проведенной поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

В результате поверки должны быть подтверждены метрологические характеристики газоаналитических ИК и ИК параметров газового потока, приведенные в таблицах А.1 - А.5 приложения А настоящей методики.

2 Перечень операций поверки

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	Да	Да	7
Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	Да	8.1
Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	Да	8.8
Проверка программного обеспечения средства измерений	Да	Да	9

Продолжение таблицы 1

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	10
Определение погрешности ИК массовой концентрации аммиака с использованием ГСО	Да	Да	10.1
Определение погрешности ИК массовой концентрации аммиака на реальной среде	Да	Да	10.2
Определение погрешности ИК температуры, давления, скорости и объемного расхода газового потока	Да	Да	10.3
Определение погрешности ИК показателей выбросов аммиака	Да	Да	10.4

2.2 При отрицательных результатах одной из операций поверка прекращается.

3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки следует соблюдать следующие условия:

- температура окружающей среды, °С в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б);
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7;
- относительная влажность воздуха, % от 10 до 90.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки системы допускаются лица, ознакомленные с приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510, руководством по эксплуатации на систему, имеющие квалификацию поверителя, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические и технические требования к средствам поверки

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
8, 10 Подготовка к поверке и опробование средства измерений; определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	<p>Вентиль точной регулировки с диапазоном рабочего давления от 0 до 150 кгс/см², диаметр условного прохода 3 мм¹⁾</p> <p>Ротаметры для измерений объемного расхода (верхняя граница диапазона измерений 0,063 м³/ч, пределы допускаемой приведенной погрешности $\pm 2,5\%$)</p> <p>Трубка фторопластовая, диаметр условного прохода 5 мм, толщина стенки 1 мм¹⁾</p>	<p>Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160)</p> <p>Ротаметры РМФ-0,063 ГУЗ по ГОСТ 13045-80</p> <p>Трубка фторопластовая по ТУ 6-05-2059-87</p>
8.1 Контроль условий поверки	Средства измерений параметров окружающей среды: диапазон измерений температуры от +5 °С до +40 °С, относительной влажности от 10 до 95 %, атмосферного давления от 840 гПа до 1067 гПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности по каналам: относительной влажности не более $\pm 3\%$, температуры не более $\pm 0,4$ °С, атмосферного давления ± 5 гПа	Прибор комбинированный Testo-622 (рег. № в ФИФ ОЕИ ²⁾ 53505-13)
8.8.2 Проверка герметичности пробоотборного зонда с обогреваемой линией	Стандартные образцы состава газовых смесей (ГС) в баллонах под давлением – рабочие эталоны 2 разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденной Приказом Росстандарта от 31 декабря 2020 г. № 2315 (характеристики ГС приведены в таблице В.1 приложения В настоящей МП); азот о.ч. в соответствии с ГОСТ 9293-74	ГСО 12343-2023 ³⁾ (NH ₃ /N ₂); азот о.ч. в соответствии с ГОСТ 9293-74
10.1 Определение погрешности ИК массовой концентрации аммиака с	Стандартные образцы состава газовых смесей (ГС) в баллонах под давлением – рабочие эталоны 2 разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденной Приказом Росстандарта от 31 декабря 2020 г.	ГСО 12343-2023 ³⁾ (NH ₃ /N ₂); азот о.ч. в соответствии с ГОСТ 9293-74

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
использованием ГСО	№ 2315 (характеристики ГС приведены в таблице В.1 приложения В настоящей МП); азот о.ч. в соответствии с ГОСТ 9293-74	
10.2 Определение погрешности ИК массовой концентрации аммиака на реальной среде	Рабочий эталон 1-го или 2-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденной Приказом Росстандарта от 31 декабря 2020 г. № 2315	Комплекс переносной газоаналитический КПП (рег. № в ФИФ ОЕИ 82390-21) Генератор газовых смесей NovaCAL digital 211-MF (рег. № 79376-20)
10.3 Определение погрешности ИК температуры, давления, скорости и объемного расхода газового потока	Средства измерений воспроизведения силы постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: в режиме воспроизведения не более ± 1 мкА	Калибратор электрических сигналов CA150 (рег. № в ФИФ ОЕИ 53468-13)
<p>¹⁾ Все средства поверки, кроме отмеченных в таблице сноской «¹⁾», должны быть поверены (сведения о результатах поверки средств измерений доступны в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results); газовые смеси и чистые газы в баллонах под давлением – иметь действующие паспорта.</p> <p>²⁾ Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.</p> <p>³⁾ Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС), не указанных в приложении В, и генераторов газовых смесей при выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС должны соответствовать указанному для соответствующей ГС из таблицы приложения В; - отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пределу допускаемой погрешности поверяемого средства измерений, должно быть не более 1/2. <p><i>Примечание</i> – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице</p>		

6 Требования по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

6.2 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.005-88.

6.3 При работе с системой необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России № 811 от 12.08.2022 и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда России № 903н от 15.12.2020 (ред. от 29.04.2022).

6.4 Требования техники безопасности при эксплуатации ГС в баллонах под давлением должны соответствовать приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

6.5 Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений.

6.6 К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на систему и прошедшие необходимый инструктаж.

7 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре системы, в том числе пробоотборного зонда и обогреваемой линии, должно быть установлено:

- соответствие внешнего вида системы описанию типа средства измерений;
- отсутствие внешних повреждений и загрязнений, влияющих на работоспособность системы в целом и элементов системы в частности;
- комплектность и маркировка, которые должны соответствовать указанным в документе «Системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ на участке производства минеральных удобрений АО «Апатит» в г. Череповец. Руководство по эксплуатации»;
- исправность органов управления, настройки и коррекции;
- четкость всех надписей на лицевых панелях СИ;
- четкость и контрастность цифровых дисплеев СИ (при наличии).

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Контроль условий поверки

При поверке должны быть проверены условия проведения поверки, указанные в п. 3 настоящей методики поверки. Для контроля условий поверки используются средства поверки, приведенные в таблице 2.

8.2 Проверить комплектность системы.

8.3 Подготовить систему к работе в соответствии с требованиями документа «Системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ на участке производства минеральных удобрений АО «Апатит» в г. Череповец. Руководство по эксплуатации».

8.4 Проверить наличие паспортов и сроки годности используемых при поверке ГС.

8.4.1 Выдержать баллоны с ГС в помещении, в котором проводят поверку, в течение не менее 24 ч.

8.5 Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

8.6 При проведении поверки с использованием стандартных образцов ГС (п. 10.1 МП) подсоединяют фторопластовую трубку с выхода вентиля точной регулировки или баллонного редуктора, установленного на баллоне с ГС, через тройник на вход подачи газа пробоотборного зонда.

Расход ГС должен быть выше расхода, потребляемого системой. Контроль расхода осуществляют при помощи ротаметра.

8.7 При проведении поверки на реальной среде с использованием пробы газовых выбросов выполняют следующую операцию: устанавливают рабочий эталон 1-го или 2-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах, утвержденной Приказом Росстандарта от 31 декабря 2020 г. № 2315 (например – комплекс переносной газоаналитический КПП), в условиях размещения поверяемой системы, в состав которой входит газоаналитический комплекс. Зонд КПП

вставляют в технологическое отверстие дымовой трубы рядом с зондом поверяемой системы, подключают к зонду трубопровод и проводят их нагрев до требуемой температуры (температуры зонда поверяемой системы) в соответствии с РЭ на КПП.

Примечание – Допускается подключение зонда КПП к тройнику, установленному на обогреваемом трубопроводе поверяемой системы (перед подачей анализируемого газа на вход газоаналитического комплекса).

Продувают зонд и трубопровод КПП после их нагрева не менее 10 минут анализируемым газом, после чего проводят измерение массовой концентрации аммиака (NH_3).

Также допускается использовать генератор газовых смесей (например, генератор газовых смесей NovaCAL digital 211-MF) для создания ГС, по составу и характеристикам (содержание паров воды, температура) имитирующей реальную среду. В таком случае содержание аммиака в ГС должно составлять от 10 % до 90 % от верхней границы диапазона измерений, с учетом диапазонов измерений рабочего эталона 1-го или 2-го разряда, применяемого при поверке. Объемная доля паров воды в ГС от генератора газовых смесей должна соответствовать $(15 \pm 5) \%$. Температура ГС – не менее 120 °C.

8.8 Опробование

8.8.1 Проверка общего функционирования

Проверку общего функционирования средств измерений и устройств в составе системы проводят в процессе тестирования при их запуске в соответствии с РЭ на приборы.

Результаты проверки считают положительными, если:

- отсутствует информация об отказах элементов, входящих в состав системы;
- на мониторе системы для всех поверяемых ИК индицируется текущая информация об измеряемых параметрах.

8.8.2 Проверка герметичности пробоотборного зонда с обогреваемой линией

Проверка осуществляется подачей ГС № 1 и ГС №2 (NH_3/N_2) (таблица В.1 приложения В) на вход системы, через устройство отбора и подготовки пробы, в порт калибровки зонда (перед фильтром).

Предварительно подают указанные выше ГС непосредственно на вход газоанализатора.

Подачу ГС проводят в соответствии с п. 8.6.

Результаты считаются положительными, если изменение показаний по ИК аммиака не превышает пределов допускаемой погрешности, приведенных в таблице А.1 приложения А.

9 Проверка программного обеспечения

Операция «Проверка программного обеспечения» заключается в подтверждении идентификационных данных метрологически значимой части программного обеспечения (далее – ПО) системы.

Идентификационные данные ПО (наименование и номер версии) отображаются на несколько секунд на мониторе компьютера системы при запуске системы.

Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если полученные идентификационные данные наименования и номера версии ПО соответствуют указанным в таблице А.6 приложения А.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

10.1 Определение погрешности ИК массовой концентрации аммиака с использованием ГСО

Определение погрешности проводят при поочередной подаче ГС на вход пробоотборного зонда в последовательности: №№ 1-2-3 и считывании показаний с монитора ПК системы.

Номинальные значения содержания определяемого компонента в ГС приведены в таблице В.1 приложения В.

Значения приведенной погрешности γ , %, для диапазонов, в которых в таблице А.1 приложения А нормированы пределы допускаемой приведенной погрешности, рассчитывают для каждой ГС по формуле

$$\gamma = \frac{C_i - C_d}{C_k} \cdot 100, \quad (1)$$

где C_i – измеренное значение массовой концентрации определяемого компонента, отображаемое на мониторе системы при подаче i -ой ГС, мг/м³;

C_d – действительное значение массовой концентрации определяемого компонента в ГС, мг/м³;

C_k – верхний предел участка диапазона измерений, в котором нормированы пределы допускаемой приведенной погрешности, массовая концентрация, мг/м³.

Значения относительной погрешности δ , %, для диапазона, приведенного в таблице А.1 приложения А, рассчитывают для каждой ГС по формуле

$$\delta = \frac{C_i - C_d}{C_d} \cdot 100, \quad (2)$$

где C_i – показания монитора ПК системы при подаче i -ой ГС, мг/м³;

C_d – действительное значение массовой концентрации определяемого компонента в ГС, мг/м³.

Результаты определения считают положительными, если полученные значения погрешности не превышают пределов допускаемой погрешности ИК, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.2 Определение погрешности ИК массовой концентрации аммиака на реальной среде

Определение погрешности ИК массовой концентрации аммиака на реальной среде проводится в соответствии с п. 8.7 настоящей методики.

Примечание – Допускается применение других СИ или методик выполнения измерений при соблюдении следующего условия: отношение пределов допускаемой погрешности измерений с использованием аттестованной методики (или СИ) к пределам допускаемой погрешности поверяемого средства измерений, должно быть не более 1/2.

Одновременно проводят отсчет показаний по дисплею монитора ПК системы.

Значения относительной погрешности для диапазона измерений, в котором нормированы пределы допускаемой относительной погрешности (таблица А.1 приложения А), рассчитывают по формуле (2), где C_d – результат измерений, полученный с помощью КПП, мг/м³.

Результат определения считают положительным, если полученные значения погрешности не превышают значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

10.3 Определение погрешности ИК температуры, давления, скорости и объемного расхода газового потока

Определение погрешности ИК температуры, давления, скорости и объемного расхода газового потока проводят поэлементным методом. Поэлементная поверка проводится при наличии на первичные измерительные преобразователи (ПИП), входящие в состав указанных ИК, сведений о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, действующих на момент поверки системы.

Поэлементный метод заключается в определении погрешности ИК параметров газового потока - температуры, давления, скорости и объемного расхода, имеющих в своем составе ПИП с аналоговым выходным сигналом в следующем порядке:

- определение погрешности ПИП;
- определение погрешности канала передачи информации.

а) Определение погрешности ПИП

Определение погрешности ПИП выполняется в лабораторных условиях после их демонтажа в соответствии с установленными методиками поверки.

Определяют основную погрешность ПИП на основании результатов поверки ПИП.

Результаты определения считаются положительными, если полученные значения основной погрешности ПИП не превышают значений, приведенных в описании типа на соответствующие ПИП.

б) Определение погрешности канала передачи информации.

Определение погрешности канала передачи информации проводят на месте их установки.

Входными сигналами канала передачи информации системы являются унифицированные токовые сигналы стандартных преобразователей скорости (объемного расхода), давления, температуры в диапазоне от 4 до 20 мА.

На вход канала передачи информации подают унифицированный токовый сигнал в диапазоне от 4 до 20 мА от источника постоянного тока (калибратор электрических сигналов). При поверке канала передачи информации выполняют по одному измерению в каждой выбранной точке поверки.

в) Определение погрешности канала передачи информации проводят в следующей последовательности:

Отключают ПИП и подключают средства поверки к соответствующим ИК, включая линии связи.

С помощью калибратора устанавливают на входе канала ввода аналогового сигнала электрические сигналы от 4 до 20 мА, соответствующие значениям измеряемого параметра. Задают не менее трех значений измеряемого параметра, равномерно распределенных в пределах диапазона измерений (например, 0; 50; 100 %) и после установления показаний считывают значение параметра с экрана ПК системы с ПО.

Значение измеряемой величины A_0 , соответствующее заданному значению силы постоянного тока I_3 , мА, рассчитывают по формуле

$$A_0 = K \cdot (I_3 - 4) + |A_0|, \quad (3)$$

где I_3 – показания калибратора в каждой точке проверки, мА;

A_0 – нижнее значение диапазона измерений (в единицах измеряемой величины);

K – коэффициент преобразования, рассчитываемый по формуле (4)

$$K = \frac{A_B - A_H}{I_B - I_H}, \quad (4)$$

где $A_{\text{в}}, A_{\text{н}}$ – верхнее и нижнее значение диапазона измерений, соответственно, в единицах измеряемой величины;

$I_{\text{в}}, I_{\text{н}}$ – верхнее и нижнее значение диапазона измерений аналогового выхода, соответственно, мА.

г) Расчет погрешности канала передачи информации

Значение приведенной погрешности канала передачи информации γ_n , %, рассчитывают для каждой точки поверки по формуле

$$\gamma_n = \frac{A_i - A_0}{A_{\text{в}} - A_{\text{н}}}, \quad (5)$$

где A_i – измеренное системой значение определяемого параметра (по монитору компьютера с ПО), в единицах измеряемой величины;

$A_{\text{в}}, A_{\text{н}}$ – верхнее и нижнее значение диапазона измерений, соответственно, в единицах измеряемой величины.

Значение абсолютной погрешности системы по каналу передачи информации Δ_n рассчитывают для каждой точки поверки по формуле

$$\Delta_n = A_0 - A_i \quad (6)$$

Результаты определения считают положительными, если полученные значения погрешности канала передачи информации не превышают 0,2 в долях от пределов допускаемой погрешности ИК каждого параметра.

10.4 Определение погрешности ИК показателей выбросов аммиака

Результаты определения погрешности ИК показателей выбросов считают положительными, если при выполнении пп. 10.1-10.3 настоящей методики поверки получены положительные результаты.

11 Оформление результатов поверки

11.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки. Форма протокола поверки приведена в приложении Г.

11.2 Систему, удовлетворяющую требованиям настоящей методики поверки, признают пригодной к применению, вносят результаты поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, по требованию владельца системы или лица, представившего систему на поверку, выдают свидетельство о поверке установленной формы.

11.3 При отрицательных результатах поверки вносят результаты поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, по требованию владельца системы или лица, представившего систему на поверку, выдают извещение о непригодности установленной формы, с указанием причин непригодности.

11.4 Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

11.5 При проведении поверки системы по отдельным измерительным каналам, в соответствии с порядком поверки, копии протоколов в обязательном порядке передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Приложение А
(обязательное)
Метрологические характеристики системы

Таблица А.1 – Метрологические характеристики ИК массовой концентрации аммиака (NH₃)

Определяемый компонент (измерительный канал)	Диапазон измерений ¹⁾ массовой концентрации, мг/м ³	Участок диапазона измерений массовой концентрации, мг/м ³	Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации ²⁾ , %	
			приведенной ³⁾	относительной
Аммиак (NH ₃)	от 0 до 300	от 0 до 10 включ. св. 10 до 300	±25 -	- ±25

¹⁾ Номинальная цена единицы наименьшего разряда ИК массовой концентрации аммиака (NH₃) 0,1 мг/м³.

²⁾ В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 683 от 02.06.2026 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», раздел 3, п. 3.1.3.

Участок диапазона измерений, в котором результаты измерений соответствуют обязательным метрологическим требованиям Постановления Правительства РФ № 683 от 02.06.2026 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», раздел 3, п. 3.1.3, от C_{min} до C_{max} , где C_{max} – верхняя граница диапазона измерений, мг/м³, а C_{min} , мг/м³, рассчитывается по формуле

$$C_{min} = \frac{C_{\gamma} \gamma}{\delta_{max}},$$

где C_{γ} – верхняя граница участка диапазона измерений, в котором нормирована приведенная погрешность, мг/м³;

δ_{max} – наибольшее допустимое значение погрешности измерений согласно п. 3.1.3, раздела 3 Постановления Правительства РФ № 683 от 02.06.2026, %;

γ – пределы допускаемой приведенной погрешности в условиях эксплуатации, %.

³⁾ Нормирующее значение – верхний предел участка диапазона измерений, в котором нормированы пределы допускаемой приведенной погрешности.

Таблица А.2 – Метрологические характеристики ИК скорости и объемного расхода дымовых газов

Измеряемая величина	Единицы величины	Диапазон измерений ¹⁾	Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации ²⁾
Скорость газового потока при рабочих условиях	м/с	от 0,05 до 40	±(0,03+0,03·V ³⁾) (абс.)
Объемный расход при рабочих условиях	м ³ /с	от 0,8 до 636 ⁴⁾	±3 % (прив. ⁵⁾)

¹⁾ Номинальная цена единицы наименьшего разряда ИК скорости дымовых газов 0,01 м/с, объемного расхода дымовых газов 1 м³/ч.

²⁾ В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 683 от 02.06.2026 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», раздел 3, п. 3.10.

Участок диапазона измерений, в котором результаты измерений соответствуют обязательным метрологическим требованиям Постановления Правительства РФ № 683 от 02.06.2026 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», раздел 3, п. 3.10, от V_{min} до V_{max} , где V_{max} – верхняя граница диапазона измерений, м/с, а V_{min} , м/с, рассчитывается по формуле

Измеряемая величина	Единицы величины	Диапазон измерений ¹⁾	Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации ²⁾
$V_{min} = \frac{3}{\delta_{max}-3},$ <p>где δ_{max} – наибольшее допустимое значение погрешности измерений согласно п. 3.10, раздела 3 Постановления Правительства РФ № 683 от 02.06.2026, %.</p> <p>³⁾ V – скорость дымовых газов, м/с.</p> <p>⁴⁾ При площади сечения газохода 6,1544 м².</p> <p>⁵⁾ Нормирующее значение – верхний предел диапазона измерений.</p>			

Таблица А.3 – Метрологические характеристики ИК температуры дымовых газов

Измеряемая величина	Единицы величины	Диапазон измерений ¹⁾	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала в условиях эксплуатации ²⁾
Температура	°C	от -50 до +150	±2
<p>¹⁾ Номинальная цена единицы наименьшего разряда ИК температуры дымовых газов 1 °C.</p> <p>²⁾ В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 683 от 02.06.2026 г., п. 3.9.</p>			

Таблица А.4 – Метрологические характеристики ИК абсолютного давления дымовых газов

Измеряемая величина	Единицы величины	Диапазон измерений ¹⁾	Пределы допускаемой приведенной ²⁾ погрешности измерительного канала в условиях эксплуатации ³⁾ , %
Абсолютное давление	кПа	от 0 до 160	±1,5
<p>¹⁾ Номинальная цена единицы наименьшего разряда ИК абсолютного давления дымовых газов 1 кПа.</p> <p>²⁾ Нормирующее значение – верхний предел диапазона измерений.</p> <p>³⁾ В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 683 от 02.06.2026 г., п. 3.13.</p>			

Таблица А.5 – Метрологические характеристики ИК показателей выбросов аммиака

Определяемый компонент	Диапазон измерений разового выброса, г/с	Диапазон измерений массового выброса, кг/ч	Диапазон измерений валового выброса, т/г	Пределы допускаемой относительной погрешности в условиях эксплуатации, %
NH ₃	от 0,008 до 190,8	от 0,03 до 687	от 7,2·10 ⁻⁴ до 6034	$\pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta C^2 + (\gamma_Q \cdot \frac{Q_B}{Q_i})^2}$ ¹⁾

Определяемый компонент	Диапазон измерений разового выброса, г/с	Диапазон измерений массового выброса, кг/ч	Диапазон измерений валового выброса, т/г	Пределы допускаемой относительной погрешности в условиях эксплуатации, %
¹⁾ Где δC – пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации аммиака (NH_3), %; γ_Q – пределы допускаемой приведенной погрешности измерений объемного расхода дымовых газов, %; Q_B – верхняя граница диапазона измерений объемного расхода дымовых газов, $\text{м}^3/\text{с}$; Q_i – измеренное значение объемного расхода дымовых газов, $\text{м}^3/\text{с}$.				

Таблица А.6 – Идентификационные данные программного обеспечения систем

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	PLC
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.X.XX ¹⁾
¹⁾ Первый символ номера версии ПО указывает на метрологически значимую часть ПО (неизменяемую), а «X» (арабская цифра от 0 до 9) описывает метрологически незначимые модификации ПО, которые не влияют на метрологические характеристики средства измерений (интерфейс, устранение незначительных программных ошибок и т.п.).	

Приложение Б
(обязательное)

Условия определения метрологических характеристик измерительных каналов системы

Таблица Б.1 – Условия определения МХ ИК системы

Наименование ИК	Операция	Условия проведения поверки	Температура окружающей среды, °С
Газоаналитические ИК	Поверка с использованием ГСО ¹⁾	В лабораторных условиях	от +15 до +25
	Поверка с использованием реальной среды, без демонтажа	На объекте	от +5 до +40
ИК температуры, абсолютного давления дымовых газов и скорости/объемного расхода газового потока	Поверка первичных преобразователей (датчиков) с демонтажом	В лабораторных условиях	от +15 до +25
	Проверка каналов передачи информации, без демонтажа	На объекте	от +5 до +40
¹⁾ Допускается проведение поверки на объекте при условии выполнения требований раздела 3 МП.			

Приложение В

(обязательное)

Перечень и метрологические характеристики газовых смесей, используемых при поверке

Таблица В.1 - Перечень и метрологические характеристики ГС, используемых при поверке

Определяемый компонент	Диапазон измерений массовой концентрации, мг/м ³	Номинальное значение массовой концентрации определяемого компонента в ГС, пределы допускаемого отклонения, мг/м ³			Источник получения ГС (Номер ГСО)
		ПГС №1 ¹⁾	ПГС №2	ПГС №3	
Аммиак (NH ₃)	от 0 до 300	азот	150±50	280±20	ГСО 12342-2023

¹⁾ Азот особой чистоты сорт 1 по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением.

Протокол поверки

Наименование СИ: _____

Зав. № _____

Дата выпуска _____

Регистрационный номер: _____.

Заказчик: _____

Дата предыдущей поверки: _____

Методика поверки: _____

Основные средства поверки: _____

Условия поверки:

температура окружающей среды °C

относительная влажность воздуха	%
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

атмосферное давление кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1 Результаты внешнего осмотра

2 Результаты опробования

2.1 Проверка общего функционирования

2.2 Проверка герметичности пробоотборного зонда с обогреваемой линией

3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

4 Результаты определения метрологических характеристик

4.1 Результаты определения погрешности ИК массовой концентрации аммиака с использованием ГСО

4.2 Результаты определения погрешности ИК массовой концентрации аммиака на реальной среде

4.3 Результаты определения погрешности ИК температуры, давления, скорости и объемного расхода

4.4 Результаты определения погрешности ИК показателей выбросов аммиака

Заключение: на основании результатов первичной (или периодической) поверки система признана соответствующей установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодна к применению.

Поверитель: _____

Дата поверки: _____