

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ВНИИОФИ

Руководитель ГЦИ СИ

Н.П. Муравская



2004 г.

Установки ультразвукового контроля сплошности листового проката автоматизированные «СЕВЕР-10-5000»	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 24474-03 Взамен №
--	---

Выпускаются по ТУ 4276-130-10553510-04

### Назначение и область применения

Установка ультразвукового контроля сплошности листового проката автоматизированная «СЕВЕР 10-5000» предназначена для ультразвукового контроля сплошности листового проката толщиной от 5 до 300 мм со скоростью сканирования до 1 м/с. Установка обеспечивает выявление несплошностей металла типа расслоений, скоплений неметаллических включений, зон рыхлости, других нарушений сплошности и определение их условных и эквивалентных размеров.

### Описание

Установка «СЕВЕР 10-5000» представляет собой устройство, осуществляющее ультразвуковую дефектоскопию листового проката в технологическом режиме листопрокатного и трубосварочного производства в соответствии с заданными стандартами и нормами качества.

В установке использованы методы ультразвуковой дефектоскопии, основанные на прохождении, отражении и трансформации ультразвуковых колебаний в металлах.

Установка включает в себя две условно-независимые системы:

- систему контроля основного металла (СКОМ);
- систему контроля продольных кромок проката (СКК)

Конструкция установки включает в себя механическое оборудование, обеспечивающее сканирование листа; пневматическую систему, обеспечивающую позиционирование блоков акустических преобразователей; оборудование автоматики, электронную аппаратуру, управляющий вычислительный комплекс.

Установка имеет один ... четыре многоэлементных акустических блока, состоящих из 2 ... 50 электромагнитно-акустических (ЭМАП) или пьезоэлектрических (ПЭП) преобразователей. Прозвучивание осуществляется по всей толщине проката.

Установка обеспечивает чувствительность к дефектам с эквивалентным диаметром 3 - 8 мм. На каждую проконтролированную единицу проката распечатывается протокол контроля со схемой расположения дефектов (дефектограммой).

Все системы связаны с единым управляющим вычислительным комплексом (УВК), который координирует их работу, осуществляет управление информационными потоками, организует процесс контроля, сбор, обработку, представление и хранение его результатов.

УВК организует контроль в соответствии с установленными правилами отбраковки. Кроме того, УВК осуществляет:

- оперативную диагностику;
- отображение информации о дефектных зонах, сопровождение их изображения на мнемосхеме;
- классификацию несплошностей на "допустимые" и "недопустимые";
- сигнализацию недопустимых дефектов и выдачу управляющего сигнала на включение дефектоотметчика;
- печать протоколов контроля, архивирование и хранение данных (в состав УВК входит CD RW привод);
- связь с ЭВМ высшего уровня.

#### Основные технические характеристики:

- частота заполнения зондирующих импульсов, МГц	0,5 ÷ 5,0 ± 10%
- ширина активной зоны преобразователей по уровню 6дБ, мм	12±2
- запас чувствительности системы контроля дефектов по отношению опорный сигнал / шум, не менее, дБ	20
- отклонение условной чувствительности от номинальных значений, не более, дБ	± 2
- устойчивость к изменениям температуры, амплитуда опорного сигнала в % высоты (ширины) экрана на 1 градус изменения температуры, не более, %/градус	± 0,5 (0,1)
- предел допускаемой абсолютной погрешности измере- ния координат дефектов, не более, мм	± 0,1
- углы ввода ультразвуковых сигналов, для прямых преобразователей, градусов	0 ± 3

#### Масса.

- Общая масса механического оборудования, не более, кг	11000;
- общая масса электронного оборудования, кг, не более	1000;
- общая масса оборудования автоматики, кг, не более	1000

Габаритные размеры механической части установки, мм:

- длина вдоль рольганга 38000;
- ширина 10000;
- высота 2000.

Электропитание:

- сеть 3 ф. ~ 380 В – 50 кВт;
- сеть 1 ф. ~ 220 В – 15 кВт;

Средняя наработка на отказ, ч 2000

Условия эксплуатации установки:

- температура в зоне контроля, °C -30...50
- температура в зоне вторичной аппаратуры, , °C 5...30
- относительная влажность, при +30°C , % 75

### Знак утверждения типа

Наносится на таблички (шильдики) отдельных блоков и шкафов установки и на титульном листе паспорта методом печати.

### Комплектность

В комплект поставки входит следующее оборудование.

#### Механическое оборудование

- Платформа нижняя
- Тележка (платформа верхняя)
- Измерительный блок
- Пневмосистема
- Оборудование автоматики
- Шкафы автоматики в сборе
- Датчики угловых перемещений
- Блоки питания БП-24-3
- Индуктивные выключатели ВБИ
- Оптические выключатели
- Концевые выключатели ВК
- Трансформаторы ТПК
- Оборудование измерительной электроники
- Шкаф электроники
- Блок ФП
- Блок ЦАП
- Блоки генераторов
- Блоки коммутаторов
- Блоки приемников

- Блоки предварительных усилителей
- Блок ЭМАП
- Трансформаторы
- Оборудование вычислительной техники
- Шкаф «Rittal»
- Корпус IPC-615 с модулями электропитания
- Модуль процессора PCA-6168/Celeron 366/128 МБ
- Кросс-плата PC A6114P4
- Накопитель HDD-7,5 ГГБ
- Блок ФСИ FS-2V.1.01.
- Блок АЦП ADC-2V.1.00
- Монитор ЖКД 15”
- Принтер CANON LPB 810
- Программное обеспечение ВК УЗК

#### Техническая документация:

- руководство по эксплуатации, методика поверки – раздел 3.4;
  - паспорт;
  - методика выполнения измерений;
  - альбом принципиальных электрических схем;
  - схемы электрических соединений;
  - комплект программного обеспечения;
- Комплект запасных частей.

### **Поверка**

Поверка установки «СЕВЕР 10-5000» производится по методике поверки (раздел 3.4 РЭ) согласованной ВНИИОФИ в 2004 г.

Для поверки используется:

- осциллограф универсальный С1-122 И22.044.042 ТУ;
- стандартные образцы СО-2, СО-3 по ГОСТ 14782-86;
- стандартные образцы предприятия типа СОП-NK-1, СОП-NK-2, СОП-NK-3, аттестованные в установленном порядке.

Межповерочный интервал – 1 год.

### **\*Нормативные и технические документы**

Технические условия «Установка ультразвукового контроля сплошности листового проката автоматизированная « СЕВЕР 10-5000 », ТУ 4276 - 130-10553510-04.


### **Заключение**

Тип «Установки ультразвукового контроля сплошности листового проката автоматизированные «СЕВЕР 10-5000» утверждены с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании

типа и метрологически обеспечены при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Компания «Нордикрафт», 162611, Россия,  
Вологодская область, г. Череповец, ул. Бардина, 15.

/ Технический директор  
«Компании «Нордикрафт»

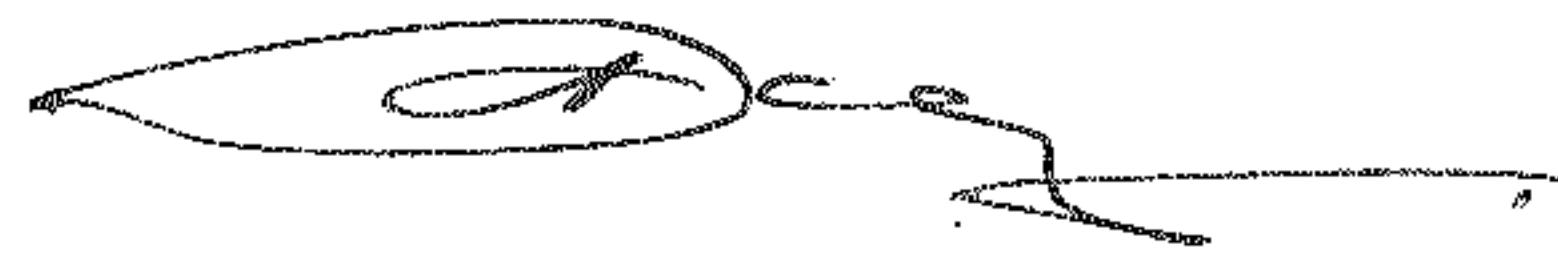

А.Е. Попов