


Подлежит публикации
в открытой печати

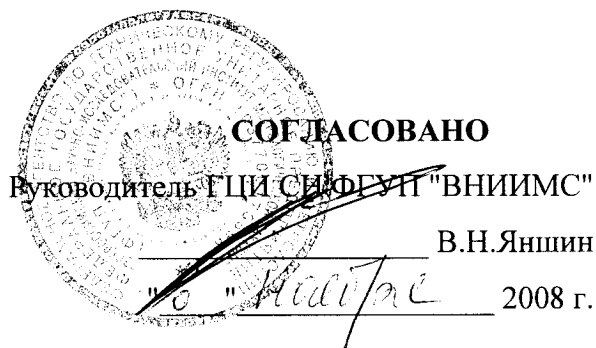

Хромато-масс-спектрометры Focus GC/Trace GC с масс-спектрометрами DSQ II, ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100, DFS, TSQ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>28566-08</u> Взамен № <u>28566-05</u>
--	---

Выпускаются по технической документации фирмы-изготовителя "Thermo Fisher Scientific", США.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хромато-масс-спектрометры Focus GC/Trace GC с масс-спектрометрами DSQ II, ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100, DFS, TSQ предназначены для измерения содержания различных веществ в пробах веществ и материалов, растворах, продуктах питания, почвах, и т.д.

Область применения хромато-масс-спектрометров - геология, металлургия, химическая промышленность, ядерная энергетика, экологический контроль, пищевая промышленность, криминалистические и научные исследования.

ОПИСАНИЕ

Хромато-масс-спектрометры представляют собой автоматизированные многоцелевые измерительные системы, состоящие из газового хроматографа, масс-спектрометра и персонального компьютера.

Пробы исследуемых объектов вводятся через инжектор в хроматографическую колонку. Разделение компонентов проб осуществляется в хроматографических колонках при программируемых режимах анализа.

В стандартной комплектации хромато-масс-спектрометры комплектуются следующими источниками ионов:

- источник ионизации электронным ударом;
- источник химической ионизации (с регистрацией положительных и отрицательных ионов).

Разделение и детектирование ионов осуществляется с помощью масс-спектрометров, приведенных в Таблице 1:

Таблица 1

Модели	Описание
DSQ II	квадрупольный масс-спектрометр
ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100	квадрупольные масс-спектрометры с ионной ловушкой
DFS	электростатический масс-спектрометр с двойной фокусировкой
TSQ	тройной квадрупольный масс-спектрометр

Детектирование может быть проведено в режимах сканирования по выбранному диапазону масс или селективного ионного детектирования для всех моделей.

Управление процессом измерения в приборах осуществляется от внутреннего контроллера и IBM PC - совместимого компьютера с помощью специального программного комплекса.

Программное обеспечение "Xcalibur" позволяет задавать и контролировать режимы анализа, обрабатывать получаемые данные.

По специальному заказу хромато-масс-спектрометры дополнительно комплектуются библиотеками спектров широкого класса веществ, что позволяет проводить идентификацию исследуемых образцов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон массовых чисел, а.е.м.:	
- модель DSQ II	1...1050
- модели ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100	1...1100
- модель DFS	1...3500
- модель TSQ	1...3500
Скорости сканирования, а.е.м./с:	
- модель DSQ II	10000
- модель ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100	5555
- модель DFS	50
- модель TSQ	5000
Разрешение, а.е.м., не менее:	
- модель DFS	1
Разрешающая способность, М/ДМ, (на уровне 10 % от максимальной интенсивности пика), не менее:	
- модель DFS	60000
Чувствительность в режиме сканирования шкалы масс и ионизации электронным ударом:	
- для модели DSQ II при инъекции в колонку 1 пг октафторнафталина (ОФН) высоковакуумным насосом (250 дм ³ /с), отношение сигнал/шум 272 а.е.м., не менее:	450:1
- для моделей ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100 при инъекции в колонку 1 пг октафторнафталина (ОФН), отношение сигнал/шум 272 а.е.м., не менее:	100:1
- для модели DFS при инъекции в колонку 200 пг гексахлорбензола (ГХБ), отношение сигнал/шум 284 а.е.м.,	25:1

не менее:	
- для модели TSQ II при инъекции в колонку 1 мг октафторнафталина (ОФН) высоковакуумным насосом (250 дм ³ /с), отношение сигнал/шум 272 а.е.м., не менее:	450:1
Стабильность шкалы масс (отклонение от начального значения после 12 ч непрерывной работы), а.е.м., не более:	
- модель DSQ II	0,1
- модели ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100	0,1
- модель DFS	0,1
- модель TSQ	0,1
Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала, %, не более	
- по времени удерживания	2,0
- по площади пиков	5,0
Средний срок службы, лет	8
Напряжение питания переменного тока, В	220
Потребляемая мощность, ВА	
- модель DSQ II	1800
- модели ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100	1800
- модель DFS	12000
- модель TSQ	4500
Габаритные размеры, мм, не более	
- модель DSQ II	440x330x680
- модели ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100	440x330x680
- модель DFS	1700x1900x1820
- модель TSQ	690x560x790
Масса, кг, не более:	
- модель DSQ II	45
- модели ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100	45
- модель DFS	875
- модель TSQ	118
Условия эксплуатации:	
-диапазон температур окружающего воздуха, °С	15...35
-диапазон относительной влажности окружающего воздуха, % при температуре 25 °С:	20...80
-диапазон атмосферного давления, кПа	84...106,7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель прибора методом штемпелевания и титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хромато-масс-спектрометры (Focus GC/Trace GC с масс-спектрометрами DSQ II, ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100, DFS, TSQ – по заказу).

Комплект ЗИП	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз.

ПОВЕРКА

Поверка хромато-масс-спектрометров Focus GC/Trace GC с масс-спектрометрами DSQ II, ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100, DFS, TSQ проводят в соответствии с документом "Инструкция. Хромато-масс-спектрометры Focus GC/Trace GC с масс-спектрометрами DSQ II, ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100, DFS, TSQ. Методика поверки", разработанным и утвержденным ВНИИМС в 2008 г. и входящим в комплект поставки.

При поверке применяют ГСО состава гексахлорбензола № 5213-90.

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип хромато-масс-спектрометров Focus GC/Trace GC с масс-спектрометрами DSQ II, ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100, DFS, TSQ проводят в соответствии с документом "Инструкция. Хромато-масс-спектрометры Focus GC/Trace GC с масс-спектрометрами DSQ II, ITQ 700, ITQ 900, ITQ 1100, DFS, TSQ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: - фирма "Thermo Fisher Scientific", США.
2215 Grand Avenue Parkway Austin, TX 78728. USA.
Fax:: (512)-251-1547
E-mail: techpubsaustin@thermo.com

Начальник отдела ФГУП "ВНИИМС"



Ш.Р.Фаткудинова

Научный сотрудник ФГУП "ВНИИМС"



П.В.Тихонов

Генеральный директор
ЗАО "МС-АНАЛИТИКА"



М.И.Токарев