

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
ГЦИСИ "НИИМ
им. Д.И. Менделеева"



В.С.Александров

2008 г.

Анализаторы жидкости SERES 1000	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>37964-08</u> Взамен _____
------------------------------------	--

Выпускаются по технической документации фирмы "SERES Environnement", Франция.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализаторы жидкости SERES 1000 (далее – анализаторы) предназначены для измерения массовой концентрации анионов: хлорид-ионов (Cl^{-1}), фторид-ионов (F^{-1}), фосфат-ионов (PO_4^{3-}) и ионов железа (Fe^{3+}) в воде.

Область применения – контроль питьевой и природной воды.

ОПИСАНИЕ

Анализаторы представляют собой стационарные промышленные приборы, состоящие из измерительного блока, насосов для подачи пробы и реагентов и электронно-вычислительного блока.

Принцип действия анализаторов для определения хлорид- и фторид-ионов – потенциометрический с использованием ионоселективных электродов. Метод основан на измерении разности потенциала между ионоселективным электродом и электродом сравнения. Массовая концентрация рассчитывается по уравнению Нернста с использованием измеренного потенциала и углового коэффициента, предварительно определенному по стандартным растворам, с помощью встроенного микропроцессора.

Принцип действия анализаторов для определения ионов железа (III) и фосфат-ионов состоит в отборе определенного количества пробы, смешении пробы с реагентом для получения цветной реакции и последующего измерения оптической плотности полученного окрашенного раствора. Массовая концентрация ионов вычисляется по градуировочной зависимости с помощью встроенного микропроцессора.

Прибор имеет возможность анализа от 1 до 6 потоков, автоматическую подачу пробы в измерительную камеру, возможность внутреннего и внешнего разбавления пробы, автоматическую калибровку, фильтрование пробы.

Анализируемая проба при наличии видимых частиц должна быть отфильтрована, должны отсутствовать пузырьки воздуха и мутность, вода должна быть чистой и прозрачной.

Анализатор оснащен буквенно-цифровым дисплеем, на который выводится информация от каждого анализируемого потока, и клавиатурой, с помощью которой осуществляется управление работой прибора.

На каждый определяемый ион или параметр поставляется свой измерительный блок с измерительной камерой с постоянным объемом пробы для анализа.

Анализатор имеет следующие выходные сигналы: 4 – 20 мА (на каждый поток), сухие контакты для индикации нарушений в работе, нарушения подачи воды и автоматической корректировки нулевых показаний и чувствительности.

Анализатор размещен в настенном шкафу с эпоксидным покрытием, который разделен на две части – для электроники и гидравлической части.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Основные метрологические характеристики анализатора приведены в табл.1 и 2.

Таблица 1.

Определяемый ион (ПДК или ОДУ)	Диапазоны показаний, мг/дм ³	Диапазоны измерений, мг/дм ³	Пределы допускаемой основной погрешности, %	
			приведенная	относительная
Хлорид (Cl ⁻¹) (350 мг/дм ³)**	0 - 500	10 - 20 20 - 500	± 15 -	- ± 15
Фторид (F ⁻¹) (1,2 – 1,5 мг/дм ³)**	0 – 2,0	0,10 – 0,30 0,30 – 2,0	± 15 -	- ± 15
Фосфат (PO ³⁻⁴) (3,5 мг/дм ³)*	0 – 0,3 0 – 1,0 0 - 50	0,10 – 0,30 0,30 – 1,0 0 – 5 5 - 50	± 20 - ± 15 -	- ± 20 - ± 15
Железо (Fe ³⁺) (0,3 мг/дм ³)**	0 – 1,0 0 – 3,0	0,10 – 0,30 0,30 – 3,0	± 20 -	- ± 20

Примечание: 1. ПДК или ОДУ – предельно-допустимая концентрация или ориентировочный допустимый уровень.

2. * в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 или ГН 2.1.5.1316-03.

3. ** в соответствии с ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств» .

Таблица 2.

Наименование характеристики или параметра	Норминованные значения
Предел допускаемого среднего квадратического отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности	6 % отн.
Предел допускаемого изменения показаний за 8 ч непрерывной работы , в долях от основной погрешности	0,2
Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °C в долях от пределов допускаемой основной погрешности	0,3
Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры воды на входе анализатора в долях от основной погрешности (наличие термостатированной ячейки)	0,2
Дополнительная погрешность от влияния неизмеряемых компонентов, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	0,4
Диапазон времени измерительного цикла, мин, хлориды, фториды фосфаты	6 – 7 4 - 20
Габаритные размеры, мм, не более	
Длина	600
Ширина	500
Высота	350
Масса, кг, (вместе со шкафом), не более	20
Потребляемая мощность, В×А, не более	100 250
Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц В	220 ^(+10 ...-15) %
Средний срок службы, лет, не менее	10
Условия эксплуатации:	
-диапазон температур окружающего воздуха, °C	5...40
-диапазон относительной влажности окружающего воздуха, % при температуре 25 °C	30...80
-диапазон атмосферного давления, кПа	84...106,7
Параметры анализируемой воды*: Диапазон температур, °C Отсутствие видимых частиц, пузырьков воздуха, мутности.	5 – 40

Примечание: Анализируемая жидкость, не соответствующая указанным параметрам, должна пройти предварительную подготовку.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульном листе руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на корпус анализатора в виде наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Анализатор;

Руководство по эксплуатации;

Методика поверки. МП 242-0671-2008.

Примечание: По требованию Заказчика поставляется блок для внешнего разбавления пробы.

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом МП 242-0671-2008 "Анализаторы жидкости SERES 1000 фирмы "SERES Environnement", Франция. Методика поверки", утвержденным ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" в апреле 2008 г.

Основные средства поверки:

- Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) ГСО 7450-98, хлорид ионов ГСО 7456-98.

- стандартный образец состава водного раствора ионов фтора и фосфат-ионов – эталонный материал (ЭМ) ВНИИМ, регистрационный № 07.02.006, № 07.02.007 по МИ 2590-2006.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП Общие технические условия».
2. ГОСТ 22729-84 «Анализаторы жидкостей. ГСП. Общие технические условия».
3. ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств».
4. Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип анализаторов жидкости SERES 1000 фирмы "SERES Environnement", Франция, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен при ввозе в РФ, после ремонта и в эксплуатации.

Анализатор жидкости SERES 1000 имеет сертификат соответствия № РОСС FR.ME48.B02440 от 28.04.2008, выданный органом по сертификации приборостроительной продукции ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ – фирма "SERES Environnement", Франция.

Адрес: 360, rue Louis de Broglie, LA DURANNE – BP 20087, 13793 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3, FRANCE. Тел. 04.42.97.37.37. Факс: 04.42.97.30.30

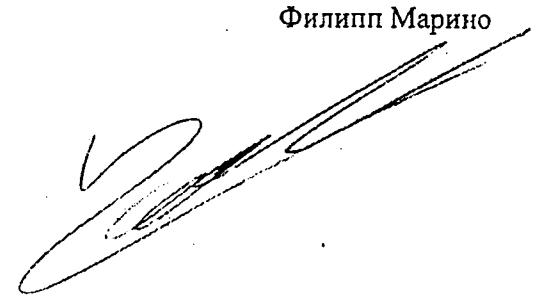
Ремонт и сервисные услуги оказывает эксклюзивный представитель фирмы «SERES Environment» в России- ООО"ЭКОКОНТРОЛЬ С".

Адрес -107241, г. Москва, ул. Байкальская, дом 11/1, тел. (495) 469-48-77, 466-97-91,
email:ABG@ecocontrol.ru, www. ecocontrol.ru

Руководитель НИО Государственных эталонов
в области физико-химических измерений
ГЦИ СИ "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Представитель фирмы
"SERES Environment"

Л.А.Конопелько

Филипп Марино