


Подлежит публикации
в открытой печати

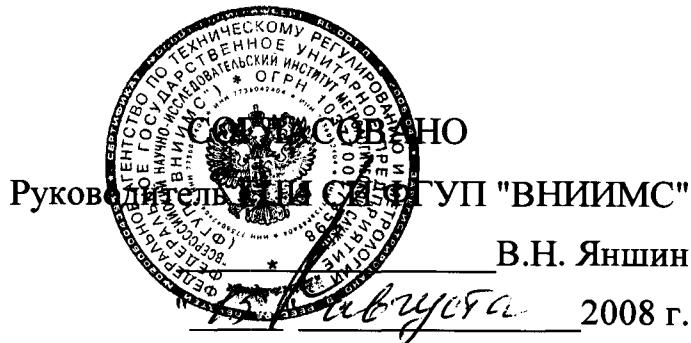

Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>38671-08</u> Взамен № _____
--	--

Выпускаются по техническим условиям ЯРКГ 2.840.027 ТУ.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА (далее – газоанализаторы) предназначены для измерения массовой концентрации оксида углерода (CO), диоксида азота (NO₂), сероводорода (H₂S), диоксида серы (SO₂), объемной доли метана (CH₄), других горючих газов и кислорода (O₂) и сигнализации о выходе измеренных значений концентрации за установленные пределы (пороги).

Область применения – контроль воздуха рабочей зоны.

ОПИСАНИЕ

Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА представляют собой автоматические, индивидуальные приборы непрерывного действия.

Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА имеют два исполнения – однодетекторное (ДЕГА-CO, ДЕГА-NO₂, ДЕГА-H₂S, ДЕГА-SO₂, ДЕГА-O₂, ДЕГА-CH₄) и двухдетекторное (ДЕГА-CH₄/O₂, ДЕГА-CH₄/CO, ДЕГА-CH₄/H₂S, ДЕГА-CO/H₂S, ДЕГА-CO/NO₂, ДЕГА-CO/SO₂, ДЕГА-CO/O₂, ДЕГА-H₂S/SO₂, ДЕГА-H₂S/O₂, ДЕГА-SO₂/NO₂, ДЕГА-SO₂/O₂, ДЕГА-NO₂/O₂).

В газоанализаторах индивидуальных ДЕГА используются электрохимический (токсичные газы и кислород) и термокаталитический (горючие компоненты) методы детектирования.

Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА осуществляют:

- измерение массовой концентрации или объемной доли компонента;
- индикацию текущих значений массовой концентрации (мг/м³) или объемной доли (%) в цифровом виде в единицах мг/м³ или % об.;
- световую и звуковую сигнализацию при превышении порогов для токсичных или горючих компонентов, или при выходе измеряемой концентрацией за пороги для кислорода;
- хранение в памяти результатов измерений;
- определение максимального значения концентрации в течение цикла измерения (для ДЕГА-O₂; ДЕГА-CH₄/O₂; ДЕГА-CO/O₂; ДЕГА-H₂S/O₂; ДЕГА-SO₂/O₂; ДЕГА-NO₂/O₂).

запоминание максимального и минимального значений O_2) и отображение его на дисплее;

– диагностику состояния газоанализатора и его отдельных узлов.

Газоанализаторы должны эксплуатироваться при следующих условиях:

– диапазон температур от минус 30°C до 45°C (от минус 25°C до минус 30°C измеряемая концентрация не отображается на индикаторе, а сохраняется в памяти газоанализатора и считывается через компьютер, звуковая и световая сигнализация не изменяются);

– атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

– относительная влажность от 15% до 95% (без конденсации влаги);

– содержание пыли в анализируемом воздухе – не более 40 мг/м³.

Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0, имеют маркировку взрывозащиты 1ExibdIIBT4/H₂ X -30°C ≤ t_a ≤ +45°C и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ Р 51330.13, действующих "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ глава 7.3), "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП глава 3.4), других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, и руководства по эксплуатации ЯРКГ 2.840.027.РЭ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов индивидуальных ДЕГА приведены в таблице 1.

Таблица 1

Детектор (измеряемый компонент)	Модель газоанализатора*	Диапазон показаний мг/м ³ (%)	Диапазон измерений мг/м ³ (%)	Основная приведенная погрешность, %	Основная от- носительная погрешность, %
Метан (CH ₄) (другие горючие газы)	ДЕГА-CH ₄ ДЕГА-CH ₄ /O ₂ ДЕГА-CH ₄ /CO ДЕГА-CH ₄ /H ₂ S	(0 – 5) %	(0 – 2,2)%	±10	–
Оксид углерода (CO)	ДЕГА-CO ДЕГА-CH ₄ /CO ДЕГА-CO/H ₂ S ДЕГА-CO/NO ₂ ДЕГА-CO/SO ₂ ДЕГА-CO/O ₂	0 – 400	0 – 200	±20 (0 – 20) мг/м ³	±20 (20 – 200) мг/м ³
Сероводород (H ₂ S)	ДЕГА-H ₂ S ДЕГА-CO/H ₂ S ДЕГА- H ₂ S/SO ₂ ДЕГА- CH ₄ /H ₂ S ДЕГА- H ₂ S/O ₂	0 – 100	0 – 30	±20 (0 – 3,0) мг/м ³	±20 (3,0 – 30) мг/м ³
Диоксид серы (SO ₂)	ДЕГА- SO ₂ ДЕГА- H ₂ S/SO ₂ ДЕГА- SO ₂ /NO ₂ ДЕГА-CO/SO ₂ ДЕГА- SO ₂ /O ₂	0 – 50	0 – 25	±20 (0 – 10) мг/м ³	±20 (10 – 25) мг/м ³
Диоксид азота	ДЕГА-NO ₂	0 – 20	0 – 10	±20	±20

Детектор (измеряемый компонент)	Модель газоанализатора*	Диапазон показаний мг/м ³ (%)	Диапазон измерений мг/м ³ (%)	Основная приведенная погрешность, %	Основная от- носительная погрешность, %
(NO ₂)	ДЕГА- SO ₂ /NO ₂ ДЕГА- CO/NO ₂ ДЕГА- NO ₂ /O ₂			(0 – 2) мг/м ³	(2 – 10) мг/м ³
Кислород (O ₂)	ДЕГА-O ₂ ДЕГА-CH ₄ /O ₂ ДЕГА- CO/O ₂ ДЕГА- H ₂ S/O ₂ ДЕГА- SO ₂ /O ₂ ДЕГА- NO ₂ /O ₂	(0 – 30) %	(0 – 25)%	±2,5	–

* возможны также другие сочетания перечисленных детекторов

2. Номинальные значения единицы наименьшего разряда на индикаторе газоанализаторов составляют:

для CO – 1 мг/м³;

для H₂S, NO₂ и SO₂ – 0,1 мг/м³;

для CH₄ – 0,01%;

для O₂ – 0,1%.

3. Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов при изменении температуры окружающей среды на каждые 10°C от значения 20°C в рабочем диапазоне температур не должны превышать 0,5 доли основной погрешности.

4. Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа не должны превышать 0,3 доли основной погрешности.

5. Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении относительной влажности анализируемой среды на каждые 10 % относительно 60 % в диапазоне влажности 30 – 95 % должны составлять не более 0,2 доли основной погрешности, Пределы дополнительной погрешности при воздействии влажности от 30 до 15 % в течение не более 20 минут – не должны превышать 0,5 доли основной погрешности.

6. Предельное содержание неизмеряемых газовых компонентов в анализируемой газовой среде должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Измеряе- мый ком- понент	Максимально допустимое содержание неопределляемых компонентов						
	NH ₃ мг/м ³	Cl ₂ мг/м ³	H ₂ S мг/м ³	CO мг/м ³	NO ₂ мг/м ³	NO мг/м ³	O ₂ %
CO	20	1	10	–	2	5	20,9
H ₂ S	20	1	–	20	2	5	20,9
SO ₂	20	1	10	20	1	5	20,9
NO ₂	20	0,2	0,5	20	–	5	20,9
CH ₄	20	1	10	20	2	5	20,9
O ₂	20	1	10	20	2	5	–

7. Габаритные размеры газоанализаторов, мм, не более – 120 × 55 × 40 мм.

8. Масса газоанализаторов, кг, не более – 0,3 кг.

9. Питание газоанализаторов должно осуществляться от автономного источника - блока аккумуляторов, напряжение 4,2 В, емкостью 4,8 А/ч.

10. Электрические параметры искробезопасной цепи газоанализатора:

– максимальное напряжение элемента питания, U, В	4,2
– максимальный выходной ток, I _ш , мА	400
– максимальная потребляемая мощность P _i , Вт	1,7
– максимальная внутренняя индуктивность, L _i , мГн	4,7
– максимальная внутренняя емкость, C _i , мкФ	150

11. Время прогрева и выхода на рабочий режим не должно превышать 3 мин.

12. Время непрерывной работы не менее 10 часов.

13. Время необходимое для установления показаний на уровне 90% от измеряемой величины должно быть не более 120 секунд.

14. Газоанализаторы ДЕГА-СО, ДЕГА-NO₂, ДЕГА-H₂S, ДЕГА-SO₂, ДЕГА-CH₄, ДЕГА-CH₄/O₂, ДЕГА-CH₄/CO, ДЕГА-CH₄/H₂S, ДЕГА-CO/H₂S, ДЕГА-CO/NO₂, ДЕГА-CO/SO₂, ДЕГА-CO/O₂, ДЕГА-H₂S/SO₂, ДЕГА-H₂S/O₂, ДЕГА-SO₂/NO₂, ДЕГА-SO₂/O₂, ДЕГА-NO₂/O₂ для всех детекторов, кроме O₂, имеют звуковую и световую сигнализацию, срабатывающую при превышении двух порогов (Порог 1 и Порог 2).

15. Газоанализаторы ДЕГА-O₂, ДЕГА-CH₄/O₂, ДЕГА-CO/O₂, ДЕГА-H₂S/O₂, ДЕГА-SO₂/O₂, ДЕГА-NO₂/O₂ для детектора O₂ имеют световую и звуковую сигнализацию, срабатывающую при выходе концентрации O₂ за установленные пороги (Порог 1 – нижний, Порог 2 – верхний). В двухдетекторных моделях газоанализаторов световая и звуковая сигнализация является общей для обоих детекторов, наименование компонента (химическая формула компонента), для которого произошел выход за значение Порога, мигает на индикаторе с указанием Порога (Порог 1 или Порог 2).

16. Пределы допускаемой относительной погрешности срабатывания сигнализации не более ±15% от установленного значения.

17. Возможные значения Порога 1 и Порога 2 для измеряемых компонентов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Значения порогов сигнализации

Детектор (измеряемый газовый компонент)	ПОРОГ 1, мг/м ³	ПОРОГ 2, мг/м ³
CO	20	100
H ₂ S	10 (3 по заказу)	30
SO ₂	10	20
NO ₂	2	10
CH ₄	(0,44) 0,5%	(0,88) 1%
O ₂	19%	23%

18. Газоанализаторы должны выдерживать перегрузку, вызванную содержанием определяемого компонента (кроме O₂), равным удвоенному значению верхнего предела диапазона измерений, в течение 5 мин. Время восстановления нормальной работы газоанализатора после снятия перегрузки не должно превышать 60 мин.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак наносится на лицевую панель газоанализаторов и на титульные листы Руководства по эксплуатации газоанализаторов ДЕГА ЯРКГ 2.840.028 РЭ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки газоанализаторов индивидуальных ДЕГА приведена в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение	Наименование	Кол-во
ЯРКГ 2.840.027	Газоанализатор	1 шт.
	Зарядное устройство	1 шт.
	Сетевой адаптер	1 шт.
ЯРКГ 6.471.009	Градуировочная насадка	1 шт.
ЯРКГ 2.840.027 ПС	Паспорт	1 экз.
ЯРКГ 2.840.027 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.
ЯРКГ 2.840.027 МП	Методика поверки	1 экз.
	Комплект для связи с компьютером	Поциальному заказу
	Устройство принудительной подачи пробы ПРУС-2(Д)	Поциальному заказу
	Трубка удаленного пробоотбора (до 10 м) с груз-фильтром	Поциальному заказу
	Кейс-укладка	Поциальному заказу

ПОВЕРКА

Проверка осуществляется в соответствии с документом "Газоанализаторы индивидуальные ДЕГА. Методика поверки", являющимся Приложением А к Руководству по эксплуатации ЯРКГ 2.840.027 РЭ, утвержденным ВНИИМС в 2008 г.

Основные средства поверки – ГСО ПГС по ТУ 6-16-2956-01, генераторы газовых смесей ГГС-03-03, ТДГ-01, ГХ 120, источники микропотоков по ИБЯЛ.418319.013ТУ.

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 13320-81 "Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия".

ГОСТ 12997-84 "Изделия ГСП. Общие технические условия" (раздел 3 п.2.16, п.2.8.).

ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) "Совместимость технических средств электромагнитная Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний".

ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

Технические условия ЯРКГ 2.840.027 ТУ (ТУ 4215-014-11269194-07).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип газоанализаторов индивидуальных ДЕГА утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Выдан сертификат соответствия РОСС RU.ГБ05.В02302.

**Изготовитель – ООО БЮРО АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
"ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ"
107005, Москва, Плетешковский пер., 22.
Тел/факс (495) 152-41-91**

Генеральный директор
ООО БЮРО АНАЛИТИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ "ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ"

В.Л. Будович

