



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.33.112.A № 48968

Срок действия до 04 декабря 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Источники первичные эталонные/серверы времени Метроном
версий 200, 300, 600, 900, 1000, 2000, 3000**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "НТЦ Метротек", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51953-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

M002-12-СИ МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **04 декабря 2012 г. № 1094**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007636

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники первичные эталонные/серверы времени Метроном версий 200, 300, 600, 900, 1000, 2000, 3000

Назначение средства измерений

Источники первичные эталонные/серверы времени Метроном версий 200, 300, 600, 900, 1000, 2000, 3000 (далее - источники) предназначены для формирования частотно-временных сигналов синхронизации, в том числе сетевых протоколов времени, корректируемых по универсальной шкале времени (UTC), путем приема сигналов от глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.

Описание средства измерений

Принцип действия источников основан на периодическом сравнении частоты сигнала от внешнего источника с частотой внутреннего опорного генератора (далее ОГ) и подстройке частоты ОГ, обеспечивающего формирование выходных частотно-временных сигналов синхронизации. В качестве внешних источников используются сигналы ГЛОНАСС/GPS, 1PPS, 10МГц, IRIG, 2,048МГц, 2,048Мбит/с, сетевые протоколы NTP/PTP.


В случае отсутствия внешних источников (авария антенно-фидерного тракта, отсутствие видимых спутников глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS или внешних источников синхронизации/времени) для хранения текущего времени и формирования сигналов синхронизации используется внутренний ОГ.

Источники соответствуют рангу рабочего средства измерений времени и частоты согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.129-99.

Конструктивно источники выполнены в закрытом корпусе с элементами крепления для установки на DIN-рельс, в стандартные стойки или шкафы шириной 19 дюймов. В корпус источников устанавливаются сигнальные интерфейсы, тип и количество которых оговаривается при заказе, и определяются версией: 200, 300, 600, 900, 1000, 2000, 3000 (предусматривается совмещение версий в одном корпусе в соответствии с заказом). Источники выпускаются с питанием в соответствии с заказом от источника постоянного тока напряжением 48/60 В с заземленным плюсом или от источника переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

По условиям эксплуатации источники удовлетворяют требованиям, предъявляемым к средствам измерений по группе 3 ГОСТ 22261-94.

Общий вид источников разных версий и схема защиты от несанкционированного доступа, выполненной с помощью однократно используемой этикетки с фирменным знаком, изображены на рисунках 1 и 2 соответственно.



Метроном версии 200



Метроном версии 300



Метроном версии 600



Метроном версии 900



Метроном версии 1000




Метроном версии 2000

Рисунок 1 Общий вид источников отдельных версий



Рисунок 1 Общий вид источников отдельных версий (продолжение)

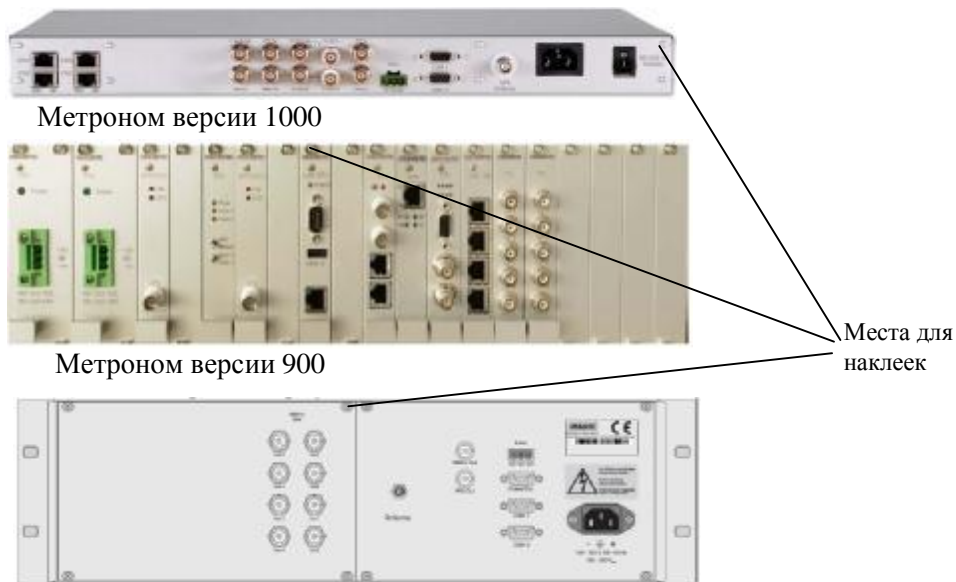

Метроном версии 1000

Метроном версии 900

Метроном версии 3000

Места для
наклеек

Рисунок 2 Вид сзади источников отдельных версий с указанием мест установки этикеток для пломбирования

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) встроенное, версия 5.34e, с управляющими функциями.

Идентификационные данные ПО следующие:

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Метроном	MGX/GLN 1HE	5.34e	2be560cfe401ec78 de31x4r2tq	MD5

Источники по уровню защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных изменений относятся к группе "С". Запись ПО осуществляется в процессе производства. Доступ к внутренним частям источников, включая процессор, защищен конструкцией источника и этикеткой. Модификация ПО возможна только в сервисных центрах изготовителя.

Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности выходного сигнала по частоте в режиме удержания (за 24 часа)	$\pm 2 \cdot 10^{-10}$
Параметры низкочастотного шума при синхронизации от внешнего источника и времени наблюдения τ в секундах: МОВИ ¹ , нс, не более в интервале наблюдения, с: $0,1 < \tau \leq 1000$ в интервале наблюдения, с: $\tau > 1000$	0,275 τ +25 0,01 τ +290

¹ Максимальная ошибка временного интервала (в международных документах - TIE)

Наименование характеристики	Значение
ДВИ ² , нс, не более в интервале наблюдения, с: $0,1 < \tau \leq 100$ в интервале наблюдения, с: $100 < \tau \leq 1000$ в интервале наблюдения, с: $1000 < \tau \leq 10000$	3 0,03 τ 30
Амплитуда импульсов на симметричных/несимметричных выходах, В - для "2,048 МГц" с сигналом в виде прямоугольных импульсов - для "2,048 Мбит/с" с сигналом в коде HDB3	1,0-1,9/0,75-1,5 3,0/2,37 \pm 20 %
Амплитуда импульсов на несимметричных выходах, В - для синусоидального сигнала 10 МГц - для сигнала 1PPS (1 импульс в секунду) и 10 МГц в логике TTL ³	>1 >2
Нагрузочное сопротивление, Ом - для симметричных/несимметричных выходов "2,048 МГц" и "2,048 Мбит/с" - для синусоидального сигнала 10 МГц - для сигнала 1PPS и 10 МГц в логике TTL	120/75 75 50
<i>Общие характеристики</i>	
Рабочие условия применения: диапазон температур воздуха, °С, влажность воздуха при температуре 25°С, %, не более	+5 - +40 85
Электропитание: - от сети переменного тока частотой, Гц напряжением, В - источника постоянного тока напряжением, В	47,5 - 52,5 198 - 242 36 - 72
Размеры (ширина×высота×глубина), мм, не более, для версий: - 200 - 300/600/1000 - 2000 - 900/3000 Масса, кг, не более, для версий: - 200 - 300/600/1000 - 2000 - 900/3000	335×45×240 443×45×288 443×90×288 443×135×288 3 4 4,5 5

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на заднюю сторону источника в виде наклеиваемой этикетки и на руководство по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Источники поставляются в следующей комплектации, версия и тип интерфейса оговаривается при заказе:

- источник первичный эталонный/сервер времени Метроном выбранной версии 1 шт.
- антенный кабель 1 шт.
- антенна ГЛОНАСС/GPS 1 шт.
- набор для крепления антенны 1 шт.
- кабель питания (для вариантов с питанием от сети переменного тока) 1 шт.
- руководство по эксплуатации М002-12-РЭ-СИ 1 шт.
- методика поверки М002-12-СИ МП 1 шт.

² Девиация временного интервала (в международных документах - TDEV)

³ Транзисторно-транзисторная логика

Поверка

осуществляется в соответствии с документом «Источники первичные эталонные/серверы времени Метроном версии 200, 300, 600, 900, 1000, 2000, 3000. Методика поверки М002-12-СИ МП», утвержденным ГЦИ СИ «СвязьТест» ФГУП ЦНИИС в 2012 г.

Основные средства поверки:

- измеритель временных отклонений ИВО-1М: погрешность по частоте встроенного генератора опорной частоты $\pm 5 \cdot 10^{-11}$; вариация частоты $\pm 3 \cdot 10^{-12}$; погрешность измерения ошибки временного интервала ОВИ [± 5 % от измеряемого значения $+Z(\tau)$] нс, где $Z(\tau)$ - систематическая погрешность, τ - интервал наблюдения в с; вычисление МОВИ и ДВИ;

- осциллограф двухканальный широкополосный С1-108, 0-350 МГц; 20 мВ-8 В, время нарастания переходной характеристики менее 1 нс; погрешность по оси X ≤ 1 % и Y $\leq 1,5$ %.

Сведения о методиках (методах) измерений

"Источники первичные эталонные/серверы времени. Руководство по эксплуатации".

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к источникам

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 26886-86. Стыки цифровых каналов и групповых трактов первичной сети ЕАСС. Основные параметры.

ГОСТ 8.129-99. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты.

Технические условия М002-12-СИ ТУ.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

выполнение работ по оценке соответствия средств связи установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям и мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере связи.

Изготовитель

ООО «НТЦ Метротек», г. Москва

Адрес: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д.21, корп. 3

Тел./факс (495) 961-00-71

Заявитель

ООО «Прайм Тайм Инжиниринг»

Адрес: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д.21, корп.3

Тел./факс (495) 925-05-82

Испытательный центр

ГЦИ СИ "СвязьТест" ФГУП ЦНИИС, аттестат аккредитации № 30112-07, до 01.01.2013 г.

Адрес: 111141, Москва, 1-й проезд Перова поля, д. 8

Тел. (495)368-97-70; факс (495)674-00-67

E-mail: metrolog@zniis.ru

Заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

" ___ " _____ 2012 г.