
**ГИРИ ОБРАЗЦОВЫЕ 2-го РАЗРЯДА НАБОРА
ГО-2-1110**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 5287—76**


**Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров
СССР 25 февраля 1976 г. Выпуск разрешен**

до 01.01.1981 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гири образцовые 2-го разряда набора ГО-2-1110 (см. рисунок) применяются для проверки образцовых гирь 3-го разряда и гирь класса 3 по ГОСТ 7328—73.

Гири соответствуют требованиям ГОСТ 12656—67.

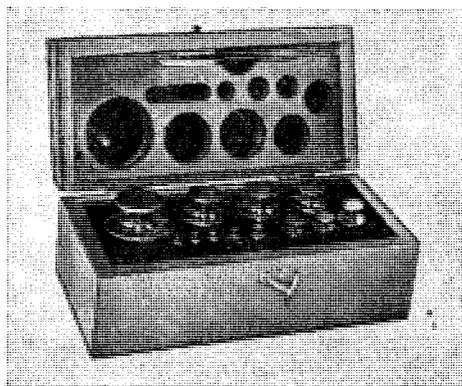

ОПИСАНИЕ

Гири граммовые от 1 до 500 г, цельные, изготовлены из нержавеющей стали.

Форма цилиндрическая с головкой.

Гири уложены в деревянный футляр, к которому приложены вилка и пинцет для захвата гирь.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допускаемые отклонения от номинального значения массы гирь: 500 г $\pm 1,60$ мг; 200 г $\pm 0,80$ мг; 100 г $\pm 0,48$ мг; 50 г $\pm 0,48$ мг; 20 г $\pm 0,32$ мг; 10 г $\pm 0,32$ мг; 5 г $\pm 0,16$ мг; 2 г $\pm 0,08$ мг; 1 г $\pm 0,08$ мг.

Габаритные размеры 215×110×80 мм.

Масса футляра с гирями не более 2 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект набора ГО-2-1110 входят:

- 1) гири в футляре: 500, 100, 50, 10, 5, 1 г — по 1 шт.; 200, 20, 2 г — по 2 шт.;
- 2) пинцет;
- 3) вилка;
- 4) паспорт.

ПОВЕРКА

Гири 2-го разряда поверяют по ГОСТ 13703—68.

Испытания проводил и рассматривал их результаты Все-союзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.