
**ГИРИ ОБРАЗЦОВЫЕ 1-го РАЗРЯДА НАБОРА
ГО-1-1110-1**


**Внесены
в Государственный
реестр
под № 5402—76**

**Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров:
СССР 12 мая 1976 г. Выпуск разрешен**

до 01.01.1981 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гири образцовые 1-го разряда набора ГО-1-1110-1 (см. рисунок) предназначены для поверки образцовых гирь 2-го разряда и гирь класса 2, а также для поверки лабораторных весов.

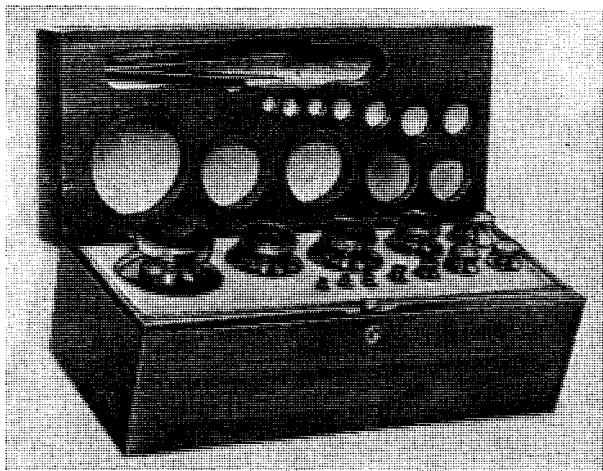

ОПИСАНИЕ

Гири изготовлены из нержавеющей стали аустенитного класса (немагнитной) по ГОСТ 5632—72.

Стр. 2 № 5402—76

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд гирь 1.

Диапазон масс гирь от 1 до 500 г.

Погрешность определения массы не более от $+0,008$ до $\pm 0,16$ мг.

Габаритные размеры футляра с гирями $210 \times 110 \times 85$ мм.

Масса футляра с гирями 2 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с гирями в футляре поставляют:

- 1) лопатку;
- 2) пинцет;
- 3) паспорт.

ПОВЕРКА

Гири поверяют по ГОСТ 14269—69.

Испытания проводил и рассматривал их результаты Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.