

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры показывающие PGI-63B-PG30

Назначение средства измерений

Манометры показывающие PGI-63B-PG30 (далее по тексту – манометры) предназначены для измерений избыточного давления в составе установки разделения воздуха PL4HN г. Тольятти.

Описание средства измерений

Принцип действия манометра основан на уравнивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины из нержавеющей стали с одним глухим концом (трубка Бурдона). Под воздействием измеряемого давления свободный конец измерительной пружины перемещается и через передаточный механизм приводит стрелку манометра во вращательное движение относительно шкалы.

Корпус манометра изготовлен из нержавеющей стали.

Фото общего вида манометра представлено на рисунке 1.

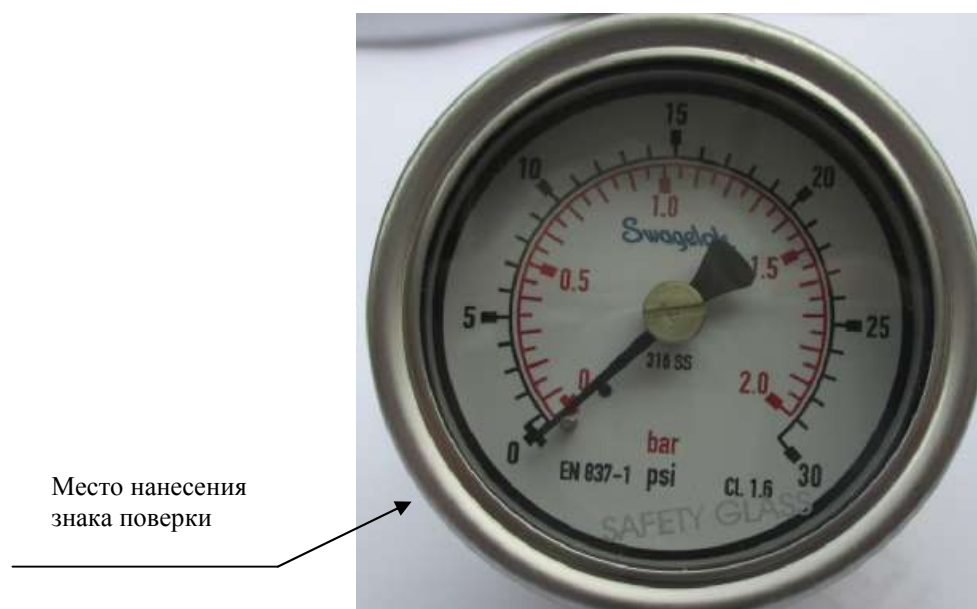


Рисунок 1 - Манометр показывающий PGI-63B-PG30

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений давления, бар (кПа)	от 0 до 2 (от 0 до 200)
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре 20 ± 5 °C), %	$\pm 1,6$
Вариация, %	1,6
Пределы дополнительной погрешности от влияния изменения температуры окружающего воздуха, %/ 10° C	$\pm 0,4$
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды, °C	от минус 40 до плюс 60
Габаритные размеры (диаметр × глубина), мм, не более	63×33

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом и на корпус прибора методом наклейки.

Комплектность средства измерений

Манометр показывающий PGI-63B-PG30	2 шт.
Паспорт	2 экз.

Поверка

осуществляется по документу МИ 2124-90 «Рекомендация. ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- манометр избыточного давления грузопоршневой МП-2,5 2-го разряда по ГОСТ Р 8.802-2012 (Госреестр № 17973-98).

Знак поверки наносится на боковую часть корпуса манометра.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в соответствующем разделе паспорта на манометр показывающий PGI-63B- PG30.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам показывающим PGI-63B-PG30

1. ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.

2. ГОСТ Р 8.802-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа.

3. Техническая документация «Swagelok Company», США.

Изготовитель

«Swagelok Company», США
29500 Solon Road
Solon Ohio 44139 USA
Internet: www.swagelok.com

Заявитель

ООО «Праксайр Азот Тольятти», г. Тольятти
ИНН 7709930344
Адрес: 445007, РФ, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
Тел: (495) 287-13-07
Факс: (495) 967-97-00

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495) 437-55-77/437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2016 г.