

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСА 1.0-40.0 Б 060

#### Назначение средства измерений

Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСА 1.0-40.0 Б 060 (далее - комплекс) предназначен для измерений радиотехнических характеристик антенн.

#### Описание средства измерений

Принцип действия комплекса основан на амплифазометрическом методе измерений характеристик антенн в частотной области методом ближней зоны с планарным сканированием. Оценка нормируемых радиотехнических характеристик испытываемых антенн осуществляется по результатам математической обработки измеренного на поверхности сканирования амплитудно-фазового распределения тангенциальных компонент электромагнитного поля, излучаемого (принимаемого) антенной.

Конструктивно комплекс состоит из:

- прецизионного четырехкоординатного сканера (далее - сканера), предназначенного для пространственного перемещения антены-зонда в системе координат (X; Y; Z; P) вблизи апертуры испытываемой антенны, где P - плоскость поляризации;
- трехкоординатного опорно-поворотного устройства (далее - ОПУ), предназначенного для установки испытываемых антенн в плоскость сканирования;
- векторного анализатора цепей для измерений отношений амплитуд и разности фаз опорного и зондирующего сигналов (комплексного коэффициента передачи системы «испытываемая антenna - антenna-зонд»). Зондирующий сигнал - это сигнал, подаваемый с выхода анализатора цепей на вход испытываемой антенны, излучаемый ею, далее принимаемый антенной-зондом и поступающий на вход анализатора цепей. Результат измерений комплексного коэффициента передачи системы «испытываемая антenna - антenna-зонд» передается на ПЭВМ управления и обработки, где после его обработки получают значения нормируемых характеристик испытываемой антенны;
- генератора сигналов, функционирующего совместно с векторным анализатором цепей и предназначенного для обеспечения требуемого динамического диапазона измерений комплекса;
- комплекта антенн-зондов, предназначенных для использования в процессе измерений распределения поля в ближней зоне испытываемых антенн;
- комплекта эталонных антенн, предназначенных для измерений коэффициента усиления методом замещения;
- комплекта СВЧ кабельных сборок и межканальных соединителей, предназначенных для коммутации функциональных узлов комплекса;
- контроллера движения сканера для управления его работой;
- контроллера движения ОПУ для управления его работой;
- комплекта радиопоглощающих материалов, обеспечивающих уменьшение уровня отраженных сигналов;
- ПЭВМ, используемой для управления комплексом и обработки результатов измерений;
- источников бесперебойного питания для обеспечения корректного завершения работы комплекса при нештатном отключении электропитания.

Внешний вид элементов комплекса приведен на рисунках 1- 11.

Место размещения знака утверждения типа приведено на рисунке 11.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисунке 12.

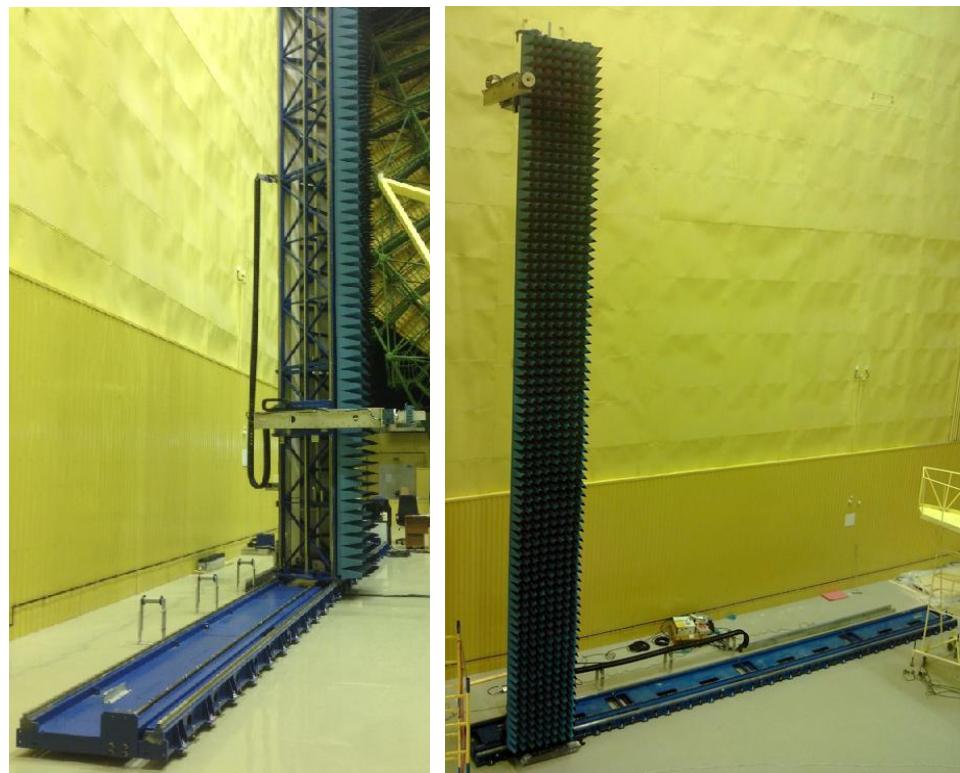


Рисунок 1 - Внешний вид сканера

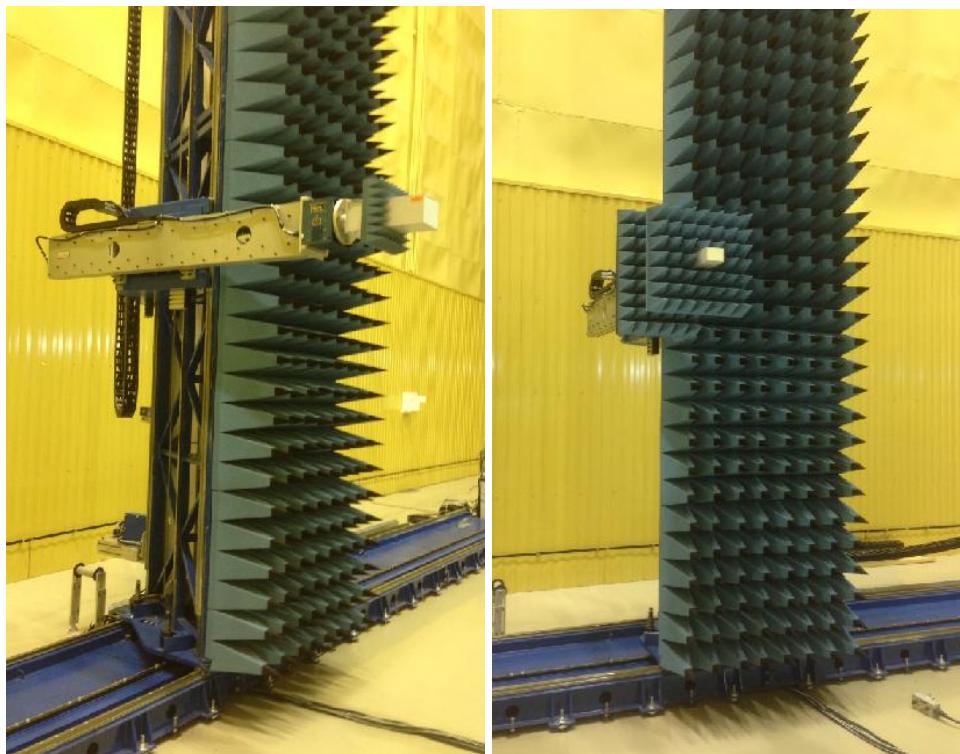


Рисунок 2 - Внешний вид сканера с установленной antennой-зондом

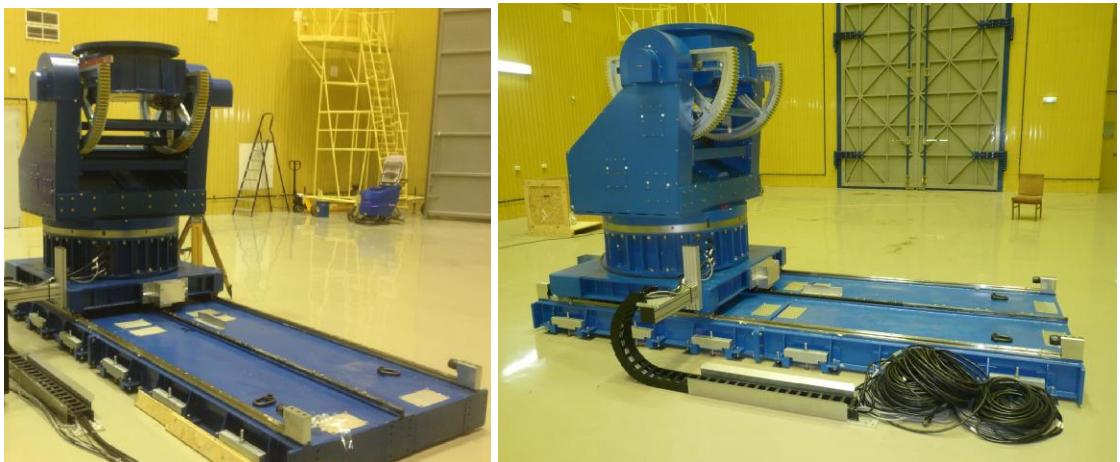


Рисунок 3 - Внешний вид ОПУ



а) векторный анализатор цепей

б) генератор сигналов

Рисунок 4 - Внешний вид векторного анализатора цепей и генератора сигналов

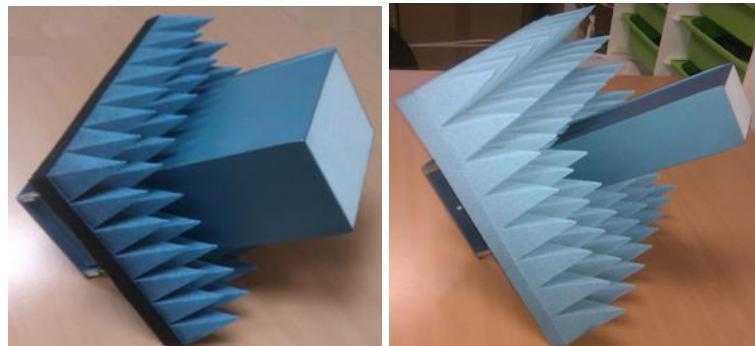


Рисунок 5 - Внешний вид антенн-зондов диапазона частот от 1 до 4 ГГц

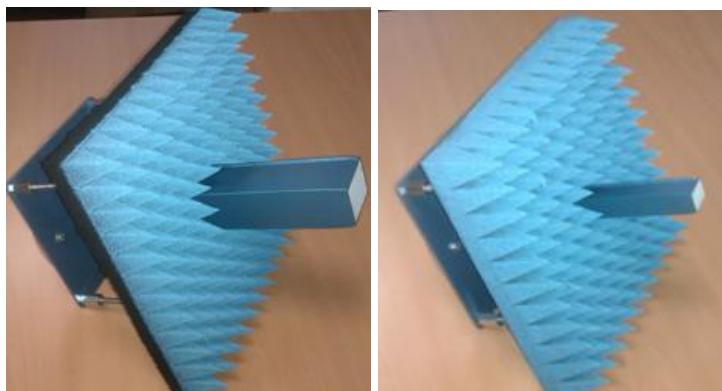


Рисунок 6 - Внешний вид антенн-зондов диапазона частот от 4 до 18 ГГц



Рисунок 7 - Внешний вид антенны-зонда диапазона частот от 18 до 40 ГГц



Рисунок 9 - Внешний вид эталонной антенны диапазона частот до 3 ГГц



Рисунок 9 - Внешний вид эталонных антенн диапазона частот выше 3 ГГц



а) векторный анализатор цепей в стойке      б) контроллеры

Рисунок 10 - Внешний вид векторного анализатора цепей, контроллеров управления движением сканера и ОПУ, установленных в приборные стойки



Рисунок 11 - Внешний вид рабочего места оператора с ПЭВМ

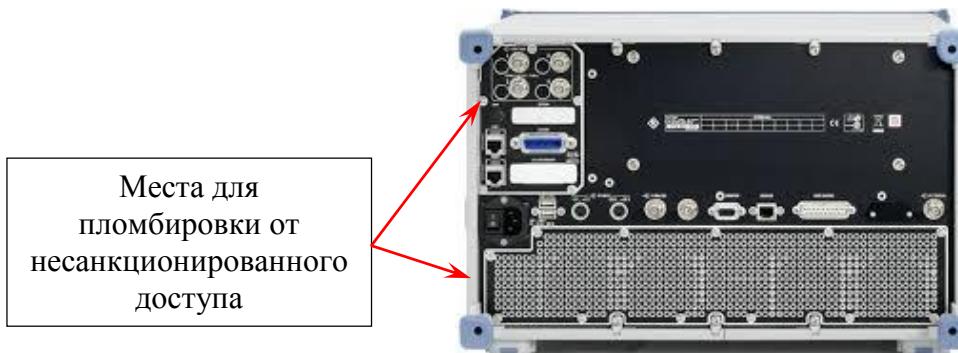


Рисунок 12 - Задняя панель векторного анализатора цепей

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) комплекса осуществляет:

- управление элементами комплекса и процессом измерений;
- обработку результатов измерений и получение значений радиотехнических характеристик испытываемой антенны;
- представление радиотехнических характеристик испытываемой антенны в виде соответствующих графиков и диаграмм;
- хранение результатов измерений и значений радиотехнических характеристик испытываемой антенны.

Программное обеспечение комплекса работает под управлением операционной системы Windows7.

Метрологически значимая часть ПО комплекса представляет собой специализированное программное обеспечение «FrequencyMeas», «NFCalc», «AmrView».

Специализированное ПО «FrequencyMeas» предназначено для настройки комплекса и проведения измерений амплитудно-фазового распределения электромагнитного поля в ближней зоне антенны, для управления векторным анализатором цепей и контроллером перемещения сканера, а также для сохранения всех данных измерения в файлах.

Специализированное ПО «NFCalc» предназначено для расчета нормируемых характеристик направленности и энергетических характеристик антенн на основе результатов измерений в ближней зоне.

Специализированное ПО «AmrView» предназначено для визуализации результатов расчетов, выполненных с помощью специализированного программного обеспечения «NFCalc».

Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
Идентификационное наименование ПО	FrequencyMeas.exe	NFCalc.exe	AmrView.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	5.1.0.0	3.20.1	3.16.60612
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	9DEC2037710B6AB 99B82F25F1200E053 (алгоритм MD5)	90F2307A43D11220 7504337B9CCA9F24 (алгоритм MD5)	FAF113F3C83206EB 863D69624F5D3FC0 (алгоритм MD5)

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

**Метрологические и технические характеристики**  
приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Метрологические и технические характеристики комплекса

Наименование характеристики	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 1 до 40
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений амплитудного распределения электромагнитного поля до относительного уровня (при соотношении сигнал/шум на входе приемного канала векторного анализатора цепей не менее 10 дБ и кроссполяризационной связке антенны-зонда не менее 20 дБ), дБ: -10 дБ -20 дБ -30 дБ -40 дБ -50 дБ	±0,3 ±0,5 ±0,7 ±1,0 ±1,3
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазового распределения электромагнитного поля при относительном уровне амплитудного распределения (при соотношении сигнал/шум на входе приемного канала векторного анализатора цепей не менее 10 дБ), градус: -10 дБ -20 дБ -30 дБ -40 дБ -50 дБ	±8 ±10 ±11 ±12 ±13

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений относительных уровней амплитудных диаграмм направленности до уровней (при соотношении сигнал/шум на входе приемного канала векторного анализатора цепей не менее 10 дБ, кроссполяризационной развязке антены-зонда не менее 20 дБ, динамическом диапазоне измеренного амплитудного распределения антенны не менее 50 дБ), дБ: -10 дБ -20 дБ -30 дБ -40 дБ -50 дБ	±0,3 ±0,5 ±0,9 ±1,3 ±1,9
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазовых диаграмм направленности (при соотношении сигнал/шум на входе приемного канала векторного анализатора цепей не менее 10 дБ, кроссполяризационной развязке антены-зонда не менее 20 дБ, динамическом диапазоне измеренного амплитудного распределения антенны не менее 50 дБ) при относительных уровнях амплитудных диаграмм, градус: -10 дБ -20 дБ -30 дБ -40 дБ -50 дБ	±8 ±10 ±12 ±14 ±19
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений коэффициента усиления антенны методом замещения при коэффициенте стоячей волны по напряжению испытываемой антенны не более 2 и погрешности измерений коэффициента усиления эталонной антенны, дБ: 0,5 дБ 0,8 дБ 1,5 дБ 2,0 дБ	±0,8 ±1,1 ±1,8 ±2,3
Размер рабочей области сканирования (длина × высота), м, не менее	10 × 10
Сектор углов восстанавливаемых диаграмм направленности, не менее, ...°	±65
Габаритные размеры сканера (длина × ширина × высота), мм, не более	12960 × 3200 × 12480
Напряжение электропитания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В	220±22
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха при температуре +20 °C, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +15 до +25 80 от 84,0° до 106,7

### Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель контроллера движения сканера в виде наклейки и типографским способом на титульный лист документа «Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСА 1.0-40.0 Б 060. Руководство по эксплуатации. ТМСА 060. 040. 00Б РЭ».

### Комплектность средства измерений

Комплект поставки комплекса приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Комплект поставки комплекса

Наименование	Обозначение	Заводской номер	Кол-во
1 Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный в составе:	TMCA 1.0-40.0 Б 060	060	1 шт.
1.1 Прецизионный четырехкоординатный сканер с контроллером движения и пультом дистанционного управления	AL-4953-1-10m-10m-V	031	1 шт.
1.2 Трехкоординатное опорно-поворотное устройство с контроллером движения, включающее: - азимутальный и угломестный позиционер - линейный слайдер - СВЧ вращающееся сочленение - пульт дистанционного управления	AL-4207-1 AL-4950-1-2M -	0014 029 -	1 шт.
1.2 Векторный анализатор электрических цепей	R&S ZVA40	100363	1 шт.
1.3 Генератор сигналов	R&S SMB100A	176150	1 шт.
1.4 Комплект антенн-зондов: - антenna-зонд диапазона частот от 1 до 2 ГГц - антenna-зонд диапазона частот от 2 до 4 ГГц - антenna-зонд диапазона частот от 4 до 8 ГГц - антenna-зонд диапазона частот от 8 до 18 ГГц - антenna-зонд диапазона частот от 18 до 40 ГГц	TMAZ 1-2 И TMAZ 2-4 И TMAZ 4-8 И TMAZ 8-18 И TMAZ 18-40 И	1113190 1113191 1113194 0813184 1213205	1 шт.
1.5 Комплект эталонных антенн: - антenna диапазона частот от 1 до 3 ГГц - антenna диапазона частот от 3 до 8 ГГц - антenna диапазона частот от 8 до 40 ГГц	TMA 1-3 Э TMA 3-8 Э TMA 8-40 Э	1213204 1213203 1213201	1 шт.
1.6 Комплект СВЧ кабельных сборок и межканальных соединителей	-	-	1 шт.
1.7 Комплект радиопоглощающих материалов	ECCOSORB VHP-18-NRL	-	1 шт.
1.8 Источник бесперебойного питания	-	-	2 шт.
1.9 ПЭВМ	-	-	1 шт.
1.10 Комплект приборных стоек для размещения элементов комплекса	-	-	1 шт.
2 Компакт-диск с ПО	-	-	1 шт.
3 Паспорт	TMCA 060. 040. 00Б ПС	-	1 шт.
4 Руководство по эксплуатации	TMCA 060. 040. 00Б РЭ	-	1 шт.
5 Методика поверки	165-16-12 МП	-	1 шт.

### Проверка

осуществляется по документу 165-16-12 МП «Инструкция. Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный TMCA 1.0-40.0 Б 060. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» 30.11.2016 г.

**Основные средства поверки:**

- аттенюатор ступенчатый программируемый 84908М (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 60239-15);
- система лазерная координатно-измерительная API OMNITRAC, диапазон измерений расстояний от 0 до 40 м, пределы допускаемой погрешности измерений расстояний 25 мкм (для расстояния L<10 м), 2,5L мкм (для L>10 м) (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 35813-07);
  - набор мер коэффициентов передачи и отражения 85056А (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 53566-13);
  - антенный измерительный комплект АИК 1-40Б (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 55403-13).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого комплекса с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска поверительного клейма.

**Сведения о методиках (методах) измерений**  
приведены в эксплуатационном документе.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к комплексу автоматизированному измерительно-вычислительному ТМСА 1.0-40.0 Б 060**

ГОСТ Р 8.851-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 178 ГГц

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ТРИМ СП Измерительные системы» (ООО «НПП «ТРИМ СП Измерительные системы»)  
ИНН 7804323773

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.40, корп.14, литер А, офис 10Н

Телефон: (812) 327-44-56; Факс: (812) 540-03-15

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Юридический адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11

Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский р-н, п/о Менделеево

Телефон (факс): (495) 526-63-00; E-mail: [office@vniiftri.ru](mailto:office@vniiftri.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИФТРИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 07.10.2013 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.