


СОГЛАСОВАНО

И.о. главного инженера  
Унитарного предприятия «Завод СВТ»  
В.В. Василевский  
03 \_\_\_\_\_ 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ  
В.Л. Гуревич  
9 \_\_\_\_\_ 2017 г.



**ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ЦИФРОВОЙ В7-40/1**

Методика поверки

Tr2.710.016 МП

МРБ МП. 2687-2017

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

РАЗРАБОТАНО

Зам. главного конструктора

Унитарного предприятия «Завод СВТ»

С.А. Качаев С.А. Качаев

« 15 » марта 2017 г.

Первичная применимость

Справочный №

## Содержание

1	Операции и средства поверки.....	3
2	Условия поверки и подготовка к ней.....	8
3	Проведение поверки.....	9
4	Оформление результатов поверки.....	44
	Приложение А Форма протокола поверки вольтметра.....	45

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Шалманова	<i>Шалманова</i>	15.03.17
Пров.		Годулевич	<i>Годулевич</i>	15.03.17
Н.контр.		Янковская	<i>Янковская</i>	15.03.17
Утв.		Качаев	<i>Качаев</i>	15.03.17

Тг2.710.016 МП

Вольтметр универсальный  
цифровой В7-40/1  
Методика поверки

Лит	Лист	Листов
О1	2	61

Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок вольтметра универсального цифрового В7-40/1.

Вольтметр подлежит поверке в органах государственной метрологической службы и аккредитованных поверочных лабораториях.

Межповерочный интервал – 12 мес.

## 1 Операции и средства поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.


Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Наименование и тип эталонов, основные технические характеристики	Проведение операции при:	
			первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	3.1		Да	Да
2 Опробование	3.2	Вольтметр В1-12: - 0,01 mV – 1000 V; - погрешность не более 0,017 %. Вольтметр В1-9 (или В1-27): - 2 mV – 100 V; - погрешность 0,2%; - диапазон частот 20 Hz – 100 kHz; - ток нагрузки 2 μA – 2 mA; - погрешность 0,33 %; - диапазон частот 40 Hz – 20 kHz; Магазин сопротивлений Р4831: - 0,01 – 10 <sup>5</sup> Ω; - погрешность 0,02 %.	Да	Да
3 Определение электрической прочности изоляции	3.3	Универсальная пробойная установка УПУ-1М (или УПУ-10): - 200 V – 2 kV; - погрешность 10 %; - $f = 50$ Hz.	Да	Нет

Инв. № подл.	196466
Подпись и дата	15.09.17
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Лист  
3


Продолжение таблицы 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Наименование и тип эталонов, основные технические характеристики	Проведение операции при:	
			первичной поверке	периодической поверке
4 Определение электрической прочности изоляции высоковольтного делителя напряжения ДНВ	3.4	Аппарат для испытания кабелей, твердых и жидких диэлектриков АИИ-70: - $U = 45 \text{ kV}$ ; - погрешность 10 %; - $f = 50 \text{ Hz}$ .	Да	Да
5 Определение метрологических характеристик				
5.1 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока	3.5.1	Вольтметр В1-12.	Да	Да
5.2 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока с высоковольтным делителем напряжения ДНВ, с ДНВ и шунтом "К2", "К3"	3.5.2, 3.5.3	Установка УПК-100: - $U_{\text{вх.}} = 5-30 \text{ kV}$ ; - погрешность 0,17%; - коэффициент деления $10^4, 10^5$ . Аппарат для испытания кабелей, твердых и жидких диэлектриков АИИ-70.	Да	Да
5.3 Определение основной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока	3.5.4	Вольтметр В1-9. Блок усиления напряжения Я1В-22 (или В1-27): - 100 – 200 V в диапазоне частот 20 Hz – 100 kHz; - 200 – 1000 V в диапазоне частот 20 Hz – 1 kHz; - погрешность 0,2 %. Генератор импульсов точной амплитуды Г5-75 (или Г5-78): - от 20 Hz до 1 MHz; - амплитуда до 7 V; - длительность от 0,5 $\mu\text{s}$ до 5 ms; - погрешность $\leq 0,006 \%$ .	Да	Да

Инь. Наподт	196466
Подпись и дата	15.09.14г
Взам инв. №	
Инь. № дубл.	
Подпись и дата,	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Тг2.710.016 МП



Лист  
4


Продолжение таблицы 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Наименование и тип эталонов, основные технические характеристики	Проведение операции при:	
			первичной поверке	периодической поверке
		Частотомер электронно-счетный ЧЗ-63: - до 50 Hz; - амплитуда 1,5 V; - погрешность $\leq 0,015 \%$ .		
5.4 Определение основной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока вольтметра с делителем переменного напряжения	3.5.5	Вольтметр В1-9. Блок усиления напряжения Я1В-22 (или В1-27).	Да	Да
5.5 Определение основной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы вольтметра с высокочастотным пробником	3.5.6	Вольтметр В1-9 (или В1-27).	Да	Да
5.6 Определение основной погрешности измерения силы постоянного тока	3.5.7	Вольтметр В1-12. Катюшка сопротивления образцовая Р321: - $R = 0,1; 10 \Omega$ ; - погрешность 0,01 %. Источник постоянного тока Б5-47: - $I_{нагр.} = 2 \text{ A}$ .	Да	Да

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Инв. №подл  
 996466  
 Подпись и дата  
 15.09.14  
 Взаим. №  
 Ив. № дубл.  
 Подпись и дата

Tr2.710.016 МП



Лист  
5


Продолжение таблицы 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Наименование и тип эталонов, основные технические характеристики	Проведение операции при:	
			первичной поверке	периодической поверке
		Вольтметр универсальный цифровой В7-46 (или В7-28): - измерение напряжения постоянного тока 0,1 – 5 V; - погрешность 0,02 %. Резисторы ПЭВ-25-10Ω ± 10%, ОМЛТ-2- 510Ω ± 10%, СП5-2-1W- 3,3 kΩ ± 10%. Конденсатор К73-16-100V-1μF±10 % (2 шт.)		
5.7 Определение основной погрешности измерения силы постоянного тока вольтметра с шунтом «10 А»	3.5.8	Катушка сопротивления образцовая Р310: - R = 0,01 Ω; - погрешность 0,02 %. Вольтметр универсальный цифровой В7-46 (или В7-28). Источник постоянного тока Б5-21 (СПН-40): - I вых = 10 А; - погрешность 1 %. Резистор С5-16Т-10W- 0,68Ω ± 5% (3 шт.) Конденсатор К73-16-100V-1μF±10 % (2 шт.)	Да	Да
5.8 Определение основной погрешности измерения силы переменного тока	3.5.9	Вольтметр В1-9. Блок усиления напряжения Я1В-22 (или В1-27). Резисторы С2-29В-0,125-100 kΩ ± ±0,1%-1,0-А; С2-29В-0,5-10 kΩ ± 0,1%-1,0-А; С2-29В-2- 4,7 kΩ ± 0,1%-А	Да	Да

Инд. №подл.	196466
Подпись и дата	С.А. 15.09.17г.
Взам инв. №	
Инд. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Тг2.710.016 МП



Лист  
6

Продолжение таблицы 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Наименование и тип эталонов, основные технические характеристики	Проведение операции при:	
			первичной поверке	периодической поверке
5.9 Определение основной погрешности измерения электрического сопротивления	3.5.10	Магазин сопротивлений Р4831: - $0,01 - 10^5 \Omega$ ; - погрешность 0,02 %. Катушка сопротивления образцовая Р331: - $R = 10^5 \Omega$ ; - погрешность 0,01 %. Магазин сопротивлений Р4002: - $2 - 19 \text{ М}\Omega$ ; - погрешность 0,05 %. Магазин сопротивлений Р4013: - $10^6 \Omega$ ; - погрешность 0,005 %.	Да	Да

Примечания


- 1 Вместо указанных средств поверки разрешается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие измерения параметров с требуемой точностью.
- 2 Средства поверки должны быть поверены в органах, аккредитованных в данный вид деятельности.

1.2 При обнаружении несоответствия техническим характеристикам дальнейшая поверка прекращается, а вольтметры подлежат забракованию и направлению в ремонт.

Инд. №подл.	196466
Подпись и дата	15.09.97
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Тг2.710.016 МП

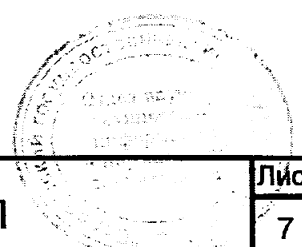

Лист  
7

## 2 Условия поверки и подготовка к ней

2.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия по ГОСТ 8.395-80:

- температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха от 30% до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- напряжение питающей сети переменного тока  $(230 \pm 4,6) \text{ В}$ ;
- частота питающей сети  $(50 \pm 0,2) \text{ Гц}$ ; с содержанием гармоник до 5%.

2.2 Вольтметры должны поверяться в помещении, свободном от пыли, паров кислот и щелочей, при отсутствии вибрации и тряски.

2.3 Перед поверкой вольтметры и принадлежности к ним необходимо выдержать при температуре от  $15 ^\circ\text{C}$  до  $30 ^\circ\text{C}$  не менее 4 ч и дополнительно при температуре  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$  - не менее 2 ч.

2.4 Перед проведением операций поверки необходимо ознакомиться с разделом 8 технического описания (Тр2.710.016 ТО) и выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделах 9 и 10 технического описания.

2.5 Средства измерения выдержать в нормальных условиях в течение времени, оговоренного в их эксплуатационных документах.

Инв. Номер 196466	Подпись и дата <i>[Подпись]</i> 15.09.17	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата					
					Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата



### 3 Проведение поверки

#### 3.1 Внешний осмотр

3.1.1 При проведении внешнего осмотра необходимо установить соответствие вольтметра следующим требованиям:

все надписи на вольтметре должны быть четкими и ясными;

входные гнезда должны быть чистыми;

переключатель рода работы и режима измерения должен быть исправным;

клемма защитного заземления, переключатель сети 50 Hz , 400 Hz, вилка для подключения сетевого шнура, разъем выхода в КОП на задней панели вольтметра должны быть исправными и чистыми;

все покрытия должны быть прочными, ровными, без царапин и трещин и обеспечивать защиту вольтметра от коррозии.

3.1.2 При проведении внешнего осмотра высоковольтного делителя напряжения должно быть установлено соответствие его следующим требованиям:

все составные части делителя должны быть прочно закреплены без перекосов;

все винты, гайки и детали, имеющие резьбу, должны быть прочно застопорены;

поверхность изолирующей части (корпуса) делителя должна быть чистой, сухой, без царапин и трещин;

выходной кабель и заземляющие выводы высоковольтного делителя должны быть исправными;

все надписи должны быть четкими и ясными.

3.1.3 При проведении внешнего осмотра высокочастотного пробника, делителя переменного напряжения и шунта «10 А» должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

входные гнезда и штыри делителя и шунта должны быть чистыми;

все надписи должны быть четкими и ясными;

все детали должны быть прочно закреплены, винты застопорены;

все покрытия должны быть прочными, без царапин и трещин, на корпусе не должно быть следов коррозии.

Поверку вольтметров, имеющих дефекты, не проводить.


По результатам осмотра делают отметку в протоколе (приложение А).

Инв. №подл 196466	Подпись и дата 15.09.14г	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата					
					Изм	Лист	Надокум.	Подп.	Дата
					Тг2.710.016 МП				

### 3.2 Опробование

3.2.1 Контроль работоспособности вольтметра в режиме измерения напряжения постоянного тока проводят в следующей последовательности:

1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 1;

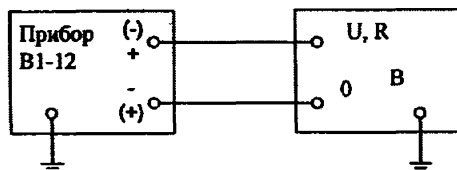

В - поверяемый вольтметр

Рисунок 1 - Схема электрическая структурная подключения приборов для опробования вольтметра в режиме измерения напряжения постоянного тока

- 2) устанавливают на поверяемом вольтметре при помощи ручной установки предел измерения напряжения постоянного тока 2 В;
- 3) устанавливают выходное напряжение прибора В1-12, равным 1 В;
- 4) убеждаются, что вольтметр измеряет напряжение постоянного тока 1 В и на индикаторном табло индицируется знак « + »;
- 5) устанавливают выходное напряжение прибора В1-12 минус 1 В;
- 6) убеждаются, что вольтметр измеряет напряжение постоянного тока 1 В, а на индикаторном табло индицируется знак «-»;
- 7) регулируя декадным переключателем выходное напряжение прибора В1-12, последовательно устанавливают такие значения напряжения, не превышающие 1,9999 В, чтобы убедиться, что в каждом из четырех младших разрядов может быть высвечен каждый из символов от 0 до 9, а в старшем разряде - символ 1;


3.2.2 Контроль работоспособности вольтметра в режиме измерения напряжения переменного тока проводят в следующей последовательности:

- 1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 2;
- 2) устанавливают на поверяемом вольтметре при помощи ручной установки предел измерения напряжения переменного тока 20 В;
- 3) подают от прибора В1-9 напряжение 10 В частотой 20 кГц, убеждаются, что вольтметр измеряет это напряжение.


Инд. № подл.	196466	Подпись и дата	
Взам инв. №		Инд. № дубл.	
Подпись и дата	15.09.19с	Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Tr2.710.016 МП



Лист  
10

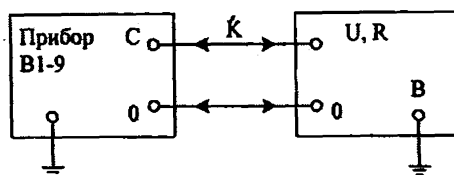


К - кабель из комплекта прибора В1-9;  
 В - поверяемый вольтметр

Рисунок 2 - Схема электрическая структурная подключения приборов для опробования вольтметра в режиме измерения напряжения силы переменного тока

3.2.3 Контроль работоспособности вольтметра в режиме измерения силы постоянного тока проводят в следующей последовательности:

1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 3;

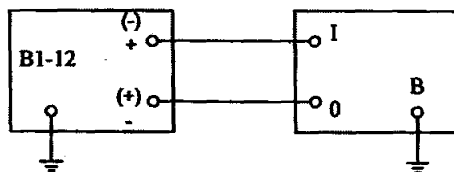

В - поверяемый вольтметр

Рисунок 3 - Схема электрическая структурная подключения приборов для опробования вольтметра в режиме измерения силы постоянного тока

- 2) устанавливают при помощи ручной установки предел измерения вольтметра 20 мА;
- 3) подают от прибора В1-12 постоянный ток значением 10 мА;
- 4) убеждаются, что вольтметр измеряет постоянный ток 10 мА, а на индикаторном табло индицируется знак «+».

Инв. №подл.	196466	Подпись и дата	
Взам инв. №		Подпись и дата	
Инв. № дубл.		Инв. № дубл.	

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


Тг2.710.016 МП



Лист  
11

3.2.4 Контроль работоспособности вольтметра в режиме измерения электрического сопротивления проводят в следующей последовательности:

1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 4;

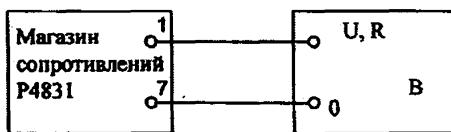

В - поверяемый вольтметр

Рисунок 4 - Схема электрическая структурная подключения приборов для опробования вольтметра в режиме измерения электрического сопротивления

2) устанавливают при помощи ручной установки предел измерения вольтметра 2 кΩ;

3) устанавливают сопротивление магазина сопротивлений Р4831, равным 1 кΩ;

4) убеждаются, что вольтметр измеряет сопротивление 1 кΩ;

5) отключают магазин сопротивлений от вольтметра и убеждаются, что при разомкнутых концах измерительного кабеля вольтметр индицирует перегрузку (мигающее показание 0000).

По результатам опробования делают отметку в протоколе (приложение А).

### 3.3 Определение электрической прочности изоляции.

3.3.1 Определение электрической прочности изоляции проводят с помощью универсальной пробойной установки УПУ-1М (или УПУ-10) в следующей последовательности:

1) соединяют при помощи перемычки гнездо «U, R» с гнездом «0» проверяемого вольтметра;


2) подают испытательное напряжение начиная с 300 V между соединенными вместе гнездами «U, R» и «0» и корпусом вольтметра.

Испытательное напряжение поднимают плавно или равномерно ступенями, не превышающими 10 % от значения испытательного напряжения, за время 5-10 с. Изоляция должна находиться под полным испытательным напряжением в течение 1 мин., после чего испытательное напряжение снижают плавно или равномерно ступенями до нуля;

Инд. №подл.	198466
Подпись и дата	15.09.17г
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата,	

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Tr2.710.016 МП

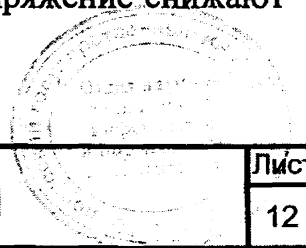

Лист  
12

3) подают испытательное напряжение между клеммой заземления на задней панели вольтметра и соединенными вместе контактами сетевого разъема. Тумблер СЕТЬ на передней панели вольтметра включают. Подачу испытательного напряжения необходимо проводить плавно или равномерно ступенями, не превышающими 10 % от значения испытательного напряжения, начиная с 200 V.

Изоляцию необходимо выдерживать под испытательным напряжением в течение 1 мин.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если во время испытаний не произошло пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

По результатам определения делают отметку в протоколе (приложение А).

### 3.4 Определение электрической прочности изоляции высоковольтного делителя напряжения ДНВ.

3.4.1 Определение электрической прочности изоляции высоковольтного делителя напряжения необходимо проводить при помощи аппарата АИИ-70 в следующей последовательности:

1) соединяют вывод защитного заземления «  $\perp$  » высоковольтного делителя с заземленным выводом аппарата АИИ-70.

Подсоединяют высоковольтный вывод делителя к высоковольтному выводу аппарата АИИ-70;

2) включают аппарат АИИ-70 в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. Устанавливают на выходе аппарата напряжение переменного тока частотой 50 Hz, действующее значение которого равно 30 kV. Напряжение необходимо контролировать по показаниям вольтметра аппарата;

3) плавно или равномерно ступенями за время 5-10 с увеличивают напряжение на выходе аппарата АИИ-70 до значения испытательного напряжения 45 kV и поддерживают его в течение 1 мин;

4) наличие или отсутствие в процессе испытания пробоя или перекрытия изоляции необходимо определить визуально или по звуку разрядов, или по показаниям приборов. Появление «короны» или шума при испытании не является признаком неудовлетворительных результатов испытания;

5) уменьшают плавно напряжение на выходе аппарата АИИ-70 до нуля, выключают аппарат;

6) необходимо убедиться на основании показаний вольтметра в отсутствии напряжения на входе высоковольтного делителя, отсоединяют его от выхода аппарата АИИ-70, при этом необходимо принять меры по обеспечению безопасности в соответствии с инструкцией по эксплуатации аппарата.

Инд. № подл.	196466
Подпись и дата	15.09.97г
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Тг2.710.016 МП

Лист  
13

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если во время испытаний не произошло пробоя или перекрытия изоляции высоковольтного делителя.


По результатам определения делают отметку в протоколе (приложение А).

### 3.5 Определение метрологических характеристик

3.5.1 Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока определяется методом сравнения с многозначной мерой.

Контроль того, что основная погрешность вольтметра не превышает пределов допускаемых значений погрешности, указанных в таблице 2 для положительной и отрицательной полярностей напряжений в проверяемых точках  $N_0$ , проводят по приведенной ниже методике:

- 1) подготавливают поверяемый вольтметр к работе, прогревают его в течение 15 мин., собирают схему измерений в соответствии с рисунком 5;
- 2) устанавливают напряжение прибора В1-12, равное номинальному значению напряжения в данной поверяемой точке  $N_0$ , указанной в таблице 2;
- 3) проводят отсчет показаний  $U_B$  поверяемого вольтметра;
- 4) проводят поверку вольтметра на всех пределах измерения во всех поверяемых точках, указанных в таблице 2.

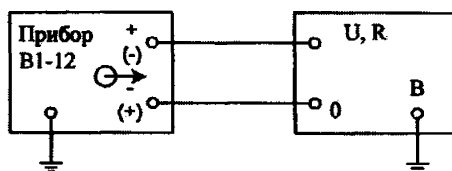

В - поверяемый вольтметр

Рисунок 5 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения напряжения постоянного тока

Индв. Наподл	198466	Взам инв. №	Индв. № дубл.	Подпись и дата,
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Tr2.710.016 МП

Лист  
14

Таблица 2

Предел измерения	Поверяемая точка No, V	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\delta$ , V	Значение допуска контроля $\gamma \cdot \Delta\delta$ , V	Пределы изменения показаний поверяемого вольтметра		Полярность входного напряжения
				$N_0 - \gamma \cdot \Delta\delta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta\delta$	
200 mV	00,07 mV	$\pm 0,04$ mV	$\pm 0,04$ mV	00,03	00,11	Положительная и отрицательная
	02,00 mV	$\pm 0,04$ mV	$\pm 0,04$ mV	01,96	02,04	Положительная
	50,00 mV	$\pm 0,06$ mV	$\pm 0,06$ mV	49,94	50,06	"
	100,00 mV	$\pm 0,07$ mV	$\pm 0,07$ mV	99,93	100,07	Положительная и отрицательная
	150,00 mV 190,00 mV	$\pm 0,08$ mV $\pm 0,10$ mV	$\pm 0,08$ mV $\pm 0,10$ mV	149,92 189,90	150,08 190,10	Положительная Положительная и отрицательная
2 V	,2000	$\pm 0,0005$	$\pm 0,0005$	,1995	,2005	Положительная и отрицательная
	,5000	$\pm 0,0006$	$\pm 0,0006$	,4994	,5006	Положительная
	1,0000	$\pm 0,0007$	$\pm 0,0007$	,9993	1,0007	Положительная и отрицательная
	1,5000	$\pm 0,0008$	$\pm 0,0008$	1,4992	1,5008	Положительная
	1,9000	$\pm 0,0010$	$\pm 0,0010$	1,8990	1,9010	"
20 V	2,000	$\pm 0,006$	$\pm 0,006$	1,994	2,006	Положительная
	10,000	$\pm 0,012$	$\pm 0,012$	9,988	10,012	"
	19,000	$\pm 0,019$	$\pm 0,019$	18,981	19,019	Положительная и отрицательная
200 V	20,00	$\pm 0,06$	$\pm 0,06$	19,94	20,06	Положительная
	100,00	$\pm 0,12$	$\pm 0,12$	99,88	100,12	"
	190,00	$\pm 0,19$	$\pm 0,19$	189,81	190,19	Положительная и отрицательная
1000 V	200,0	$\pm 0,460$	$\pm 0,5$	199,5	200,5	Положительная
	500,0	$\pm 0,850$	$\pm 0,9$	499,1	500,9	"
	1000,0	$\pm 1,500$	$\pm 1,5$	998,5	1001,5	Положительная и отрицательная

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых точках, указанных в таблице 2, показания  $U_B$  поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству

$$N_0 - \gamma \cdot \Delta\delta \leq U_B \leq N_0 + \gamma \cdot \Delta\delta \quad (1)$$

где  $N_0 - \gamma \cdot \Delta\delta$ ,  $N_0 + \gamma \cdot \Delta\delta$  - значения, указанные в таблице 2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Tr2.710.016 МП


Лист  
15

3.5.2 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем напряжения проводится методом сравнения с мерой по приведенной ниже методике.

Для определения погрешности измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем сначала контролируют прочность изоляции высоковольтного делителя по методике 3.4. А затем проводят поверку вольтметра с высоковольтным делителем в поверяемых точках 1; 1,5; 1,9 kV - по методике 3.5.2.1, в проверяемых точках 5; 10; 15; 19; 20; 30 kV - по методике 3.5.2.2, вольтметра с высоковольтным делителем и шунтом «К2» - по методике 3.5.2.3, вольтметра с высоковольтным делителем и шунтом «К3» - по методике 3.5.2.4;

3.5.2.1 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем ДНВ в поверяемых точках 1; 1,5; 1,9 kV проводят в следующей последовательности:

1) соединяют приборы по структурной схеме, приведенной на рисунке 6;

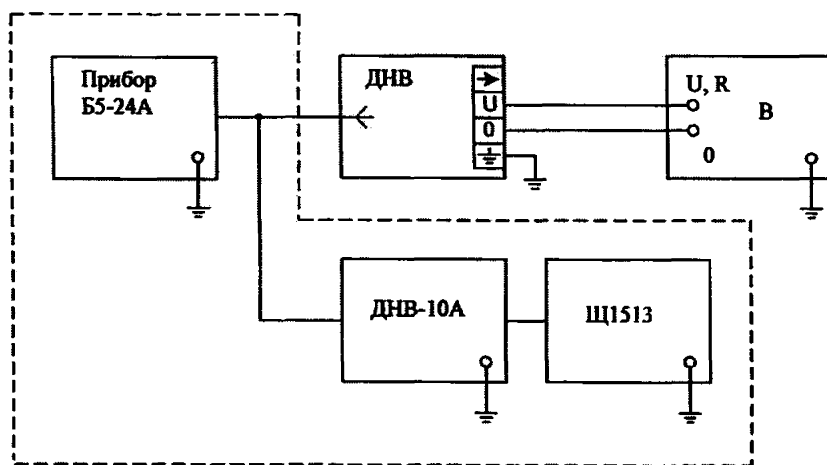

Б5-24А - источник постоянного напряжения из комплекта установки УПК-100;

ДНВ - поверяемый высоковольтный делитель;

ДНВ-10А - высоковольтный делитель постоянного напряжения с коэффициентом деления  $K=1000$  из комплекта установки УПК-100;

В - поверяемый вольтметр;


Щ1513 - вольтметр цифровой из комплекта установки УПК-100.

Рисунок 6 - Структурная схема соединений приборов для определения основной погрешности измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем до 2 kV

Инв. № подл.	196466	Подпись и дата	AS.09.17
Взам инв. №		Инв. № дубл.	
Подпись и дата		Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Tr2.710.016 МП



Лист  
16



- 2) устанавливают коэффициент деления делителя ДНВ-10А равным 1000;
- 3) устанавливают предел измерения вольтметра Щ1513 равным 3 V;
- 4) для каждой из проверяемых точек 1; 1,5; 1,9 kV устанавливают напряжение источника постоянного напряжения Б5-24А, равное значению напряжения в проверяемой точке с точностью  $\pm 100$  V;
- 5) по истечении 2-3 мин. проводят отсчет показаний  $U_1$  вольтметра Щ1513 и показания  $U_2$  поверяемого вольтметра;
- 6) определяют погрешность измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем ДНВ в процентах по формуле

$$\delta = \frac{1000U_2 - U_1 \cdot K_{\text{ДНВ-10А}}}{U_1 \cdot K_{\text{ДНВ-10А}}}, \quad (2)$$

где  $\delta$  - погрешность измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем ДНВ;

$K_{\text{ДНВ-10А}}$  - коэффициент деления делителя ДНВ-10А;

$U_1$  - показание вольтметра Щ1513;

$U_2$  - показание поверяемого вольтметра.

3.5.2.2 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока свыше 2 kV проводят в следующей последовательности:

- 1) соединяют приборы по структурной схеме, приведенной на рисунке 7.

*Примечание* - При сборке схемы соединений приборов, приведенной на рисунке 7, руководствуются указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации установки УПК-100 и ее составных частей.

Любые изменения схемы измерений (переключение пределов, подключение элементов схемы, приборов и т.п.) необходимо проводить только после того, как будет полностью отключено выходное напряжение источника высокого напряжения ИВН-100 и будут приняты меры по обеспечению безопасности в соответствии с указаниями, приведенными в инструкциях по эксплуатации установки УПК-100 и ее составных частей.

Проверяют надежность заземления всех элементов схемы соединений приборов. Заземление проверяют визуально и при помощи комбинированного прибора Ц4315 из комплекта установки УПК-100;

- 2) подготавливают установку УПК-100 к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки. Включают установку УПК-100 и вольтметр Щ1513 в сеть и прогревают их в течение 1 мин.;

- 3) устанавливают коэффициент деления делителя ДНВ-100 равным 10000;

Инд. №подл	196486
Подпись и дата	15.09.17
Взам инв. №	
Инд. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------


Tr2.710.016 МП

Лист  
17

4) устанавливают напряжение установки УПК-100 для каждой из проверяемых точек 5; 10; 19; 20 kV, равное значению напряжения в проверяемой точке с точностью  $\pm 0,5$  kV;

5) в проверяемой точке 30 kV устанавливают напряжение установки УПК-100 в пределах 29-30 kV;

6) по истечении 2-3 мин. проверяют отсчет показания  $U_1$  вольтметра Щ1513 и показания  $U_2$  поверяемого вольтметра;

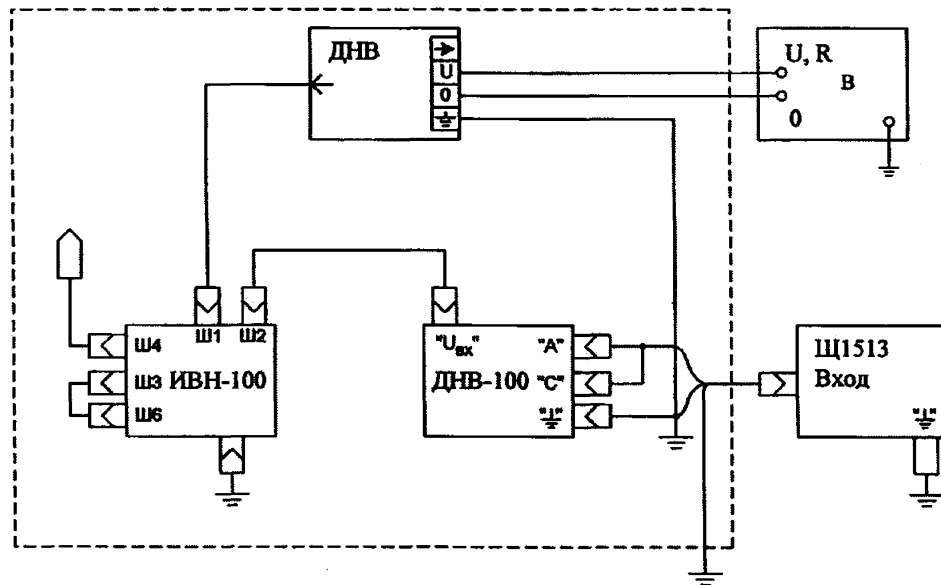

ИВН-100 - источник высокого напряжения из комплекта установки УПК-100;

ДНВ - проверяемый высоковольтный делитель;

ДНВ-100 - высоковольтный делитель постоянного напряжения из комплекта установки УПК-100;

В - поверяемый вольтметр;

Щ1513 - вольтметр цифровой из комплекта установки УПК-100.

Рисунок 7 - Структурная схема соединений приборов для определения основной погрешности измерения напряжения постоянного тока вольтметров с высоковольтным делителем в поверяемых точках свыше 2 kV

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
196466				
Подпись и дата	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата	
15.09.17				

Тг2.710.016 МП

Лист  
18

7) определяют погрешность измерений напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем в процентах по формуле

$$\delta = \frac{1000U_2 - U_1 \cdot K_{ДНВ-100}}{U_1 \cdot K_{ДНВ-100}}, \quad (3)$$

где  $\delta$  - погрешность измерений напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем;

$K_{ДНВ-100}$  - коэффициент деления делителя ДНВ-100 установки УПК-100 равный 10000;

$U_1$  - показание вольтметра Щ1513;

$U_2$  - показание поверяемого вольтметра.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если погрешность, вычисленная по формуле (2) или (3) в данной проверяемой точке, определяемой показанием  $U_1$  вольтметра Щ1513, не превышает значений погрешности, вычисленной для данной проверяемой точки по формуле (4):

$$\pm \left[ 0,4 + 0,04 \left( \frac{U_K}{U} - 1 \right) \right]; \quad (4)$$

где  $U_K$  - конечное значение установленного предела измерений вольтметров (200 mV, 2, 20, 200 V);

$$U = 0,001 U_{ДНВ};$$

где  $U_{ДНВ}$  - значение измеряемого напряжения на входе высоковольтного делителя напряжения ДНВ.

3.5.3 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем напряжения и шунтом «К2» проводится по методике 3.5.3.1, вольтметра с высоковольтным делителем и шунтом «К3» - по методике 3.5.3.2.

3.5.3.1 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем напряжения и шунтом «К2» проводится в проверяемых точках 4; 30 kV в следующей последовательности:

1) соединяют приборы по структурной схеме, приведенной на рисунке 7, при этом подключают к гнездам «U, R» и «0» поверяемого вольтметра шунт «К2» согласно гравировке «U» и «0» на его корпусе, затем подключают выход высоковольтного делителя ко входу шунта;

необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в 3.5.2.2;

2) устанавливают коэффициент деления делителя ДНВ-100, равный 10000;

Инд. Неодпл	196466	Подпись и дата	15.09.17	Инв. № дубл.		Подпись и дата	
Взам инв. №							

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Тг2.710.016 МП

Лист  
19

- 3) устанавливают предел измерения вольтметра Щ1513 3V;
- 4) устанавливают предел измерения поверяемого вольтметра 2 V в проверяемой точке 4 kV и предел 20 V в проверяемой точке 30 kV;
- 5) устанавливают выходное напряжение установки УПК-100 в проверяемой точке 4 kV в пределах 3,5 - 4 kV, в проверяемой точке 30 kV - пределах 29 - 30 kV;
- 6) по истечении 2 - 3 мин. проводят отсчет показаний  $U_1$  поверяемого вольтметра и показания  $U_2$  вольтметра Щ1513;
- 7) определяют погрешность измерений напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем и шунтом «К2» по формуле

$$\delta_1 = \frac{2000U_1 - U_2 \cdot K_{ДНВ-100}}{U_2 \cdot K_{ДНВ-100}} \cdot 100, \quad (5)$$

где  $\delta_1$  - погрешность измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем и шунтом «К2»;

$U_1$  - показание поверяемого вольтметра;

$U_2$  - показание вольтметра Щ1513;

$K_{ДНВ-100}$  - коэффициент деления делителя ДНВ-100 равный 10000.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность, вычисленная по формуле (5) в данной проверяемой точке, определяемой показанием вольтметра Щ1513, не превышает значения погрешности, вычисленной для данной проверяемой точки по формуле (6);

$$\pm \left[ 0,4 + 0,04 \left( \frac{U_K}{U_{ш1}} - 1 \right) \right]; \quad (6)$$

где  $U_K$  - конечное значение установленного предела измерений вольтметров (200 mV, 2, 20, 200 V);

$$U_{ш1} = 0,0005 U_{ДНВ};$$

где  $U_{ДНВ}$  - значение измеряемого напряжения на входе высоковольтного делителя напряжения ДНВ.

3.5.3.2 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем напряжения и шунтом «К3» проводят в проверяемых точках 10 и 30 kV в следующей последовательности:

- 1) соединяют приборы по структурной схеме, приведенной на рисунке 7, при этом подключают к гнездам «U, R» и «0» поверяемого вольтметра шунт «К3» согласно гравировке «U» и «0» на его корпусе, затем подключают выход высоковольтного делителя к входу шунта;

необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в 3.5.2.2;

Инв. № подл. 156466	Подпись и дата 15.09.17	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист 20
Тг2.710.016 МП					Лист
					20

2) устанавливают коэффициент деления делителя ДНВ-100, равный 10000;

3) устанавливают предел измерения вольтметра Щ1513 3 V;

4) устанавливают предел измерения поверяемого вольтметра 2 V в проверяемой точке 10 kV и 20 V в проверяемой точке 30 kV;

5) устанавливают выходное напряжение установки УПК-100 в проверяемой точке 10 kV в пределах 9-10 kV, в проверяемой точке 30 kV - в пределах 29 - 30 kV;

6) по истечении 2-3 мин. проводят отсчет показаний  $U_1$  поверяемого вольтметра и показания  $U_2$  вольтметра Щ1513;

7) определяют погрешность измерений напряжения постоянного тока вольтметра с высоковольтным делителем и шунтом «К3» по формуле

$$\delta_1 = \frac{5000U_1 - U_2 \cdot K_{\text{ДНВ-100}}}{U_2 \cdot K_{\text{ДНВ-100}}} \cdot 100, \quad (7)$$

где  $\delta_1$  - погрешность измерения постоянного напряжения вольтметра с высоковольтным делителем и шунтом «К3»;

$U_1$  - показание поверяемого вольтметра;

$U_2$  - показание вольтметра Щ1513;

$K_{\text{ДНВ-100}}$  - коэффициент деления делителя ДНВ-100 равный 10000.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если погрешность, вычисленная по формуле (7) в данной проверяемой точке, определяемой показанием вольтметра Щ1513, не превышает значения погрешности, вычисленной для данной проверяемой точки по формуле (8).

$$\pm \left[ 0,4 + 0,04 \left( \frac{U_K}{U_{\text{ш2}}} - 1 \right) \right], \quad (8)$$

где  $U_K$  - конечное значение установленного предела измерений вольтметров (200 mV, 2, 20, 200 V);

$$U_{\text{ш2}} = 0,0002 U_{\text{ДНВ}},$$

где  $U_{\text{ДНВ}}$  - значение измеряемого напряжения на входе высоковольтного делителя напряжения ДНВ.


3.5.4 Основную погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока определяют методом сравнения с многозначной мерой.

3.5.4.1 Определение основной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы проводят в следующей последовательности:

Инв. Наподл. 196466	Подпись и дата 15.09.97	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
------------------------	----------------------------	-------------	--------------	----------------


Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП




Лист  
21

1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 8. При определении погрешности измерения переменного напряжения в точках, превышающих 100 V, приборы соединяют по структурной схеме, приведенной на рисунке 9;

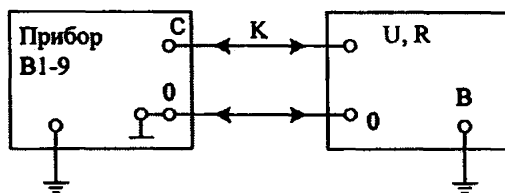

К - кабель из комплекта прибора В1-9;  
В - проверяемый вольтметр

Рисунок 8 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы до 100V

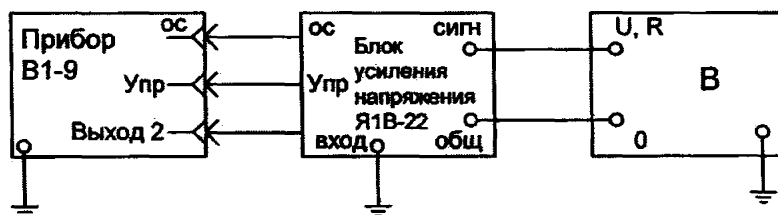

В - поверяемый вольтметр.

Рисунок 9 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы свыше 100 V

2) для данной поверяемой точки  $N_0$  устанавливают напряжение и частоту выходного сигнала прибора В1-9 или прибора В1-9 с блоком Я1В-22 в соответствии с таблицей 3;

3) после установления параметров напряжения прибора В1-9 или прибора В1-9 с блоком Я1В-22 проводят отсчет показаний поверяемого вольтметра;

4) поверку вольтметра проводят во всех поверяемых точках, указанных в таблице 3.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых точках и на всех частотах входных сигналов показания  $U_B$  поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
156466				
Подпись и дата	Изм. № дубл.	Взам инв. №	Подпись и дата	
			15.09.17г.	

Tr2.710.016 МП

Лист  
22

$$N_0 - \gamma \cdot \Delta\delta \leq N_B \leq N_0 + \gamma \cdot \Delta\delta, \quad (9)$$

где  $N_0 - \gamma \cdot \Delta\delta, N_0 + \gamma \cdot \Delta\delta$  - значения, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Предел измерения, V	Номинальное показание в поверяемой точке $N_0$ , V	Частота выходного сигнала прибора В1-9	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\delta$ единиц младшего разряда	Значение допуска контроля $\gamma \cdot \Delta\delta$ , единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
					$N_0 - \gamma \cdot \Delta\delta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta\delta$
200 mV	02,00 mV	20 Hz	22	20	01,80	02,20
		40 Hz	21	19	01,81	02,19
		10 kHz	21	21	01,79	02,21
		20 kHz	22	20	01,80	02,20
		50 kHz	40	38	01,62	02,38
		100 kHz	99	99	01,01	02,99
	50,00 mV	20 Hz	65	60	49,40	50,60
		40 Hz	45	40	49,60	50,40
		10 kHz	45	45	49,55	50,45
		20 kHz	65	62	49,38	50,62
		50 kHz	272	272	47,28	52,72
		100 kHz	560	560	44,40	55,60
	100,00 mV	20 Hz	110	103	98,97	101,03
		40 Hz	70	63	99,37	100,63
		10 kHz	70	70	99,30	100,70
		20 kHz	110	106	98,94	101,06
		50 kHz	515	515	94,85	105,15
		100 kHz	1040	1040	89,60	110,40
150,00 mV	20 Hz	155	146	148,54	151,46	
	40 Hz	95	85	149,15	150,85	
	10 kHz	95	95	149,05	150,95	
	20 kHz	155	148	148,52	151,48	
	50 kHz	757	757	142,43	157,57	
	100 kHz	1520	1520	134,80	165,20	
180,00 mV	20 Hz	182	171	178,29	181,71	
	40 Hz	110	99	179,01	180,99	
	10 kHz	110	110	178,90	181,10	
	20 kHz	182	174	178,26	181,74	
	50 kHz	903	903	170,97	189,03	
	100 kHz	1808	1808	161,92	198,08	

Инд. Наполн.	196466
Подпись и дата	15.09.17.
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП

Лист  
23

Продолжение таблицы 3

Предел измерения, V	Номинальное показание в поверяемой точке $N_0$ , V	Частота выходного сигнала прибора В1-9	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\delta$ единиц младшего разряда	Значение допуска контроля $\gamma \cdot \Delta\delta$ , единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
					$N_0 - \gamma \cdot \Delta\delta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta\delta$
2	,2000	20 Hz	38	36	,1964	,2036
		40 Hz	30	28	,1972	,2028
		10 kHz	30	30	,1970	,2030
		20 kHz	38	38	,1962	,2038
		50 kHz	127	127	,1873	,2127
		100 kHz	272	272	,1728	,2272
	,5000	20 Hz	65	63	,4937	,5063
		40 Hz	45	42	,4958	,5042
		10 kHz	45	45	,4955	,5045
		20 kHz	65	65	,4935	,5065
		50 kHz	272	272	,4728	,5272
		100 kHz	560	560	,4440	,5560
	1,0000	20 Hz	110	106	,9894	1,0106
		40 Hz	70	66	,9934	1,0066
		10 kHz	70	70	,9930	1,0070
		20 kHz	110	110	,9890	1,0110
		50 kHz	515	515	,9485	1,0515
		100 kHz	1040	1040	,8960	1,1040
	1,5000	20 Hz	155	146	1,4854	1,5146
		40 Hz	95	85	1,4915	1,5085
		10 kHz	95	95	1,4905	1,5095
		20 kHz	155	150	1,4850	1,5150
		50 kHz	757	757	1,4243	1,5757
		100 kHz	1520	1520	1,3480	1,6520
1,8000	20 Hz	182	171	1,7829	1,8171	
	40 Hz	110	98	1,7902	1,8098	
	10 kHz	110	110	1,7890	1,8110	
	20 kHz	182	174	1,7826	1,8174	
	50 kHz	903	903	1,7097	1,8903	
	100 kHz	1808	1808	1,6192	1,9808	

Инв. № подл. 156466	Подпись и дата 15.09.17	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
------------------------	----------------------------	-------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП

Лист  
24



Продолжение таблицы 3

Предел измерения, V	Номинальное показание в поверяемой точке $N_0$ , V	Частота выходного сигнала прибора В1-9	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\delta$ единиц младшего разряда	Значение допуска контроля $\gamma \cdot \Delta\delta$ , единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра		
					$N_0 - \gamma \cdot \Delta\delta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta\delta$	
20	2,000	20 Hz	38	37	1,963	2,037	
		40 Hz	30	29	1,971	2,029	
		10 kHz	30	30	1,970	2,030	
		20 kHz	38	38	1,962	2,038	
		50 kHz	127	127	1,873	2,127	
		100 kHz	272	272	1,728	2,272	
	10,000	20 Hz	110	107	9,893	10,107	
		40 Hz	70	66	9,934	10,066	
		10 kHz	70	70	9,930	10,070	
		20 kHz	110	110	9,890	10,110	
		50 kHz	515	515	9,485	10,515	
		100 kHz	1040	1040	8,960	11,040	
	18,000	20 Hz	182	172	17,828	18,172	
		40 Hz	110	101	17,899	18,101	
		10 kHz	110	110	17,890	18,110	
		20 kHz	182	171	17,829	18,171	
		50 kHz	903	903	17,097	18,903	
		100 kHz	1808	1808	16,192	19,808	
	200	20,00	20 Hz	38	37	19,63	20,37
			40 Hz	30	29	19,71	20,29
			10 kHz	30	30	19,70	20,30
20 kHz			38	37	19,63	20,37	
50 kHz			127	127	18,73	21,27	
100 kHz			272	272	17,28	22,72	
	100,00	20 Hz	110	106	98,94	101,06	
		40 Hz	70	66	99,34	100,66	
		10 kHz	70	70	99,30	100,70	
		20 kHz	110	106	98,94	101,06	
		50 kHz	515	515	94,85	105,15	
		100 kHz	1040	1040	89,60	110,40	

Инд. Неоподл.	166466	Подпись и дата	
Взам инв. №		Подпись и дата	15.09.17
Инв. № дубл.		Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Продолжение таблицы 3

Предел измерения, V	Номинальное показание в поверяемой точке $N_0$ , V	Частота выходного сигнала прибора В1-9	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\theta$ единиц младшего разряда	Значение допуска контроля $\gamma \cdot \Delta\theta$ , единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
					$N_0 - \gamma \cdot \Delta\theta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta\theta$
200	180,00	20 Hz	182	171	178,29	181,71
		40 Hz	110	99	179,01	180,99
		10 kHz	110	95	179,05	180,95
		20 kHz	182	171	178,29	181,71
		50 kHz	903	903	170,97	189,03
		100 kHz	1808	1808	161,92	198,08
500	200,0	20 Hz	38	37	196,3	203,7
		40 Hz	30	29	197,1	202,9
		500 Hz	30	29	197,1	202,9
		1 kHz	30	29	197,1	202,9
		5 kHz	38	37	196,3	203,7
		500,0	20 Hz	65	63	493,7
	500,0	40 Hz	45	42	495,8	504,2
		500 Hz	45	42	495,8	504,2
		1 kHz	45	42	495,8	504,2
		5 kHz	65	63	493,7	506,3



3.5.4.2 Основную погрешность измерения переменного среднеквадратического значения напряжения переменного тока произвольной формы с коэффициентом амплитуды  $\leq 3$  определяют следующим образом:

1) соединяют приборы по структурной схеме, приведенной на рисунке 10;

2) устанавливают на вольтметре режим измерения постоянного напряжения на диапазоне измерения с конечным значением  $U_k 20 V$ ;

3) устанавливают на генераторе Г5-75 режим постоянного тока, полярность положительная, для чего:


а) нажимают кнопку ПОЛЕ и наблюдают над ней включение светодиода;

б) нажимают кнопку «» и наблюдают включение светодиода «»;

Инд. № подл.	198466
Подпись и дата	 15.09.17
Взам инв. №	
Инд. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Tr2.710.016 МП



Лист  
26

в) нажимают кнопку « — — — » и наблюдают включение светодиода « — — — »;

г) нажимают кнопку « ▼ 2 »;

д) нажимают кнопку ПОЛЕ, должен включиться светодиод под этой кнопкой;

е) устанавливают при помощи кнопок «1» - «9» генератора Г5-75 напряжение  $(3,333 \pm 0,002) \text{ V}$ ; контролируя его по индикатору проверяемых вольтметров. Записывают показания проверяемых вольтметров  $U_1$ ;

4) устанавливают на генераторе Г5-75 режим импульсного тока нажатием кнопки ПОЛЕ и наблюдают включение светодиода над этой кнопкой, после чего нажимают кнопку СБРОС;

5) устанавливают на табло генератора Г5-75 периодическую последовательность импульсов с периодом следования  $24000 \text{ } \mu\text{s}$ , длительностью  $2400 \text{ } \mu\text{s}$ , что соответствует коэффициенту амплитуды напряжения  $k_a = 3$ ;

6) устанавливают на вольтметрах режим измерения переменного напряжения на диапазоне измерения с конечным значением  $U_k 2 \text{ V}$ ;

7) измеряют частотомером ЧЗ-63 период  $T$  и длительность  $\tau$  импульсов, для чего устанавливают на частотомере переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ в положение « $10^{-7}$ », переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА в положение « $10^0$ », записывают показания частотомера;

8) отсоединяют частотомер и записывают показания проверяемых вольтметров  $U_2$ ;

9) определяют среднее квадратическое значение переменной составляющей напряжения на входе вольтметров по формуле

$$U_{скз} = U_1 \cdot \frac{\tau}{T} \sqrt{\frac{T}{\tau} - 1}, \quad (10)$$

где  $U_{скз}$  – среднее квадратическое значение переменной составляющей напряжения;

$U_1$  – показания вольтметров в режиме измерения постоянного напряжения;

$\tau$  – длительность импульсов;

$T$  – период импульсов.


Результаты поверки считают удовлетворительными, если показания вольтметров  $U_2$  отличаются от рассчитанного по формуле (10) значения  $U_{скз}$  не более, чем на  $0,0176 \text{ V}$  (с учетом  $20 \%$  производственно-эксплуатационного запаса).

Инв. № подл.	196466
Подпись и дата	15.09.17
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Тг2.710.016 МП

Лист  
27

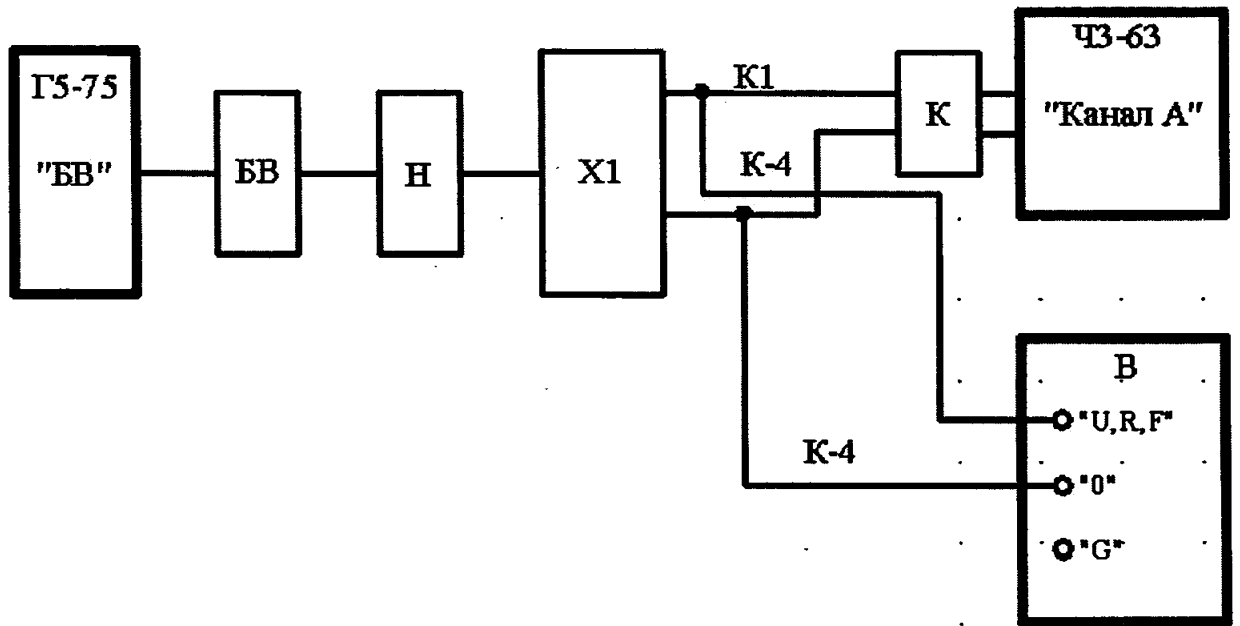

- Г5-75 - генератор импульсов точной амплитуды;
- БВ - выносной блок к генератору Г5-75;
- Н - нагрузка 50 Ом из комплекта генератора Г5-75;
- Х1 - тройник низкочастотный из комплекта генератора Г5-75;
- К1 - кабель 4.850.192-06 из комплекта генератора Г5-75;
- ЧЗ-63 - частотомер электронно-счетный ЧЗ-63;
- К - кабель из комплекта частотомера ЧЗ-63;
- К-4 - кабель измерительный;
- В - проверяемый вольтметр

Рисунок 10 - Структурная схема соединения приборов для проверки основной погрешности измерения напряжения переменного тока произвольной формы с коэффициентом амплитуды  $k_a \leq 3$

Инв. № подл.	196466	Подпись и дата	
Взам инв. №		Подпись и дата	15.09.17
Инв. № дубл.		Подпись и дата	


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Tr2.710.016 МП

Лист  
28

3.5.5 Основную погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока вольтметра с делителем переменного напряжения определяют методом сравнения с многозначной мерой в следующей последовательности:

- 1) соединяют приборы по структурной схеме, приведенной на рисунке 11;
- 2) устанавливают для данной поверяемой точки  $N_0$  напряжение и частоту выходного напряжения прибора В1-9 с блоком усиления Я1В-22 в соответствии с таблицей 4;
- 3) после установления параметров напряжения прибора В1-9 с блоком Я1В-22 проводят отсчет показаний  $U_B$  поверяемого вольтметра;
- 4) проводят поверку вольтметра с делителем переменного напряжения во всех поверяемых точках и на всех частотах, указанных в таблице 4.

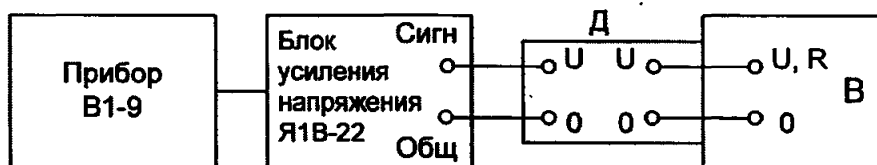


Д - делитель переменного напряжения ДПН;  
В - поверяемый вольтметр.

Рисунок 11 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения напряжения переменного тока вольтметра с делителем переменного напряжения

Инд. Наподл 196466	Подпись и дата <i>[Signature]</i> 15.09.19	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
-----------------------	--	-------------	--------------	----------------

Изм	Лист	№докум.	Подл.	Дата
-----	------	---------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Лист  
29

Таблица 4

Предел измерения вольтметра, V	Поверяемая точка $N_0$ , kV	Частота выходного сигнала прибора В1-9 с блоком Я1В-22	Предел допускаемой основной погрешности, единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний вольтметра	
				$N_0 - \Delta\vartheta$	$N_0 + \Delta\vartheta$
2	0,5	20 Hz	65	,4935	,5065
		40 Hz	45	,4955	,5045
		500 Hz	45	,4955	,5045
		1 kHz	45	,4955	,5045
	0,75	20 Hz	87	,7413	,7587
		40 Hz	57	,7443	,7557
		500 Hz	57	,7443	,7557
		1 kHz	57	,7443	,7557
	1,0	20 Hz	110	,9890	1,0110
		40 Hz	70	,9930	1,0070
		500 Hz	70	,9930	1,0070
		1 kHz	70	,9930	1,0070

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых точках показания  $U_B$  поверяемых вольтметров удовлетворяют неравенству


$$N_0 - \Delta\vartheta \leq N_B \leq N_0 + \Delta\vartheta, \quad (11)$$

где  $N_0 - \Delta\vartheta$ ,  $N_0 + \Delta\vartheta$  - значения, указанные в таблице 4.

3.5.6. Основную погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы вольтметра с высокочастотным пробником определяют методом сравнения с многозначной мерой в следующей последовательности:

- 1) соединяют приборы по структурной схеме, приведенной на рисунке 12 для поверяемых точек на частотах 50, 100 kHz или на рисунке 13 для поверяемых точек на частотах свыше 100 kHz;
- 2) устанавливают на поверяемом вольтметре режим измерения постоянного напряжения;
- 3) устанавливают для данной поверяемой точки выходное напряжение  $U_B$  прибора В1-9 или В1-15, значение и частота которого указана в таблице 5;
- 4) проводят отсчет показаний  $U_B$  вольтметра с ВЧ пробником.


Tr2.710.016 МП

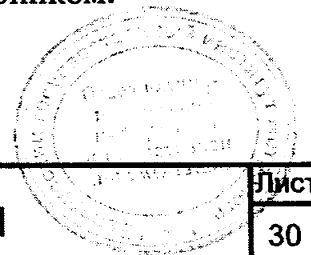

Инд. Непопл.	196466	Подпись и дата	15.09.14
Взам инв. №		Инд. № дубл.	
Подпись и дата		Подпись и дата	


Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Лист  
30

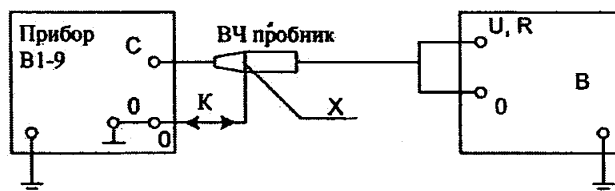

X - хомутик из комплекта поверяемого вольтметра;  
 К - кабель КЗ из комплекта поверяемого вольтметра;  
 В - поверяемый вольтметр

Рисунок 12 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения напряжения переменного тока вольтметра с ВЧ пробником на частотах 50, 100 кГц

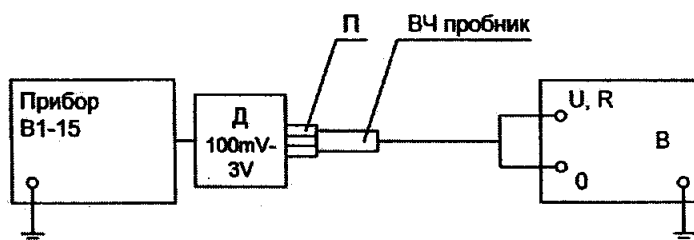


Д - делитель напряжения ВЧ из комплекта прибора В1-15;  
 П - переходная втулка из комплекта прибора В1-15;  
 В - поверяемый вольтметр.

Рисунок 13 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения напряжения переменного тока вольтметра с ВЧ пробником на частотах свыше 100 кГц

Инд. №подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
196466	15.05.14			

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Тг2.710.016 МП



Лист 31


Таблица 5

Номинальное значение напряжения $U_0$ в поверяемой точке, V	Частота напряжения переменного тока в поверяемой точке	Предел допускаемой основной погрешности измерения вольтметра с высокочастотным пробником $\Delta \vartheta$ , V	Допускаемые показания вольтметра, V	
			$U_0 - \Delta \vartheta$	$U_0 + \Delta \vartheta$
0,1	50 kHz	0,0994	00,60 mV	199,40 mV
0,5		0,1370	,3630	,6370
1,0		0,1840	,8160	1,1840
5,0		0,5600	4,440	5,560
10,0		1,0300	8,970	11,030
0,1	100 kHz	0,0994	00,60 mV	199,40 mV
0,5		0,1370	,3630	,6370
1,0		0,1840	,8180	1,1840
5,0		0,5600	4,440	5,560
10,0		1,0300	8,970	11,030
0,1	30 MHz	0,0994	00,60 mV	199,40 mV
0,3		0,1182	181,80 mV	,4182
1,0		0,1840	,8160	1,1840
3,0		0,3720	2,628	3,372
0,1	50 MHz	0,0994	00,60 mV	199,40 mV
0,3		0,1182	181,80 mV	,4182
1,0		0,1840	,8160	1,1840
3,0		0,3720	2,628	3,372
0,1	100 MHz	0,0970	03,00 mV	197,00 mV
0,3		0,1110	189,00 mV	,4110
1,0		0,1600	,8400	1,1600
3,0		0,300	2,700	3,300
0,1	150 MHz	0,0970	03,00 mV	197,00 mV
0,3		0,1110	189,00 mV	,4110
1,0		0,1600	,8400	1,1600
3,0		0,300	2,700	3,300
0,1	300 MHz	0,0970	03,00 mV	197,00 mV
0,3		0,1110	189,00	,4110
1,0		0,160	,8400	1,1600
3,0		0,300	2,700	3,300
0,1	600 MHz	0,0780	22,00 mV	178,00 mV
0,3		0,1140	186,00 mV	,4140
1,0		0,2400	,7600	1,2400
3,0		0,600	2,400	3,600

Инд. Неодтл	196466	Подпись и дата	
Взам инв. №		Инд. № дубл.	
Подпись и дата	15.09.19г	Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП

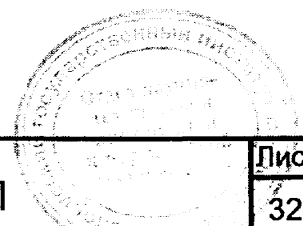Лист  
32



Продолжение таблицы 5

Номинальное значение напряжения $U_0$ в поверяемой точке, V	Частота напряжения переменного тока в поверяемой точке	Предел допускаемой основной погрешности измерения вольтметра с высокочастотным пробником $\Delta \vartheta$ , V	Допускаемые показания вольтметра, V	
			$U_0 - \Delta \vartheta$	$U_0 + \Delta \vartheta$
0,1	700 MHz	0,0780	22,00 mV	178,00 mV
0,3		0,1140	186,00 mV	,4140
1,0		0,2400	,7600	1,2400
3,0		0,6000	2,400	3,600
0,1	800 MHz	0,078	22,00 mV	178,00 mV
0,3		0,1140	186,00 mV	,4140
1,0		0,2400	,7600	1,2400
3,0		0,6000	2,400	3,600
0,1	1000 MHz	0,0880	12,00 mV	188,00 mV
0,3		0,1440	156,00 mV	,4440
1,0		0,3400	,6600	1,3400
3,0		0,9000	2,100	3,900

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если показания  $U_B$  поверяемого вольтметра с ВЧ пробником удовлетворяют неравенству

$$N_0 - \Delta \vartheta \leq N_B \leq N_0 + \Delta \vartheta, \quad (12)$$

где  $N_0 - \Delta \vartheta$ ,  $N_0 + \Delta \vartheta$  - значения, указанные в таблице 5.

3.5.7 Основную погрешность измерения силы постоянного тока определяют методом сравнения с многозначной мерой для токов до 100 мА и методом сравнения с образцовым током, определяемым по падению напряжения на образцовом сопротивлении, для токов свыше 100 мА.


3.5.7.1 Определяют основную погрешность измерения силы постоянного тока до 100 мА, для чего:

- 1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 14;


Инд. № подл.	196466
Подпись и дата	15.09.19
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Лист  
33

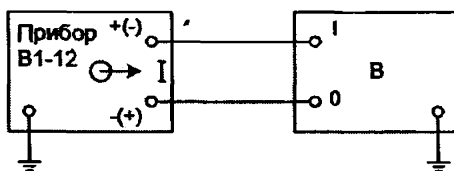

В - поверяемый вольтметр

Рисунок 14 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения силы постоянного тока до 100 мА

- 2) устанавливают для одной из поверяемых точек  $N_0$  данного предела измерения выходной ток прибора В1-12 в соответствии с таблицей 6;
- 3) проводят отсчет показаний  $I_B$  поверяемого вольтметра;
- 4) проводят поверку вольтметра во всех поверяемых точках, указанных в таблице 6;

Таблица 6

Предел измерения, мА	Поверяемая точка $N_0$ , мА	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\delta$ , единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемых вольтметров		Полярность входного тока
			$N_0 - \Delta\delta$	$N_0 + \Delta\delta$	
200 $\mu$ А	00,05 $\mu$ А	4	00,01	00,09	Положительная и отрицательная
	02,00 $\mu$ А	4	01,96	02,04	Положительная
	20,00 $\mu$ А	8	19,92	20,08	Положительная и отрицательная
	100,00 $\mu$ А	22	99,78	100,22	Положительная
	150,00 $\mu$ А 190,00 $\mu$ А	31 38	149,69 189,62	150,31 190,38	Положительная и отрицательная
2	,2000	8	,1992	,2008	Положительная
	1,0000	22	,9978	1,0022	"
	1,9000	38	1,8962	1,9038	Положительная и отрицательная

Инд. Пододп.	196466	Подпись и дата	15.09.17	Взам инв. №		Инд. № дубл.		Подпись и дата.	
--------------	--------	----------------	----------	-------------	--	--------------	--	-----------------	--

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Тг2.710.016 МП

Лист  
34

Продолжение таблицы 6

Предел измерения, мА	Поверяемая точка $N_0$ , мА	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\delta$ , единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемых вольтметров		Полярность входного тока
			$N_0 - \Delta\delta$	$N_0 + \Delta\delta$	
20	2,000	8	1,992	2,008	Положительная "
	10,000	22	9,978	10,022	
	19,000	38	18,962	19,038	Положительная и отрицательная
200	20,00	8	19,92	20,08	Положительная "
	100,0	22	99,78	100,22	
2000	100,0	6	099,4	100,6	Положительная и отрицательная

3.5.7.2 Определяют основную погрешность измерения силы постоянного тока от 100 мА до 2 А, для чего:

- 1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 15;
- 2) устанавливают необходимый предел измерения вольтметра В7-46;
- 3) устанавливают показание вольтметра В7-46, равным значению  $U_1$ , указанному в таблице 7 для данной поверяемой точки  $N_0$ , изменяя выходное напряжение источника Б5-47 и сопротивление резистора R3;
- 4) проводят отсчет показаний  $I_B$  поверяемого вольтметра для данной поверяемой точки;
- 5) проводят поверку вольтметра во всех поверяемых точках  $N_0$ , указанных в таблице 7.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых точках, указанных в таблице 6 и таблице 7, показания поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству


$$N_0 - \Delta\delta \leq I_B \leq N_0 + \Delta\delta, \quad (13)$$

где  $N_0 - \Delta\delta$ ,  $N_0 + \Delta\delta$  - значения, указанные в таблице 6 и таблице 7.


Инд. № подл.	196466	Подпись и дата	
Взам инв. №		Подпись и дата	15.09.87
Инд. № дубл.		Подпись и дата	

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Лист  
35

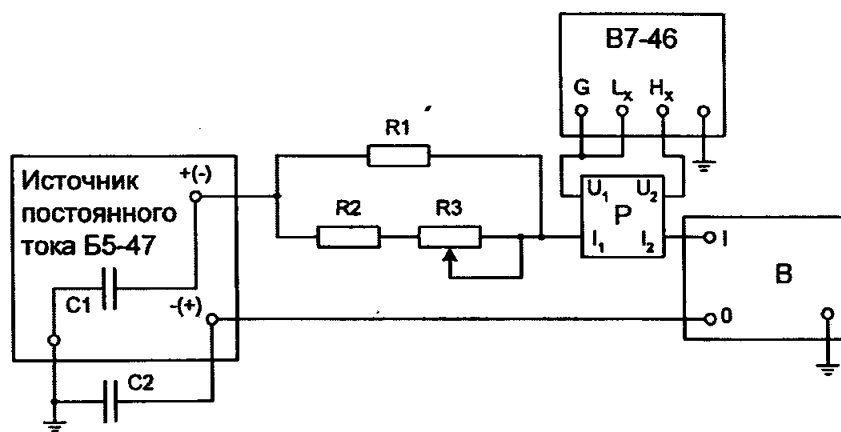

Р - катушка электрического сопротивления Р321 (10  $\Omega$  - для поверяемой точки 190 мА; 0,1  $\Omega$  - для поверяемых точек 1000 и 1900 мА);  
 R1 - резистор ПЭВ-25-10  $\Omega \pm 10\%$ ;  
 R2 - резистор ОМЛТ-2-510  $\Omega \pm 10\%$ ;  
 R3 - резистор СП5-2-1W-3,3 k  $\Omega \pm 10\%$ ;  
 C1, C2 - конденсатор К73-16-100V-1  $\mu\text{F} \pm 10\%$ ;  
 В - поверяемый вольтметр.

Рисунок 15 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения силы постоянного тока на пределе 200 мА в поверяемой точке 190 мА и на пределе 2 А в поверяемых точках 1000 и 1900 мА

Таблица 7

Предел измерения	Поверяемая точка No	Номинальное сопротивление катушки Р321, $\Omega$	Показания $U_1$ вольтметра В7-28, V	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\delta$ , единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемых вольтметров		Полярность входного тока
					$N_0 - \Delta\delta$	$N_0 + \Delta\delta$	
200 мА	190,00	10	1,9	38	189,62	190,38	Положительная и отрицательная
2000 мА	1000,0	0,1	0,1	22	997,8	1002,2	Положительная
	1900,0	0,1	0,19	38	1896,2	1903,8	Положительная и отрицательная

Инв. № подл.	196466
Подпись и дата	15.09.87
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	


Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП

Лист  
36

3.5.8 Основную погрешность измерения силы постоянного тока вольтметра с шунтом «10 А» определяют методом сравнения с образцовым током, установленным по создаваемому им падению напряжения на образцовом сопротивлении в следующей последовательности:

- 1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 16;
- 2) устанавливают на поверяемом вольтметре режим измерения постоянного напряжения.

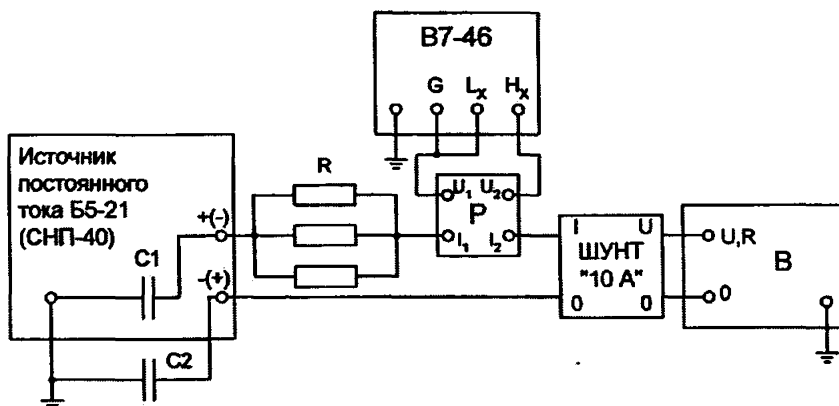

- C1, C2 - конденсатор К73-16-100V-1  $\mu\text{F} \pm 10\%$ ;  
 R - резистор С5-16Т-10W-0,68  $\Omega \pm 5\%$  (3 шт)  
 или любой резистор 0,13-0,25  $\Omega$  мощностью более 30 W;  
 P - катушка электрического сопротивления P310 (0,01  $\Omega$ );  
 B - поверяемый вольтметр.

Рисунок 16 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерений силы постоянного тока вольтметра с шунтом «10 А»

3) устанавливают для поверяемых точек 2; 5; 10 А ток источника постоянного тока Б5-21 такого значения, чтобы показания вольтметра В7-46 были равны соответственно 20,000; 50,000; 100,000 mV с точностью  $\pm 10\%$ ;

4) определяют действительное значение тока в данной поверяемой точке по формуле:

$$I_g = \frac{U_{B7-46}}{R_{P310}}, \quad (14)$$

где  $U_{B7-46}$  - показание вольтметра В7-46 в данной поверяемой точке;  
 $R_{P310}$  - сопротивление катушки P310 равное 0,01  $\Omega$ ;

5) определяют показание  $U_B$  поверяемого вольтметра с шунтом «10 А» в данной поверяемой точке;

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
196466				
Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата.	
15.09.17				

Тг2.710.016 МП

Лист  
37

б) определяют погрешность измерения силы постоянного тока вольтметра с шунтом «10 А» в данной поверяемой точке, в процентах, по формуле

$$\delta = \left( \frac{U_B \cdot R_{P310}}{0,01 \cdot U_{B7-46}} - 1 \right) \cdot 100, \quad (15)$$

где  $\delta$  - погрешность измерения силы постоянного тока вольтметра с шунтом «10 А»;

$U_{B7-46}$  - показание вольтметра В7-46 в данной поверяемой точке;

$U_B$  - показание поверяемого вольтметра в данной поверяемой точке;

$R_{P310}$  - сопротивление катушки P310, равное 0,01  $\Omega$ .

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность измерения силы постоянного тока вольтметра с шунтом «10 А», вычисленная по формуле (15), не превышает погрешности, вычисленной по формуле (16) для данной поверяемой точки, определяемой по формуле (14).

$$\pm \left[ 0,4 + 0,02 \left( \frac{I_K}{I} - 1 \right) \right], \quad (16)$$

где  $I_K$  - конечное значение измеряемой вольтметром силы постоянного тока, равное 10 А;

$I$  - значение силы измеряемого постоянного тока на входе, А.

3.5.9. Основная погрешность измерения силы переменного тока вольтметра определяется методом сравнения с мерой в следующей последовательности:

1) собирают схему измерений в соответствии с рисунком 17 или рисунком 18;

*Примечание* - Перед подключением в схему резисторов С2-29В измеряют их сопротивление вольтметром В7-46. Допускается применять в схеме резисторы, сопротивление которых отклоняется от номинального не более чем на +0,15 %.

2) устанавливают напряжение и частоту выходного сигнала прибора В1-9 (или прибора В1-9 с блоком Я1В-22) в соответствии с таблицей 8. После установления параметров сигнала прибора В1-9 (или прибора В1-9 с блоком Я1В-22) проводят отсчет показания  $I_B$  поверяемого вольтметра;


3) проводят поверку вольтметра во всех поверяемых точках на всех частотах, указанных в таблице 8.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых точках на всех частотах, указанных в таблице 8, показание поверяемого вольтметра удовлетворяет неравенству

Инв. Наподл 196466	Подпись и дата	Взаим инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		
	15.09.91					
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата	Тг2.710.016 МП	Лист
						38

$$N_0 - \Delta\partial \leq I_B \leq N_0 + \Delta\partial, \quad (17)$$

где  $N_0 - \Delta\partial$ ,  $N_0 + \Delta\partial$  - значения, указанные в таблице 8.

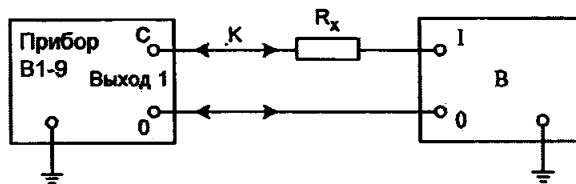

В - поверяемый вольтметр;


$R_x$  - резистор С2-29 В:

С2-29В-0,125-100  $k\Omega \pm 0,1\%$ -1,0-А - при работе на пределе измерений 200  $\mu$ А;

С2-29В-0,5-10  $k\Omega \pm 0,1\%$ -1,0-А - при работе на пределе измерений 2 мА;

К - кабель из комплекта прибора В1-9

Рисунок 17 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения силы переменного тока на пределах измерений 200  $\mu$ А, 2 мА

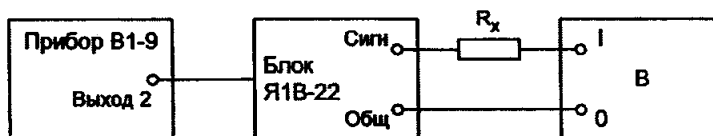

В - поверяемый вольтметр;

$R_x$  - два соединенных последовательно резистора С2-29В-2-4,7  $k\Omega \pm 0,1\%$ -А

Рисунок 18 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения силы переменного тока на пределах измерений 20, 200, 2000 мА

Инв. № подл.	196466
Подпись и дата	15.09.17.
Взаим инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Тг2.710.016 МП

Лист  
39

Таблица 8

Предел измерения, mA	Поворяемая точка, N <sub>0</sub> , mA	Значение выходного напряжения прибора В1-9 (блока Я1В-22)	Частота выходного напряжения прибора В1-9	Предел допускаемой основной погрешности Δδ, единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
					N <sub>0</sub> - Δδ	N <sub>0</sub> + Δδ
200 μA	02,0 μA	0,202	40 Hz	22	01,78	02,22
			5 kHz	22	01,78	02,22
			10 kHz	22	01,78	02,22
			15 kHz	24	01,76	02,24
			20 kHz	24	01,76	02,24
	20,0 μA	2,020	40 Hz	38	19,62	20,38
			5 kHz	38	19,62	20,38
			10 kHz	38	19,62	20,38
			15 kHz	58	19,42	20,58
			20 kHz	58	19,42	20,58
	100,0 μA	10,100	40 Hz	110	98,90	101,10
			5 kHz	110	98,90	101,10
			10 kHz	110	98,90	101,10
			15 kHz	210	97,90	102,10
			20 kHz	210	97,90	102,10
	190,0 μA	19,19	40 Hz	191	188,09	191,91
			5 kHz	191	188,09	191,91
			10 kHz	191	188,09	191,91
			15 kHz	381	186,19	193,81
			20 kHz	381	186,19	193,81
2	1,900	19,19	40 Hz	191	1,8809	1,9191
			5 kHz	191	1,8809	1,9191
			10 kHz	191	1,8809	1,9191
			20 kHz	381	1,8619	1,9381
20	19,00	178,6	40 Hz	191	18,809	19,191
			5 kHz	191	18,809	19,191
			10 kHz	191	18,809	19,191
			15 kHz	381	18,619	19,381
200	20,0	188,0	40 Hz	38	19,62	20,38
			5 kHz	38	19,62	20,38
			10 kHz	38	19,62	20,38
			15 kHz	58	19,42	20,58
			20 kHz	58	19,42	20,58

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Tr2.710.016 МП

Лист  
40




Продолжение таблицы 8

Предел измерения, мА	Поверяемая точка, $N_0$ , мА	Значение выходного напряжения прибора В1-9 (блока Я1В-22)	Частота выходного напряжения прибора В1-9	Предел допускаемой основной погрешности $\Delta\delta$ , единиц младшего разряда	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
					$N_0 - \Delta\delta$	$N_0 + \Delta\delta$
2000	020	188,0	40 Hz	22	017,8	022,2
			500 Hz	22	017,8	022,2
			1 kHz	22	017,8	022,2
			2 kHz	22	017,8	022,2

3.5.10 Основную погрешность измерения электрического сопротивления определяют методом сравнения с мерой в следующей последовательности:

1) собирают схему измерений согласно рисункам 19 - 22 в соответствии с поверяемыми пределами и точками, указанными в таблице 9, при этом вывод кабеля № 2, маркированный символом «U» (красного цвета), подключают к гнезду «0» поверяемого вольтметра, вывод кабеля, маркированный символом «0» - к гнезду «U, R» поверяемого вольтметра;

2) для каждой поверяемой точки устанавливают сопротивление магазина сопротивлений в соответствии с таблицей 9. Проводят отсчет показаний  $R_B$  поверяемого вольтметра.

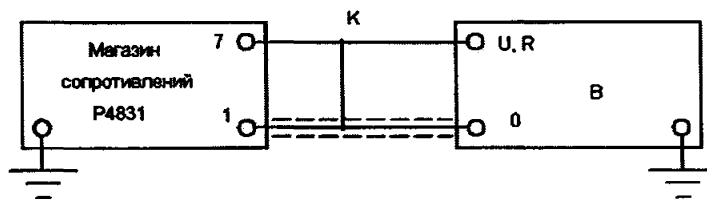

К - измерительный кабель К2 из комплекта поверяемого вольтметра;  
В - поверяемый вольтметр.


Рисунок 19 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения электрического сопротивления на пределах 200  $\Omega$ ; 2, 20 k $\Omega$  и на пределе 200 k $\Omega$  в поверяемых точках 20, 50, 100 k $\Omega$

Тг2.710.016 МП

Лист


41

Изм Лист Недокум. Подл. Дата

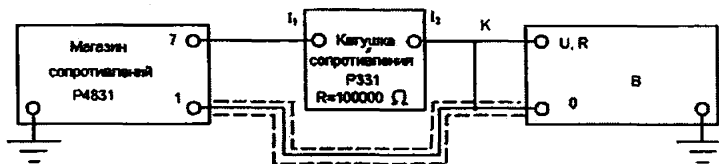


К - измерительный кабель К2 из комплекта поверяемого вольтметра;  
В - поверяемый вольтметр.

Рисунок 20 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения электрического сопротивления на пределе 200 кΩ в поверяемых точках 150, 190 кΩ

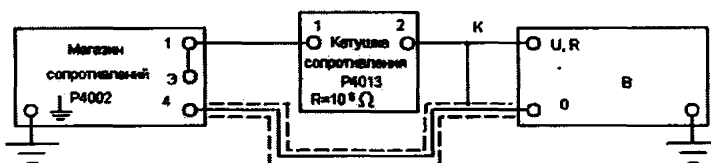

К - измерительный кабель К2 из комплекта поверяемого вольтметра;  
В - поверяемый вольтметр.

Рисунок 21 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения электрического сопротивления на пределе 2000 кΩ в поверяемых точках 1500 и 1900 кΩ

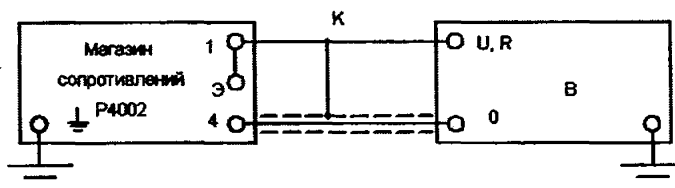

К - измерительный кабель К2 из комплекта поверяемого вольтметра;  
В - поверяемый вольтметр.

Рисунок 22 - Схема электрическая структурная подключения приборов для определения основной погрешности измерения электрического сопротивления на пределе 2000 кΩ в поверяемых точках 200, 500 кΩ и на пределе 20 МΩ

Инв. № подл.	196466	Подпись и дата	
Взам инв. №		Инв. № дубл.	
Подпись и дата	15.09.17	Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Тг2.710.016 МП



Лист  
42

Таблица 9

Предел измерения, кΩ	Поверяемая точка No, кΩ	Образцовая мера	Значение образцовой меры, Ω	Предел допускаемой основной погрешности Δd, единиц младшего разряда	Допускаемые изменения показаний поверяемого вольтметра	
					No - Δd	No + Δd
200 Ω	00,10 Ω	P4831	0,1	10	00,00	00,20
	02,00 Ω	P4831	2,0	10	01,90	02,10
	20,00 Ω	P4831	20	12	19,88	20,12
	50,00 Ω	P4831	50	15	49,85	50,15
	100,00 Ω	P4831	100	20	99,80	100,20
	150,00 Ω	P4831	150	25	149,75	150,25
	190,00 Ω	P4831	190	29	189,71	190,29
2	,2000	P4831	200	12	,1988	,2012
	,5000	P4831	500	15	,4985	,5015
	1,0000	P4831	1000	20	,9980	1,0020
	1,5000	P4831	1500	25	1,4975	1,5025
	1,9000	P4831	1900	29	1,8971	1,9029
20	2,000	P4831	2000	12	1,988	2,012
	5,000	P4831	5000	15	4,985	5,015
	10,000	P4831	10000	20	9,980	10,020
	15,000	P4831	15000	25	14,975	15,025
	19,000	P4831	19000	29	18,971	19,029
200	20,00	P4831	20000	12	19,88	20,12
	50,00	P4831	50000	15	49,85	50,15
	100,00	P4831	100000	20	99,80	100,20
	150,00	P4831	50000	25	149,75	150,25
	190,00	P4831	90000	29	189,71	190,29
		P331	100000			
2000	200,0	P4002	2·10 <sup>5</sup>	12	198,8	201,2
	500,0	P4002	5·10 <sup>5</sup>	15	498,5	501,5
	1500,0	P4002	5·10 <sup>5</sup>	25	1497,5	1502,5
	1900,0	P4002	9·10 <sup>5</sup>	29	1897,1	1902,9
		P4013	10 <sup>6</sup>			
20 MΩ	2,00 MΩ	P4002	2 MΩ	28	1,972	2,028
	5,00 MΩ	P4002	5 MΩ	40	4,960	5,040
	10,00 MΩ	P4002	10 MΩ	60	9,940	10,060
	15,00 MΩ	P4002	15 MΩ	80	14,920	15,080
	19,00 MΩ	P4002	19 MΩ	96	18,904	19,096

Ивл. №подл.	156466	Подпись и дата	
Взам инв. №		Ивл. № дубл.	
Подпись и дата	15.09.17	Подпись и дата	

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

Tr2.710.016 МП

3) проводят поверку вольтметра во всех поверяемых точках  $N_0$ , указанных в таблице 9.

При поверке вольтметра в поверяемых точках на пределе  $200 \Omega$  необходимо учитывать сопротивление измерительного кабеля поверяемого вольтметра, для чего перед измерениями соединяют концы измерительного кабеля и запоминают показание  $R_{нач}$  поверяемого вольтметра.

Проводят вычитание значения  $R_{нач}$  из показаний  $R_B$  в поверяемых точках до  $200 \Omega$ .

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если показания  $R_B$  (или  $R_B - R_{нач}$ ) поверяемого вольтметра во всех поверяемых точках, указанных в таблице 9, удовлетворяют неравенству

$$N_0 - \Delta\delta \leq R_B \leq N_0 + \Delta\delta, \quad (18)$$


где  $N_0 - \Delta\delta$ ,  $N_0 + \Delta\delta$  - значения, указанные в таблице 9.

#### 4 Оформление результатов поверки

4.1 Результаты поверки заносят в протокол поверки, рекомендуемая форма которого в приложении А.

4.2 Положительные результаты поверки удостоверяются нанесением оттиска поверительного клейма или выдачей свидетельства о поверке установленного образца.

4.3 При отрицательных результатах поверки вольтметры изымаются из обращения и применения, оттиск поверительного клейма гасится, а свидетельство о поверке аннулируется.

Инв. № подл. 196466	Подпись и дата	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
	 15.09.17					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тг2.710.016 МП	Лист
						44

**Приложение А**  
(рекомендуемое)  
**Форма протокола поверки вольтметра**

Протокол № \_\_\_\_\_  
поверки вольтметра В7-40/1

Заводской номер вольтметра \_\_\_\_\_

Наименование организации, проводившей поверку \_\_\_\_\_

Наименование предприятия-владельца вольтметра \_\_\_\_\_

Методика поверки \_\_\_\_\_

**А.1 Условия поверки:**

- температура окружающего воздуха \_\_\_\_\_ °С;
- относительная влажность воздуха \_\_\_\_\_ %;
- атмосферное давление \_\_\_\_\_ кПа;
- напряжение питающей сети \_\_\_\_\_ В.
- частота питающей сети \_\_\_\_\_ Гц.

**А.2 Средства поверки**

Таблица А.1

Наименование СИ	Тип СИ	Заводской номер	Свидетельство о поверке	

Инд. Метрол	196486	Подпись и дата	С.И. 15.09.17	Взам инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата,	
-------------	--------	----------------	---------------	-------------	--	--------------	--	-----------------	--

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------


Tr2.710.016 МП

Лист  
45

### А.3 Проведение поверки

Таблица А.2

Наименование операций	Номер пункта МП	Заключение о соответствии требованиям МП
Внешний осмотр	3.1	
Опробование	3.2	
Определение электрической прочности изоляции	3.3	
Определение электрической прочности изоляции высоковольтного делителя напряжения ДНВ	3.4	


Инв. Неподрл	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата,
196 466	 15.09.97г			
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
Тг2.710.016 МП				Лист
				46

## А.4 Определение метрологических характеристик

### А.4.1 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока

Таблица А.3

Предел измерения	Поверяемая точка $N_0$ , V	Показания поверяемого вольтметра	Пределы изменения показаний поверяемого вольтметра		Полярность входного напряжения
			$N_0 - \gamma \cdot \Delta \vartheta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta \vartheta$	
200 mV	00,07 mV		00,03	00,11	Положительная и отрицательная
	02,00 mV		01,96	02,04	Положительная
	50,00 mV		49,94	50,06	"
	100,00 mV		99,93	100,07	Положительная и отрицательная
	150,00 mV 190,00 mV		149,92 189,90	150,08 190,10	Положительная Положительная и отрицательная
2 V	,2000		,1995	,2005	Положительная и отрицательная
	,5000		,4994	,5006	Положительная
	1,0000		,9993	1,0007	Положительная и отрицательная
	1,5000		1,4992	1,5008	Положительная
	1,9000		1,8990	1,9010	"
20 V	2,000		1,994	2,006	Положительная
	10,000		9,988	10,012	"
	19,000		18,981	19,019	Положительная и отрицательная
200 V	20,00		19,94	20,06	Положительная
	100,00		99,88	100,12	"
	190,00		189,81	190,19	Положительная и отрицательная
1000 V	200,0		199,5	200,5	Положительная
	500,0		499,1	500,9	"
	1000,0		998,5	1001,5	Положительная и отрицательная

Инв. № подл. 196466	Подпись и дата  15.09.17	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
------------------------	--	-------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Тг.2.710.016 МП



А.4.2 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока с высоковольтным делителем напряжения

Таблица А.4

Поверяемая точка, kV	Номинальное значение, V	Предельное отклонение, %	Предельное отклонение, V	Измеренное значение, V или %	Заключение о соответствии
1,0	1,0000	±0,44	±0,0044		
1,5	1,5000	±0,41	±0,0063		
1,9	1,9000	±0,402	±0,0076		
5	5,000	±0,52	±0,026		
10	10,000	±0,44	±0,044		
15	15,000	±0,41	±0,063		
19	19,000	±0,402	±0,076		
20	20,00	±0,76	±0,15		
30	30,00	±0,63	±0,19		

А.4.3 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока с высоковольтным делителем напряжения и шунтом «К2»

Таблица А.5

Поверяемая точка, kV	Номинальное значение, V	Предельное отклонение, %	Предельное отклонение, V	Измеренное значение, V или %	Заключение о соответствии
4	2,000	±0,4	±0,016		
30	15,000	±0,41	±0,063		

А.4.4 Определение основной погрешности измерения напряжения постоянного тока с высоковольтным делителем напряжения и шунтом «К3»

Таблица А.6

Поверяемая точка, kV	Номинальное значение, V	Предельное отклонение, %	Предельное отклонение, V	Измеренное значение, V или %	Заключение о соответствии
4	0,8000	±0,46	±0,0037		
30	6,000	±0,49	±0,030		

Инь. №подл 196 466	Подпись и дата 15.09.08	Взам инв. №	Инь. № дубл.	Подпись и дата
-----------------------	----------------------------	-------------	--------------	----------------

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Лист  
48



А.4.5 Определение основной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы

Таблица А.7

Предел измерения, V	Номинальное показание в поверяемой точке $N_0$ , V	Частота выходного сигнала прибора В1-9	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
				$N_0 - \gamma \cdot \Delta \vartheta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta \vartheta$
200 mV	02,00 mV	20 Hz		01,80	02,20
		40 Hz		01,81	02,19
		10 kHz		01,79	02,21
		20 kHz		01,80	02,20
		50 kHz		01,62	02,38
		100 kHz		01,01	02,99
	50,00 mV	20 Hz		49,40	50,60
		40 Hz		49,60	50,40
		10 kHz		49,55	50,45
		20 kHz		49,38	50,62
		50 kHz		47,28	52,72
		100 kHz		44,40	55,60
	100,00 mV	20 Hz		98,97	101,03
		40 Hz		99,37	100,63
		10 kHz		99,30	100,70
		20 kHz		98,94	101,06
		50 kHz		94,85	105,15
		100 kHz		89,60	110,40
	150,00 mV	20 Hz		148,54	151,46
		40 Hz		149,15	150,85
		10 kHz		149,05	150,95
		20 kHz		148,52	151,48
		50 kHz		142,43	157,57
		100 kHz		134,80	165,20
180,00 mV	20 Hz		178,29	181,71	
	40 Hz		179,01	180,99	
	10 kHz		178,90	181,10	
	20 kHz		178,26	181,74	
	50 kHz		170,97	189,03	
	100 kHz		161,92	198,08	
2	,2000	20 Hz		,1964	,2036
		40 Hz		,1972	,2028
		10 kHz		,1970	,2030
		20 kHz		,1962	,2038

Инв. № подл. 19 64 66	Подпись и дата 15.09.14	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------------------	----------------------------	-------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Тг2.710.016 МП

Лист  
49


Продолжение таблицы А.7

Предел измерения, V	Номинальное показание в поверяемой точке N <sub>0</sub> , V	Частота выходного сигнала прибора В1-9	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
				N <sub>0</sub> - γ · Δθ	N <sub>0</sub> + γ · Δθ
2	,2000	50 kHz		,1873	,2127
		100 kHz		,1728	,2272
	,5000	20 Hz		,4937	,5063
		40 Hz		,4958	,5042
		10 kHz		,4955	,5045
		20 kHz		,4935	,5065
		50 kHz		,4728	,5272
		100 kHz		,4440	,5560
	1,0000	20 Hz		,9894	1,0106
		40 Hz		,9934	1,0066
		10 kHz		,9930	1,0070
		20 kHz		,9890	1,0110
50 kHz			,9485	1,0515	
100 kHz			,8960	1,1040	
1,5000	20 Hz		1,4854	1,5146	
	40 Hz		1,4915	1,5085	
	10 kHz		1,4905	1,5095	
	20 kHz		1,4850	1,5150	
	50 kHz		1,4243	1,5757	
	100 kHz		1,3480	1,6520	
1,8000	20 Hz		1,7829	1,8171	
	40 Hz		1,7902	1,8098	
	10 kHz		1,7890	1,8110	
	20 kHz		1,7826	1,8174	
	50 kHz		1,7097	1,8903	
	100 kHz		1,6192	1,9808	
20	2,000	20 Hz		1,963	2,037
		40 Hz		1,971	2,029
		10 kHz		1,970	2,030
		20 kHz		1,962	2,038
		50 kHz		1,873	2,127
		100 kHz		1,728	2,272

Инд. № подл. 196466	Подпись и дата  15.09.14г.	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата.
------------------------	--	-------------	--------------	-----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Лист  
50


Продолжение таблицы А.7

Предел измерения, V	Номинальное показание в поверяемой точке No, V	Частота выходного сигнала прибора В1-9	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
				$N_0 - \gamma \cdot \Delta \vartheta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta \vartheta$
20	10,000	20 Hz		9,893	10,107
		40 Hz		9,934	10,066
		10 kHz		9,930	10,070
		20 kHz		9,890	10,110
		50 kHz		9,485	10,515
		100 kHz		8,960	11,040
	18,000	20 Hz		17,828	18,172
		40 Hz		17,899	18,101
		10 kHz		17,890	18,110
		20 kHz		17,829	18,171
		50 kHz		17,097	18,903
		100 kHz		16,192	19,808
200	20,00	20 Hz		19,63	20,37
		40 Hz		19,71	20,29
		10 kHz		19,70	20,30
		20 kHz		19,63	20,37
		50 kHz		18,73	21,27
		100 kHz		17,28	22,72
	100,00	20 Hz		98,94	101,06
		40 Hz		99,34	100,66
		10 kHz		99,30	100,70
		20 kHz		98,94	101,06
		50 kHz		94,85	105,15
		100 kHz		89,60	110,40
	180,00	20 Hz		178,29	181,71
		40 Hz		179,01	180,99
		10 kHz		179,05	180,95
		20 kHz		178,29	181,71
		50 kHz		170,97	189,03
		100 kHz		161,92	198,08

Инд. Неодол.	196466	Подпись и дата	15.09.17	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
--------------	--------	----------------	----------	-------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Продолжение таблицы А.7

Предел измерения, V	Номинальное показание в поверяемой точке No, V	Частота выходного сигнала прибора В1-9	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
				$N_0 - \gamma \cdot \Delta \vartheta$	$N_0 + \gamma \cdot \Delta \vartheta$
500	200,0	20 Hz		196,3	203,7
		40 Hz		197,1	202,9
		500 Hz		197,1	202,9
		1 kHz		197,1	202,9
		5 kHz		196,3	203,7
	500,0	20 Hz		493,7	506,3
		40 Hz		495,8	504,2
		500 Hz		495,8	504,2
		1 kHz		495,8	504,2
		5 kHz		493,7	506,3

А.4.6 Определение основной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока произвольной формы с коэффициентом амплитуды  $\leq 3$

Таблица А.8

Показания вольтметра $U_1$ , V	Период импульсов T, $\mu$ s	Длительность импульсов $\tau$ , $\mu$ s	Показания вольтметра $U_2$ , V	Допустимое значение напряжения, V	
				$U_{СКЗ} + 0,0176$	$U_{СКЗ} - 0,0176$

Инв. № подл.	196466	Подпись и дата		Взам инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	
Изм.		Лист		Недокум.		Подл.		Дата	

Тг2.710.016 МП



Лист  
52

А.4.7 Определение основной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока вольтметра с делителем переменного напряжения


Таблица А.9

Предел измерения вольтметра, V	Поверяемая точка $N_0$ , kV	Частота выходного сигнала прибора В1-9 с блоком Я1В-22	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний вольтметра	
				$N_0 - \Delta\theta$	$N_0 + \Delta\theta$
2	0,5	20 Hz		,4935	,5065
		40 Hz		,4955	,5045
		500 Hz		,4955	,5045
		1 kHz		,4955	,5045
	0,75	20 Hz		,7413	,7587
		40 Hz		,7443	,7557
		500 Hz		,7443	,7557
		1 kHz		,7443	,7557
	1,0	20 Hz		,9890	1,0110
		40 Hz		,9930	1,0070
		500 Hz		,9930	1,0070
		1 kHz		,9930	1,0070

Инд. Наполн.	196466
Подпись и дата	15.09.14
Взам инв. №	
Инв. № дубл.	
Подпись и дата	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Тг2.710.016 МП



Лист  
53

А.4.8 Определение основной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы вольтметра с высокочастотным пробником


Таблица А.10

Номинальное значение напряжения $U_0$ в поверяемой точке, V	Частота напряжения переменного тока в поверяемой точке	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые показания вольтметра, V	
			$U_0 - \Delta\delta$	$U_0 + \Delta\delta$
0,1 0,5 1,0 5,0 10,0*	50 kHz		00,60 mV ,3630 ,8160 4,440 8,970	199.40 mV ,6370 1,1840 5,560 11,030
0,1 0,5 1,0 5,0 10,0*	100 kHz		00,60 mV ,3630 ,8180 4,440 8,970	199,40 mV ,6370 1,1840 5,560 11,030
0,1 0,3 1,0 3,0	30 MHz		00,60 mV 181,80 mV ,8160 2,628	199,40 mV ,4182 1,1840 3,372
0,1 0,3 1,0 3,0	50 MHz		00,60 mV 181,80 mV ,8160 2,628	199,40 mV ,4182 1,1840 3,372
0,1 0,3 1,0 3,0	100 MHz		03,00 mV 189,00 mV ,8400 2,700	197,00 mV ,4110 1,1600 3,300
0,1 0,3 1,0 3,0	150 MHz		03,00 mV 189,00 mV ,8400 2,700	197,00 mV ,4110 1,1600 3,300
0,1 0,3 1,0 3,0	300 MHz		03,00 mV 189,00 ,8400 2,700	197,00 mV ,4110 1,1600 3,300

Инд. № подл. 196466	Подпись и дата  15.09.14	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
------------------------	--	-------------	--------------	----------------

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Тг2.710.016 МП



Продолжение таблицы А.10

Номинальное значение напряжения $U_0$ в поверяемой точке, V	Частота напряжения переменного тока в поверяемой точке	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые показания вольтметра, V	
			$U_0 - \Delta\vartheta$	$U_0 + \Delta\vartheta$
0,1 0,3 1,0 3,0	600 MHz		22,00 mV 186,00 mV ,7600 2,400	178,00 mV ,4140 1,2400 3,600
0,1 0,3 1,0 3,0	700 MHz		22,00 mV 186,00 mV ,7600 2,400	178,00 mV ,4140 1,2400 3,600
0,1 0,3 1,0 3,0	800 MHz		22,00 mV 186,00 mV ,7600 2,400	178,00 mV ,4140 1,2400 3,600
0,1 0,3 1,0 3,0	1000 MHz		12,00 mV 156,00 mV ,6600 2,100	188,00 mV ,4440 1,3400 3,900

Инд. №подл. 198466	Подпись и дата [Подпись] 15.09.11г.	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата.
-----------------------	--	-------------	--------------	-----------------

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Лист  
55

А.4.9 Определение основной погрешности измерения силы постоянного тока

Таблица А.11

Предел измерения, мА	Поверяемая точка No, мА	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемых вольтметров		Полярность входного тока
			$N_0 - \Delta\delta$	$N_0 + \Delta\delta$	
200 мА	00,05 мА		00,01	00,09	Положительная и отрицательная
	02,00 мА		01,96	02,04	Положительная
	20,00 мА		19,92	20,08	Положительная и отрицательная
	100,00 мА		99,78	100,22	Положительная
	150,00 мА 190,00 мА		149,69 189,62	150,31 190,38	Положительная и отрицательная
2	,2000		,1992	,2008	Положительная
	1,0000		,9978	1,0022	"
	1,9000		1,8962	1,9038	Положительная и отрицательная
20	2,000		1,992	2,008	Положительная
	10,000		9,978	10,022	"
	19,000		18,962	19,038	Положительная и отрицательная
200	20,00		19,92	20,08	Положительная
	100,0		99,78	100,22	"
2000	100,0		099,4	100,6	Положительная и отрицательная

Инд. №подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
196466	15.09.14			
Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Tr2.710.016 МП

Лист  
56



Таблица А.12

Предел измерения	Поверяемая точка No	Номинальное сопротивление катушки P321, Ω	Показания $U_1$ вольтметра В7-28, V	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемых вольтметров		Полярность входного тока
					$N_0 - \Delta\delta$	$N_0 + \Delta\delta$	
200 мА	190,00	10	1,9		189,62	190,38	Положительная и отрицательная
2000 мА	1000,0	0,1	0,1		997,8	1002,2	Положительная
	1900,0	0,1	0,19		1896,2	1903,8	Положительная и отрицательная

А.4.10 Определение основной погрешности измерения силы постоянного тока с шунтом «10 А»

Таблица А.13

Поверяемая точка, А	Показания вольтметра $U_{В7-46}$ , V	Действительное значение силы тока $J_{д}$ , А	Показания вольтметра $U_{в}$ , V	Погрешность $\delta$	Рассчитанная погрешность
2					
5					
10					

Имя, Подполд	196466	Подпись и дата	15.09.97	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата,
--------------	--------	----------------	----------	-------------	--------------	-----------------

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Лист  
57

А.4.11 Определение основной погрешности измерения силы переменного тока вольтметра

Таблица А.14

Предел измерения, мА	Поверяемая точка, $N_0$ , мА	Значение выходного напряжения прибора В1-9 (блока Я1В-22)	Частота выходного напряжения прибора В1-9	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
					$N_0 - \Delta\delta$	$N_0 + \Delta\delta$
200 $\mu$ А	02,0 $\mu$ А	0,202	40 Hz		01,78	02,22
			5 kHz		01,78	02,22
			10 kHz		01,78	02,22
			15 kHz		01,76	02,24
			20 kHz		01,76	02,24
	20,0 $\mu$ А	2,020	40 Hz		19,62	20,38
			5 kHz		19,62	20,38
			10 kHz		19,62	20,38
			15 kHz		19,42	20,58
	100,0 $\mu$ А	10,100	40 Hz		98,90	101,10
			5 kHz		98,90	101,10
			10 kHz		98,90	101,10
190,0 $\mu$ А	19,19	15 kHz		97,90	102,10	
		20 kHz		97,90	102,10	
2	1,900	19,19	40 Hz		188,09	191,91
			5 kHz		188,09	191,91
			10 kHz		188,09	191,91
			15 kHz		186,19	193,81
			20 kHz		186,19	193,81
20	19,00	178,6	40 Hz		1,8809	1,9191
			5 kHz		1,8809	1,9191
			10 kHz		1,8809	1,9191
			15 kHz		1,8619	1,9381
			20 kHz		1,8619	1,9381

Инд. № подл. 196466	Подпись и дата 15.09.12	Взам инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата.
------------------------	----------------------------	-------------	--------------	-----------------



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тг2.710.016 МП	Лист 58

Продолжение таблицы А.14

Предел измерения, мА	Поверяемая точка, N <sub>0</sub> , мА	Значение выходного напряжения прибора В1-9 (блока Я1В-22)	Частота выходного напряжения прибора В1-9	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые пределы изменения показаний поверяемого вольтметра	
					N <sub>0</sub> - Δδ	N <sub>0</sub> + Δδ
200	20,0	188,0	40 Hz		19,62	20,38
			5 kHz		19,62	20,38
			10 kHz		19,62	20,38
			15 kHz		19,42	20,58
			20 kHz		19,42	20,58
2000	020	188,0	40 Hz		017,8	022,2
			500 Hz		017,8	022,2
			1 kHz		017,8	022,2
			2 kHz		017,8	022,2

А.4.12 Определение основной погрешности измерения электрического сопротивления

Таблица А.15

Предел измерения, кΩ	Поверяемая точка N <sub>0</sub> , кΩ	Образцовая мера	Значение образцовой меры, Ω	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые изменения показаний поверяемого вольтметра	
					N <sub>0</sub> - Δδ	N <sub>0</sub> + Δδ
200 Ω	00,10 Ω	P4831	0,1		00,00	00,20
	02,00 Ω	P4831	2,0		01,90	02,10
	20,00 Ω	P4831	20		19,88	20,12
	50,00 Ω	P4831	50		49,85	50,15
	100,00 Ω	P4831	100		99,80	100,20
	150,00 Ω	P4831	150		149,75	150,25
	190,00 Ω	P4831	190		189,71	190,29
2	,2000	P4831	200		,1988	,2012
	,5000	P4831	500		,4985	,5015
	1,0000	P4831	1000		,9980	1,0020
	1,5000	P4831	1500		1,4975	1,5025
	1,9000	P4831	1900		1,8971	1,9029

Инд. Неподрл	198466	Подпись и дата	
Взаим инв. №		Инд. № дубл.	
Подпись и дата		15.09.17г.	

Изм	Лист	Недокум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Tr2.710.016 МП



Продолжение таблицы А.15

Предел измерения, кΩ	Поверяемая точка No, кΩ	Образцовая мера	Значение образцовой меры, Ω	Показания поверяемого вольтметра	Допускаемые изменения показаний поверяемого вольтметра	
					$N_0 - \Delta\vartheta$	$N_0 + \Delta\vartheta$
20	2,000	P4831	2000		1,988	2,012
	5,000	P4831	5000		4,985	5,015
	10,000	P4831	10000		9,980	10,020
	15,000	P4831	15000		14,975	15,025
	19,000	P4831	19000		18,971	19,029
200	20,00	P4831	20000		19,88	20,12
	50,00	P4831	50000		49,85	50,15
	100,00	P4831	100000		99,80	100,20
	150,00	P4831	50000		149,75	150,25
		P331	100000			
	190,00	P4831	90000		189,71	190,29
P331		100000				
2000	200,0	P4002	$2 \cdot 10^5$		198,8	201,2
	500,0	P4002	$5 \cdot 10^5$		498,5	501,5
	1500,0	P4002	$5 \cdot 10^5$		1497,5	1502,5
		P4013	$10^6$			
	1900,0	P4002	$9 \cdot 10^5$		1897,1	1902,9
P4013	$10^6$					
20 МΩ	2,00 МΩ	P4002	2 МΩ		1,972	2,028
	5,00 МΩ	P4002	5 МΩ		4,960	5,040
	10,00 МΩ	P4002	10 МΩ		9,940	10,060
	15,00 МΩ	P4002	15 МΩ		14,920	15,080
	19,00 МΩ	P4002	19 МΩ		18,904	19,096

Инв. №подл.	186466	Подпись и дата	 15.09.14г	Взам инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата,	
-------------	--------	----------------	---	-------------	--	--------------	--	-----------------	--


МП

Поверитель

подпись

ф.и.о

дата



Tr2.710.016 МП

Изм Лист Недокум. Подп. Дата


Лист 60

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Изм.	Лист	Недокум.	Подп.	Дата

Инд. Неодл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
196466	15.09.97г.			



Tr2.710.016 МП

Лист  
61