

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ» (ФГУП «ВНИИМС»)**

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора  
по производственной метрологии  
ФГУП «ВНИИМС»



И.В. Иванникова  
2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**Преобразователи температуры SITRANS**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**МП 207-021-2020**

г. Москва  
2020 г.

## 1 Введение

Настоящая методика распространяется на преобразователи температуры SITRANS (далее по тексту – приборы, преобразователи или ИП), изготавливаемые фирмой «Siemens AG», Германия (производственная площадка: Siemens A/S, Дания) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками – 3 года.

## 2 Операции поверки

При проведении первичной и периодической поверки приборов должны выполняться операции, указанные в таблице 1

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	Да	Да
2 Опробование	6.2	Да	Да
3 Определение основной погрешности	6.3	Да	Да

Примечание: допускается проведение поверки для меньшего числа измеряемых величин и (или) для меньшего числа НСХ, и (или) на меньшем числе поддиапазонов измерений, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

## 3 Средства поверки

При проведении поверки применяют средства измерений, указанные в таблице 2

Таблица 2

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки (или регистрационный №)
6.2	Калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R), (регистрационный № 52489-13)
6.3	Эталон единицы силы постоянного электрического тока 2-го разряда в соответствии с приказом Росстандарта от 01.10.2018г. № 2091 - Калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R) (Регистрационный № 52489-13) Эталон единицы постоянного электрического напряжения 3-го разряда в соответствии с приказом Росстандарта от 30.12.2019г. №3457 - Калибратор многофункциональный Fluke 5720A (Регистрационный № 52495-13) Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в соответствии с приказом Росстандарта от 30.12.2019 № 3456 - Мера электрического сопротивления многозначная MC3071 (Регистрационный № 66932-17) Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 (регистрационный № 61806-15) Удлиняющие провода по ГОСТ 1790-77, ГОСТ 1791-67 к ТП (в соответствии с требованиями по ГОСТ 8.338-2002) Программно-аппаратный комплекс с поддержкой протоколов HART, BRAIN, FOUNDATION Fieldbus, Profibus позволяющий визуализировать измеренные значения.

Примечание – Допускается применение средств поверки, не приведённых в таблице, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.



#### 4 Требования безопасности

При проведении поверки необходимо соблюдать:

- требования безопасности, которые предусматривают «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ (2019));
- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на эталонные средства измерений и средства испытаний;
- указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации преобразователей.

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные на право проведения поверки данного вида средств измерений и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

#### 5 Условия поверки и подготовка к ней

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С  $23 \pm 2$ ;
- относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80;
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7;
- напряжение питающей сети, В  $220^{+10\%}_{-15\%}$ ;
- частота питающей сети, Гц  $50 \pm 2$ ;
- внешние электрические и магнитные поля, удары и вибрации, влияющие на работу приборов и средств поверки, должны отсутствовать.

5.2 Средства поверки должны быть защищены от вибраций и ударов, от внешних магнитных и электрических полей.

5.3 Средства поверки и оборудование подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.3 Подготавливают прибор к работе в соответствии с Руководством по эксплуатации на преобразователи, регулировку входов («Нуль-Шкала») при этом не производят.

#### 6 Проведение поверки

##### 6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают:

- соответствие внешнего вида, комплектности преобразователя технической и эксплуатационной документации;
- наличие и четкость маркировки;
- отсутствие механических повреждений и дефектов покрытия, влияющих на работоспособность прибора.

Результат проверки положительный, если выполняются все вышеперечисленные требования. При оперативном устранении недостатков, замеченных при внешнем осмотре, поверка продолжается по следующим операциям.

##### 6.2 Опробование

6.2.1 Подключают калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MS6 (-R), меру электрического сопротивления многозначную MS 3071 и источник питания к соответствующим клеммам ИП (в зависимости от схемы подключения).

6.2.2 Генерируют с эталонного прибора значение соответствующего настроенному на преобразователе типу входного сигнала и лежащее в диапазоне измерений преобразователя.

6.2.3 После стабилизации показаний поверяемого преобразователя, снимают их при помощи калибратора многофункционального и коммуникатора BEAMEX MS6 (-R) или специализированного программно-аппаратного комплекса.

6.2.4 Преобразователь считается пригодным к дальнейшей поверке, если на дисплее считывающего прибора (или специализированного программно-аппаратного комплекса) индицируется значение выходного сигнала.

### 6.3 Определение основной погрешности

Определение основной погрешности ИП в режиме работы с термопреобразователями сопротивления и датчиками имеющими выходной сигнал в виде электрического сопротивления производить для 3-х или 4-х проводной схемы подключения.

6.3.1 *Определение основной абсолютной погрешности ИП в режиме измерения и преобразования аналоговых сигналов электрического сопротивления или напряжения постоянного тока в сигналы силы постоянного тока (от 4 до 20 мА).*

6.3.1.1 Погрешность определяют в пяти контрольных точках, находящихся внутри настроенного диапазона измерений, включая нижний и верхний пределы настроенного диапазона.

Устанавливают на ИП соответствующий режим измерения/преобразования сигналов.

6.3.1.2 Подключают меру электрического сопротивления многозначную МС 3071 или Калибратор многофункциональный Fluke 5720А, калибратор многофункциональный и коммуникатор ВЕАМЕХ МС6 (-R) или программно-аппаратный комплекс, и источник питания к соответствующим клеммам ИП (в зависимости от схемы подключения).

6.3.1.3 С эталонного прибора воспроизводят значение нормируемого сигнала, соответствующее первой контрольной точке.

6.3.1.4 После стабилизации показаний поверяемого ИП, снимают их при помощи калибратора многофункционального и коммуникатора ВЕАМЕХ МС6 (-R) или программно-аппаратного комплекса.

6.3.1.5 Повторяют операции по п.п. 6.3.1.3-6.3.1.4 для остальных контрольных точек.

6.3.1.6 Рассчитывают основную абсолютную погрешность ( $\Delta_{абс}$ , Ом или мВ) для каждой поверяемой точки по формуле 1:

$$\Delta_{абс} = X_{изм} - X_{э} \quad (1)$$

где:  $X_{э}$  – значение сигнала воспроизводимое эталонным прибором, Ом или мВ;

$X_{изм}$  – значение измеренного выходного сигнала, Ом или мВ;

или

– значение измеренного выходного сигнала (мА), в эквиваленте электрического сопротивления (Ом) или напряжения (мВ) постоянного тока, определяемое по формуле 2:

$$X_{изм} = X_{вх\max} + \frac{I_{изм} - I_{вх\min}}{I_{вх\max} - I_{вх\min}} \cdot (X_{вх\max} - X_{вх\min}) \quad (2)$$

где:  $X_{вх\max}$ ,  $X_{вх\min}$  – соответственно верхний и нижний пределы настроенного интервала входных сигналов поверяемого прибора, (Ом или мВ);

$I_{вх\max}$ ,  $I_{вх\min}$  – соответственно верхний и нижний пределы настроенного диапазона выходных сигналов поверяемого прибора, мА;

$I_{изм}$  – значение измеренного выходного сигнала, мА.

6.3.1.7 Полученные значения основной абсолютной погрешности во всех контрольных точках не должны превышать предельно допустимых значений, приведенных в описании типа.

6.3.2 *Определение основной абсолютной погрешности ИП в режиме работы с термопреобразователями сопротивления (ТС).*

6.3.2.1 Погрешность определяют в пяти контрольных точках, находящихся внутри настроенного диапазона измерений, включая нижний и верхний пределы настроенного диапазона.



Устанавливают на ИП соответствующий режим измерения/преобразования сигналов.

6.3.2.2 Подключают меру электрического сопротивления многозначную МС 3071, калибратор многофункциональный и коммуникатор ВЕАМЕХ МС6 (-R) или программно-аппаратный комплекс, и источник питания к соответствующим клеммам ИП (в зависимости от схемы подключения).

6.3.2.3 С эталонного прибора воспроизводят значение нормируемого сигнала, соответствующее первой контрольной точке (в соответствии с типом НСХ по ГОСТ 6651-2009 или Приложением Б к настоящей методике).

6.3.2.4 После стабилизации показаний поверяемого ИП, снимают их при помощи калибратора многофункционального и коммуникатора ВЕАМЕХ МС6 (-R) или программно-аппаратного комплекса.

6.3.2.5 Повторяют операции по п.п. 6.3.2.3-6.3.2.4 для остальных контрольных точек.

6.3.2.6 Рассчитывают основную абсолютную погрешность ( $\Delta_{абс}$ , °С) для каждой поверяемой точки по формуле 3:

$$\Delta_{абс} = X_{изм} - X_э \quad (3)$$

где:  $X_э$  – значение сигнала воспроизводимое эталонным прибором в температурном эквиваленте, °С;

$X_{изм}$  – значение измеренного выходного сигнала, °С;

или

– значение измеренного выходного сигнала (мА), в температурном эквиваленте (°С), определяемое по формуле 4:

$$X_{изм} = X_{вх\ min} + \frac{I_{изм} - I_{вых\ min}}{I_{вых\ max} - I_{вых\ min}} \cdot (X_{вх\ max} - X_{вх\ min}) \quad (4)$$

где:  $X_{вх\ max}$ ,  $X_{вх\ min}$  – соответственно верхний и нижний пределы настроенного интервала входных сигналов поверяемого прибора, °С;

$I_{вых\ max}$ ,  $I_{вых\ min}$  – соответственно верхний и нижний пределы настроенного диапазона выходных сигналов поверяемого прибора, мА;

$I_{изм}$  – значение измеренного выходного сигнала, мА.

6.3.2.7 Полученные значения основной абсолютной погрешности во всех контрольных точках не должны превышать предельно допустимых значений, приведенных в описании типа.

*6.3.3 Определение основной абсолютной погрешности ИП в режиме работы с термоэлектрическими преобразователями (ТП).*

Определение основной абсолютной погрешности ИП в режиме работы с термоэлектрическими преобразователями проводят с включенной автоматической компенсацией температуры свободных (холодных) концов термопары в режиме работы с ТП.

6.3.3.1 Погрешность определяют в пяти контрольных точках, находящихся внутри настроенного диапазона измерений, включая нижний и верхний пределы настроенного диапазона. Устанавливают на ИП соответствующий режим измерения/преобразования сигналов и включают схему компенсации холодного спая. Собирают схему согласно рисунку 2.

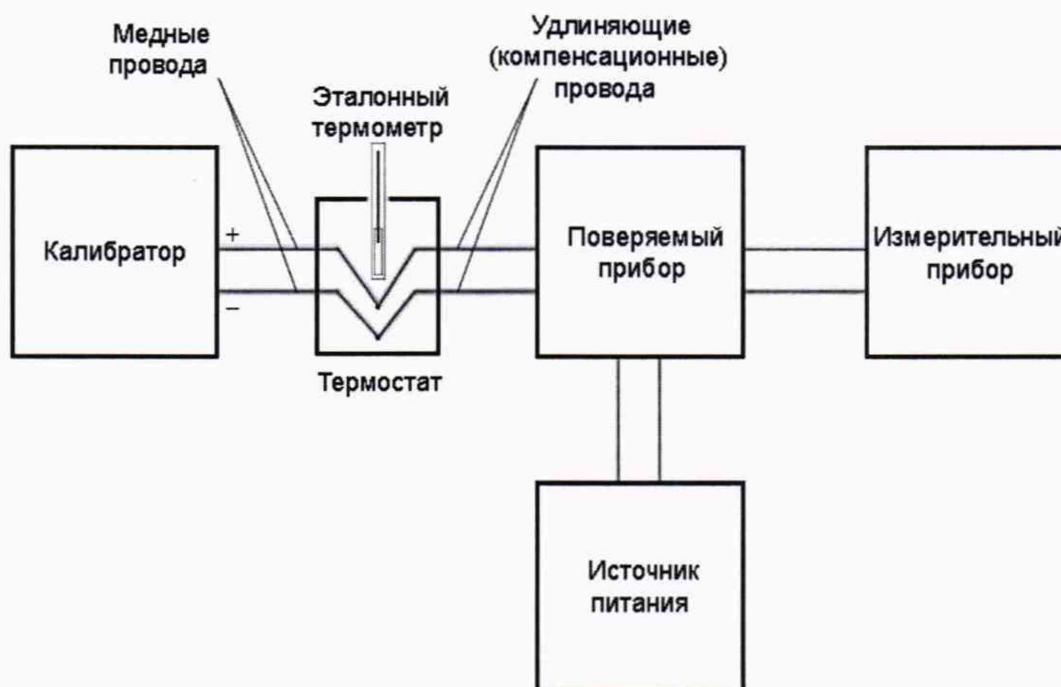


Рисунок 2

а) К поверяемому прибору подключают удлиняющие (компенсационные) провода по ГОСТ 1790-77, ГОСТ 1791-67 к ТП (в соответствии с требованиями по ГОСТ 8.338-2002). Тип компенсационных проводов должен соответствовать установленному типу НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001/МЭК 60584-1:2013 или Приложению В к настоящей методике. Концы удлиняющих проводов соединяют с медными проводами, скрутки проводов помещают в пробирки, заполненные трансформаторным маслом, а затем пробирки помещают в нулевой термостат (или сосуд Дьюара, заполненный льдо-водяной смесью). Температуру в сосуде Дьюара контролируют термометром с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более  $\pm 0,05$  °С.

б) Подключают медные провода к калибратору многофункциональному Fluke 5720А.

в) Подключают источник питания, а также калибратор многофункциональный и коммуникатор ВЕАМЕХ МС6 (-R) или программно-аппаратный комплекс к соответствующим клеммам поверяемого прибора.

6.3.3.2 С эталонного прибора воспроизводят значение нормируемого сигнала, соответствующее первой контрольной точке (в соответствии с типом НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001/МЭК 60584-1:2013 или Приложением В к настоящей методике).

6.3.3.3 После стабилизации показаний поверяемого ИП, снимают их при помощи калибратора многофункционального и коммуникатора ВЕАМЕХ МС6 (-R) или программно-аппаратного комплекса.

6.3.3.4 Повторяют операции по п.п. 6.3.3.2-6.3.3.3 для остальных контрольных точек.

6.3.3.5 Рассчитывают основную абсолютную погрешность для каждой поверяемой точки по п 6.3.2.6.

6.3.3.6 Полученные значения основной абсолютной погрешности во всех контрольных точках с учетом погрешности компенсации холодного спая не должны превышать предельно допустимых значений, приведенных в описании типа.




## 7 Оформление результатов поверки

7.1 Приборы, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются годными и допускаются к применению. На них оформляется свидетельство о поверке в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02 июля 2015 г. и (или) ставится знак поверки в паспорт и делается соответствующая запись в разделе «Свидетельство о поверке».


7.2 При отрицательных результатах поверки, в соответствии с Приказом № 1815 Минпромторга России от 02 июля 2015 г., оформляется извещение о непригодности.

Разработал:  
Научный сотрудник  
отдела метрологического  
обеспечения термометрии  
ФГУП «ВНИИМС»



Л.Д. Маркин

Начальник  
отдела метрологического  
обеспечения термометрии  
ФГУП «ВНИИМС»

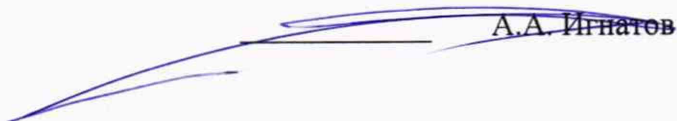

А.А. Игнатов

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (НСХ) ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ТИПОВ Ni10 – Ni10000 ( $\alpha=0,006180^{\circ}\text{C}^{-1}$ ) по DIN 43760

НСХ преобразования в пределах диапазона измерений рассчитывают по следующей формуле:

$$R_t = R_0(1 + 0,5485 \cdot 10^{-2} \cdot t + 0,665 \cdot 10^{-5} \cdot t^2 + 2,805 \cdot 10^{-11} \cdot t^4 + 2 \cdot 10^{-17} \cdot t^6)$$

где:

$R_0$  – значение сопротивления (Ом) при температуре 0 °С

$R_t$  – значение сопротивления (Ом) при температуре  $t$  (°С)

$t$  (°С) – значение температуры в диапазоне от

### НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (НСХ) ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ТИПА Ni100 ( $\alpha=0,006180^{\circ}\text{C}^{-1}$ ) в диапазоне измерений от -60 до 0 °С

°С	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
-60	69,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
-50	74,3	73,8	73,3	72,8	72,3	71,9	71,4	70,9	70,5	70,0
-40	79,1	78,6	78,1	77,7	77,2	76,7	76,2	75,7	75,2	74,7
-30	84,1	83,6	83,1	82,6	82,1	81,6	81,1	80,6	80,1	79,6
-20	89,3	88,8	88,3	87,7	87,2	86,7	86,2	85,7	85,2	84,7
-10	94,6	94,0	93,5	93,0	92,5	91,9	91,4	90,9	90,3	89,8
-0	100,0	99,5	98,9	98,4	97,8	97,3	96,7	96,2	95,7	95,1



**НОМИНАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (НСХ) ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ТИПА Ni100 ( $\alpha=0,006180^{\circ}\text{C}^{-1}$ ) в диапазоне измерений от 0 до 250 °С**

0	100,0	100,5	101,1	101,7	102,2	102,8	103,3	103,9	104,4	105,0
10	105,6	106,1	106,7	107,2	107,8	108,4	108,9	109,5	110,1	110,7
20	111,2	111,8	112,4	113,0	113,5	114,1	114,7	115,3	115,9	116,5
30	117,1	117,7	118,2	118,8	119,4	120,0	120,6	121,2	121,8	122,4
40	123,0	123,6	124,2	124,8	125,4	126,0	126,7	127,3	127,9	128,5
50	129,1	129,7	130,3	131,0	131,6	132,2	132,8	133,5	134,1	134,7
60	135,3	136,0	136,6	137,2	137,9	138,5	139,2	139,8	140,4	141,1
70	141,7	142,4	143,0	143,7	144,3	145,0	145,6	146,3	146,9	147,6
80	148,3	148,9	149,6	150,2	150,9	151,6	152,2	152,9	153,6	154,3
90	154,9	155,6	156,3	157,0	157,7	158,3	159,0	159,7	160,4	161,1
100	161,8	162,5	163,2	163,9	164,6	165,3	166,0	166,7	167,4	168,1
110	168,8	169,5	170,2	170,9	171,6	172,4	173,1	173,8	174,5	175,2
120	176,0	176,7	177,4	178,2	178,9	179,6	180,4	181,1	181,8	182,6
130	183,3	184,1	184,8	185,6	186,3	187,1	187,8	188,6	189,4	190,1
140	190,9	191,7	192,4	193,2	194,0	194,7	195,5	196,3	197,1	197,9
150	198,6	199,4	200,2	201,0	201,8	202,6	203,4	204,2	205,0	205,8
160	206,6	207,4	208,2	209,0	209,8	210,6	211,5	212,3	213,1	213,9
170	214,8	215,6	216,4	217,3	218,1	218,9	219,8	220,6	221,5	222,3
180	223,2	224,0	224,9	225,7	226,6	227,4	228,3	229,2	230,0	230,9
190	231,8	232,7	233,5	234,4	235,3	236,2	237,1	238,0	238,9	239,8
200	240,7	241,6	242,5	243,4	244,3	245,2	246,1	247,0	247,9	248,9
210	249,8	250,7	251,7	252,6	253,5	254,5	255,4	256,3	257,3	258,2
220	259,2	260,2	261,1	262,1	263,0	264,0	265,0	266,0	266,9	267,9
230	268,9	269,9	270,9	271,8	272,8	273,8	274,8	275,8	276,8	277,9
240	278,9	279,9	280,9	281,9	282,9	284,0	285,0	286,0	287,1	288,1
250	289,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**

**ЗНАЧЕНИЕ ТЭДС ДЛЯ ТЕРМОПАРЫ ТИПА L  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧИХ КОНЦОВ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СВОБОДНЫХ КОНЦОВ 0 °С  
ПО DIN 43710**

°С	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-200	-8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-190	-7,86	-7,89	-7,92	-7,95	-7,98	-8,00	-8,03	-8,06	-8,09	-8,12
-180	-7,56	-7,59	-7,62	-7,65	-7,68	-7,71	-7,74	-7,77	-7,80	-7,83
-170	-7,25	-7,28	-7,31	-7,34	-7,37	-7,40	-7,44	-7,47	-7,50	-7,53
-160	-6,93	-6,96	-6,99	-7,03	-7,06	-7,09	-7,12	-7,15	-7,19	-7,22
-150	-6,60	-6,63	-6,66	-6,70	-6,73	-6,76	-6,80	-6,83	-6,86	-6,90
-140	-6,26	-6,29	-6,33	-6,36	-6,39	-6,43	-6,46	-6,50	-6,53	-6,56
-130	-5,90	-5,93	-5,97	-6,01	-6,04	-6,08	-6,11	-6,15	-6,19	-6,22
-120	-5,53	-5,57	-5,60	-5,64	-5,68	-5,71	-5,75	-5,79	-5,82	-5,86
-110	-5,15	-5,19	-5,22	-5,26	-5,30	-5,34	-5,38	-5,41	-5,45	-5,49
-100	-4,75	-4,79	-4,83	-4,87	-4,91	-4,95	-4,99	-5,03	-5,07	-5,11
-90	-4,33	-4,37	-4,41	-4,45	-4,50	-4,54	-4,58	-4,62	-4,66	-4,71
-80	-3,89	-3,93	-3,98	-4,02	-4,06	-4,11	-4,15	-4,20	-4,24	-4,28
-70	-3,44	-3,48	-3,53	-3,57	-3,62	-3,66	-3,71	-3,75	-3,80	-3,84
-60	-2,98	-3,02	-3,07	-3,12	-3,16	-3,21	-3,25	-3,30	-3,35	-3,39
-50	-2,51	-2,56	-2,60	-2,65	-2,70	-2,74	-2,79	-2,84	-2,88	-2,93
-40	-2,03	-2,08	-2,12	-2,17	-2,22	-2,27	-2,32	-2,36	-2,41	-2,46
-30	-1,53	-1,58	-1,63	-1,68	-1,73	-1,78	-1,83	-1,88	-1,93	-1,98
-20	-1,02	-1,07	-1,12	-1,17	-1,22	-1,27	-1,32	-1,38	-1,43	-1,48
-10	-0,51	-0,56	-0,61	-0,66	-0,71	-0,76	-0,81	-0,87	-0,92	-0,97
-0	0,00	-0,05	-0,10	-0,15	-0,20	-0,25	-0,31	-0,36	-0,41	-0,46
0	0,00	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47
10	0,52	0,57	0,63	0,68	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	1,00
20	1,05	1,10	1,16	1,21	1,26	1,31	1,37	1,42	1,47	1,53
30	1,58	1,63	1,69	1,74	1,79	1,84	1,90	1,95	2,00	2,06
40	2,11	2,16	2,22	2,27	2,33	2,38	2,43	2,49	2,54	2,60
50	2,65	2,70	2,76	2,81	2,87	2,92	2,97	3,03	3,08	3,14
60	3,19	3,24	3,30	3,35	3,41	3,46	3,51	3,57	3,62	3,68
70	3,73	3,78	3,84	3,89	3,95	4,00	4,05	4,11	4,16	4,22
80	4,27	4,32	4,38	4,43	4,49	4,54	4,60	4,65	4,71	4,77
90	4,82	4,87	4,93	4,98	5,04	5,09	5,15	5,20	5,26	5,32
100	5,37	5,42	5,48	5,53	5,59	5,64	5,70	5,75	5,81	5,87
110	5,92	5,97	6,03	6,08	6,14	6,19	6,25	6,30	6,36	6,42
120	6,47	6,53	6,58	6,64	6,69	6,75	6,81	6,85	6,92	6,97
130	7,03	7,09	7,14	7,20	7,25	7,31	7,37	7,42	7,48	7,53
140	7,59	7,65	7,70	7,76	7,81	7,87	7,93	7,98	8,04	8,09
150	8,15	8,21	8,26	8,32	8,37	8,43	8,49	8,54	8,60	8,65
160	8,71	8,77	8,82	8,88	8,93	8,99	9,05	9,10	9,16	9,21
170	9,27	9,33	9,38	9,44	9,49	9,55	9,61	9,66	9,72	9,77
180	9,83	9,89	9,94	10,00	10,05	10,11	10,17	10,22	10,28	10,33
190	10,39	10,45	10,50	10,56	10,61	10,67	10,73	10,78	10,84	10,89
200	10,95	11,01	11,06	11,12	11,17	11,23	11,29	11,34	11,40	11,45



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11,51	11,57	11,62	11,68	11,73	11,79	11,85	11,90	11,96	12,01
220	12,07	12,13	12,18	12,24	12,29	12,35	12,41	12,46	12,52	12,57
230	12,63	12,69	12,74	12,80	12,85	12,91	12,97	13,02	13,08	13,13
240	13,19	13,25	13,30	13,36	13,41	13,47	13,53	13,58	13,64	13,69
250	13,75	13,81	13,86	13,92	13,97	14,03	14,09	14,14	14,20	14,25
260	14,31	14,37	14,42	14,48	14,54	14,59	14,65	14,71	14,76	14,82
270	14,88	14,94	14,99	15,05	15,10	15,16	15,22	15,27	15,33	15,38
280	15,44	15,50	15,55	15,61	15,66	15,72	15,78	15,83	15,89	15,94
290	16,00	16,06	16,11	16,17	16,22	16,28	16,34	16,39	16,45	16,50
300	16,56	16,62	16,67	16,73	16,78	16,84	16,90	16,95	17,01	17,06
310	17,12	17,18	17,23	17,29	17,34	17,40	17,46	17,51	17,57	17,62
320	17,68	17,74	17,79	17,85	17,90	17,96	18,02	18,07	18,13	18,18
330	18,24	18,30	18,35	18,41	18,46	18,52	18,58	18,63	18,69	18,74
340	18,80	18,86	18,91	18,97	19,02	19,08	19,14	19,19	19,25	19,30
350	19,36	19,42	19,47	19,53	19,58	19,64	19,70	19,75	19,81	19,85
360	19,92	19,98	20,03	20,09	20,14	20,20	20,26	20,31	20,37	20,42
370	20,48	20,54	20,59	20,65	20,70	20,76	20,82	20,87	20,93	20,98
380	21,04	21,10	21,15	21,21	21,26	21,32	21,38	21,43	21,49	21,54
390	21,60	21,66	21,71	21,77	21,82	21,88	21,94	21,99	22,05	22,10
400	22,16	22,22	22,27	22,33	22,38	22,44	22,50	22,55	22,61	22,66
410	22,72	22,78	22,83	22,89	22,95	23,00	23,06	23,12	23,18	23,23
420	23,29	23,35	23,40	23,46	23,52	23,57	23,63	23,69	23,74	23,80
430	23,86	23,92	23,97	24,03	24,09	24,14	24,20	24,26	24,32	24,37
440	24,43	24,49	24,54	24,60	24,66	24,71	24,77	24,83	24,89	24,94
450	25,00	25,06	25,11	25,17	25,23	25,28	25,34	25,40	25,46	25,51
460	25,57	25,63	25,68	25,74	25,80	25,85	25,91	25,97	26,03	26,08
470	26,14	26,20	26,25	26,31	26,37	26,42	26,48	26,54	26,60	26,65
480	26,71	26,77	26,82	26,88	26,94	26,99	27,05	27,11	27,17	27,22
490	27,28	27,34	27,39	27,45	27,51	27,56	27,62	27,68	27,74	27,79
500	27,85	27,91	27,97	28,02	28,08	28,14	28,20	28,26	28,31	28,37
510	28,43	28,49	28,55	28,60	28,66	28,72	28,78	28,84	28,89	28,95
520	29,01	29,07	29,13	29,18	29,24	29,30	29,36	29,42	29,47	29,53
530	29,59	29,65	29,71	29,76	29,82	29,88	29,94	30,00	30,05	30,11
540	30,17	30,23	30,29	30,34	30,40	30,46	30,52	30,58	30,63	30,69
550	30,75	30,81	30,87	30,92	30,98	31,04	31,10	31,16	31,21	31,27
560	31,33	31,39	31,45	31,50	31,56	31,62	31,68	31,74	31,79	31,85
570	31,91	31,97	32,03	32,08	32,14	32,20	32,26	32,32	32,37	32,43
580	32,49	32,55	32,61	32,66	32,72	32,78	32,84	32,90	32,96	33,02
590	33,08	33,14	33,20	33,26	33,32	33,38	33,43	33,49	33,55	33,61
600	33,67	33,73	33,79	33,85	33,91	33,97	34,02	34,08	34,14	34,20
610	34,26	34,32	34,38	34,44	34,50	34,56	34,61	34,67	34,73	34,79
620	34,85	34,91	34,97	35,03	35,09	35,15	35,20	35,26	35,32	35,38
630	35,44	35,50	35,56	35,62	35,68	35,74	35,80	35,86	35,92	35,98
640	36,04	36,10	36,16	36,22	36,28	36,34	36,40	36,46	36,52	36,58
650	36,64	36,10	36,76	36,82	36,88	36,95	37,01	37,07	37,13	37,19
660	37,25	37,30	37,36	37,42	37,48	37,55	37,61	37,67	37,73	37,79
670	37,85	37,91	37,97	38,04	38,10	38,16	38,22	38,28	38,35	38,41
680	38,47	38,53	38,59	38,66	38,72	38,78	38,84	38,90	38,97	39,03
690	39,09	39,15	39,22	39,28	39,34	39,41	39,47	39,53	39,59	39,66



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	39,72	39,78	39,85	39,91	39,97	40,04	40,10	40,16	40,22	40,29
710	40,35	40,41	40,48	40,54	40,60	40,67	40,73	40,80	40,86	40,93
720	40,98	41,04	41,11	41,17	41,23	41,30	41,36	41,43	41,49	41,56
730	41,62	41,69	41,75	41,82	41,88	41,95	42,01	42,08	42,14	42,21
740	42,27	42,34	42,40	42,47	42,53	42,60	42,66	42,73	42,79	42,86
750	42,92	42,99	43,05	43,12	43,18	43,25	43,31	43,38	43,44	43,51
760	43,57	43,64	43,70	43,77	43,83	43,90	43,97	44,03	44,10	44,16
770	44,23	44,30	44,36	44,43	44,49	44,56	44,63	44,69	44,76	44,82
780	44,89	44,96	45,02	45,09	45,15	45,22	45,29	45,35	45,42	45,48
790	45,55	45,62	45,68	45,75	45,82	45,89	45,95	46,02	46,09	46,15
800	46,22	46,29	46,35	46,42	46,49	46,56	46,62	46,69	46,76	46,82
810	46,89	46,96	47,03	47,09	47,16	47,23	47,30	47,37	47,43	47,50
820	47,57	47,64	47,71	47,77	47,84	47,91	47,98	48,05	48,11	48,18
830	48,25	48,32	48,39	48,46	48,53	48,60	48,66	48,73	48,80	48,87
840	48,94	49,01	49,08	49,15	49,22	49,29	49,35	49,42	49,49	49,56
850	49,63	49,70	49,77	49,84	49,91	49,98	50,04	50,11	50,18	50,25
860	50,32	50,39	50,46	50,53	50,60	50,67	50,74	50,81	50,88	50,95
870	51,02	51,09	51,16	51,23	51,30	51,37	51,44	51,51	51,58	51,65
880	51,72	51,79	51,86	51,93	52,00	52,08	52,15	52,22	52,29	52,36
890	52,43	52,50	52,57	52,64	52,71	52,79	52,86	52,93	53,00	53,07
900	53,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—



**ЗНАЧЕНИЕ ТЭДС ДЛЯ ТЕРМОПАРЫ ТИПА U (Cu-CuNi)  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧИХ КОНЦОВ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СВОБОДНЫХ КОНЦОВ 0 °С  
ПО DIN 43710**

°С	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
- 200	- 5,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 190	- 5,51	- 5,53	- 5,55	- 5,57	- 5,59	- 5,60	- 5,62	- 5,64	- 5,66	- 5,68	- 5,70
- 180	- 5,32	- 5,34	- 5,36	- 5,38	- 5,40	- 5,41	- 5,43	- 5,45	- 5,47	- 5,49	- 5,51
- 170	- 5,12	- 5,14	- 5,16	- 5,18	- 5,20	- 5,22	- 5,24	- 5,26	- 5,28	- 5,30	- 5,32
- 160	- 4,91	- 4,93	- 4,95	- 4,97	- 4,99	- 5,02	- 5,04	- 5,06	- 5,08	- 5,10	- 5,12
- 150	- 4,69	- 4,71	- 4,73	- 4,76	- 4,78	- 4,80	- 4,82	- 4,84	- 4,87	- 4,89	- 4,91
- 140	- 4,46	- 4,48	- 4,51	- 4,53	- 4,55	- 4,58	- 4,60	- 4,62	- 4,64	- 4,67	- 4,69
- 130	- 4,21	- 4,23	- 4,26	- 4,28	- 4,31	- 4,33	- 4,36	- 4,38	- 4,41	- 4,43	- 4,46
- 120	- 3,95	- 3,98	- 4,00	- 4,03	- 4,05	- 4,08	- 4,11	- 4,13	- 4,16	- 4,18	- 4,21
- 110	- 3,58	- 3,71	- 3,73	- 3,76	- 3,79	- 3,81	- 3,84	- 3,87	- 3,90	- 3,92	- 3,95
- 100	- 3,40	- 3,43	- 3,46	- 3,48	- 3,51	- 3,54	- 3,57	- 3,60	- 3,62	- 3,65	- 3,68
- 90	- 3,11	- 3,14	- 3,17	- 3,20	- 3,23	- 3,25	- 3,28	- 3,31	- 3,34	- 3,37	- 3,40
- 80	- 2,81	- 2,84	- 2,87	- 2,90	- 2,93	- 2,96	- 2,99	- 3,02	- 3,05	- 3,08	- 3,11
- 70	- 2,50	- 2,53	- 2,56	- 2,59	- 2,62	- 2,66	- 2,69	- 2,72	- 2,75	- 2,78	- 2,81
- 60	- 2,18	- 2,21	- 2,24	- 2,28	- 2,31	- 2,34	- 2,37	- 2,40	- 2,44	- 2,47	- 2,50
- 50	- 1,85	- 1,88	- 1,92	- 1,95	- 1,98	- 2,02	- 2,05	- 2,08	- 2,11	- 2,15	- 2,18
- 40	- 1,50	- 1,53	- 1,57	- 1,60	- 1,64	- 1,67	- 1,71	- 1,74	- 1,78	- 1,81	- 1,85
- 30	- 1,14	- 1,18	- 1,21	- 1,25	- 1,28	- 1,32	- 1,36	- 1,39	- 1,43	- 1,46	- 1,50
- 20	- 0,77	- 0,81	- 0,84	- 0,88	- 0,92	- 0,95	- 0,99	- 1,03	- 1,07	- 1,10	- 1,14
- 10	- 0,39	- 0,43	- 0,47	- 0,50	- 0,54	- 0,58	- 0,62	- 0,66	- 0,69	- 0,73	- 0,77
- 0	0,00	- 0,04	- 0,08	- 0,12	- 0,16	- 0,19	- 0,23	- 0,27	- 0,31	- 0,35	- 0,39
0	0,00	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
10	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80
20	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21
30	1,21	1,25	1,29	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,55	1,59	1,63
40	1,63	1,67	1,71	1,76	1,80	1,84	1,88	1,92	1,97	2,01	2,05
50	2,05	2,09	2,14	2,18	2,22	2,26	2,31	2,35	2,39	2,44	2,48
60	2,48	2,52	2,57	2,61	2,65	2,69	2,74	2,78	2,82	2,87	2,91
70	2,91	2,95	3,00	3,04	3,09	3,13	3,17	3,22	3,26	3,31	3,35
80	3,35	3,39	3,44	3,48	3,53	3,57	3,62	3,66	3,71	3,75	3,80
90	3,80	3,84	3,89	3,93	3,95	4,02	4,07	4,11	4,16	4,20	4,25
100	4,25	4,30	4,34	4,39	4,43	4,48	4,53	4,57	4,62	4,66	4,71
110	4,71	4,76	4,80	4,85	4,90	4,94	4,99	5,04	5,09	5,13	5,18
120	5,18	5,23	5,27	5,32	5,37	5,41	5,46	5,51	5,56	5,60	5,65
130	5,65	5,70	5,75	5,79	5,84	5,89	5,94	5,99	6,03	6,08	6,13
140	6,13	6,18	6,23	6,28	6,33	6,37	6,42	6,47	6,52	6,57	6,62
150	6,62	6,67	6,72	6,77	6,82	6,87	6,92	6,97	7,02	7,07	7,12
160	7,12	7,17	7,22	7,27	7,33	7,37	7,43	7,48	7,53	7,58	7,63
170	7,63	7,68	7,73	7,79	7,84	7,89	7,94	7,99	8,05	8,10	8,15
180	8,15	8,20	8,25	8,31	8,36	8,41	8,46	8,51	8,57	8,62	8,67
190	8,67	8,72	8,78	8,83	8,88	8,93	8,99	9,04	9,09	9,15	9,20
200	9,20	9,25	9,31	9,36	9,42	9,47	9,52	9,58	9,63	9,69	9,74



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
210	9,74	9,79	9,85	9,90	9,96	10,01	10,07	10,12	10,18	10,23	10,29
220	10,29	10,35	10,40	10,46	10,51	10,57	10,62	10,68	10,74	10,79	10,85
230	10,85	10,91	10,96	11,02	11,07	11,13	11,19	11,24	11,30	11,35	11,41
240	11,41	11,47	11,52	11,58	11,64	11,69	11,75	11,81	11,87	11,92	11,98
250	11,98	12,04	12,09	12,15	12,21	12,25	12,32	12,36	12,44	12,49	12,55
260	12,55	12,61	12,67	12,72	12,78	12,84	12,90	12,96	13,01	13,07	13,13
270	13,13	13,19	13,25	13,30	13,36	13,42	13,48	13,54	13,59	13,65	13,71
280	13,71	13,77	13,83	13,89	13,95	14,00	14,06	14,12	14,18	14,24	14,30
290	14,30	14,36	14,42	14,48	14,54	14,60	14,66	14,72	14,78	14,84	14,90
300	14,90	14,96	15,02	15,06	15,14	15,20	15,26	15,32	15,38	15,44	15,50
310	15,50	15,56	15,62	15,68	15,74	15,80	15,86	15,92	15,96	16,04	16,10
320	16,10	16,16	16,22	16,28	16,34	16,40	16,46	16,52	16,58	16,64	16,70
330	16,70	16,76	16,82	16,88	16,94	17,00	17,07	17,13	17,19	17,24	17,31
340	17,31	17,37	17,43	17,49	17,55	17,61	17,68	17,74	17,80	17,88	17,92
350	17,92	17,98	18,04	18,10	18,16	18,22	18,29	18,35	18,41	18,47	18,53
360	18,53	18,59	18,65	18,71	18,77	18,83	18,89	18,96	19,02	19,08	19,14
370	19,14	19,20	19,26	19,33	19,39	19,45	19,51	19,57	19,64	19,70	19,76
380	19,76	19,82	19,89	19,95	20,01	20,07	20,13	20,19	20,26	20,32	20,38
390	20,38	20,44	20,50	20,57	20,63	20,69	20,75	20,81	20,88	20,94	21,00
400	21,00	21,06	21,12	21,19	21,25	21,31	21,37	21,43	21,50	21,56	21,62
410	21,62	21,68	21,75	21,81	21,87	21,93	22,00	22,06	22,12	22,19	22,25
420	22,25	22,31	22,38	22,44	22,50	22,56	22,63	22,69	22,75	22,82	22,88
430	22,88	22,94	23,01	23,07	23,13	23,19	23,26	23,32	23,38	23,45	23,51
440	23,51	23,57	23,64	23,70	23,77	23,83	23,89	23,96	24,02	24,09	24,15
450	24,15	24,21	24,28	24,34	24,41	24,47	24,53	24,60	24,66	24,73	24,79
460	24,79	24,85	24,92	24,98	25,05	25,11	25,18	25,24	25,31	25,37	25,44
470	25,44	25,50	25,57	25,63	25,70	25,76	25,83	25,89	25,95	26,02	26,09
480	26,09	26,16	26,22	26,29	26,35	26,42	26,49	26,55	26,62	26,68	26,75
490	26,75	26,82	26,88	26,95	27,01	27,08	27,15	27,21	27,28	27,34	27,41
500	27,41	27,48	27,54	27,61	27,68	27,74	27,81	27,88	27,95	28,01	28,08
510	28,08	28,15	28,21	28,28	28,35	28,41	28,48	28,55	28,62	28,68	28,75
520	28,75	28,82	28,89	28,95	29,02	29,09	29,16	29,23	29,29	29,36	29,43
530	29,43	29,50	29,57	29,63	29,70	29,77	29,84	29,91	29,97	30,04	30,11
540	30,11	30,18	30,25	30,32	30,39	30,45	30,52	30,59	30,68	30,73	30,80
550	30,80	30,87	30,94	31,01	31,08	31,14	31,21	31,28	31,35	31,42	31,49
560	31,49	31,56	31,63	31,70	31,77	31,84	31,91	31,98	32,05	32,12	32,19
570	32,19	32,26	32,33	32,40	32,47	32,54	32,61	32,68	32,75	32,82	32,89
580	32,89	32,96	33,03	33,10	33,17	33,24	33,32	33,39	33,46	33,53	33,60
590	33,60	33,67	33,74	33,81	33,88	33,95	34,03	34,10	34,17	34,24	34,31
600	34,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



**ЗНАЧЕНИЕ ТЭДС ДЛЯ ТЕРМОПАРЫ ТИПА W3 (W3Re/W25Re)  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧИХ КОНЦОВ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СВОБОДНЫХ КОНЦОВ 0 °С  
ПО ASTM E696-07**

°С	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
0	0,000	0,010	0,019	0,029	0,039	0,048	0,058	0,068	0,078	0,088	0,098
10	0,098	0,108	0,118	0,128	0,138	0,148	0,159	0,169	0,179	0,189	0,200
20	0,200	0,210	0,221	0,231	0,242	0,252	0,263	0,273	0,284	0,295	0,305
30	0,305	0,316	0,327	0,338	0,349	0,360	0,371	0,382	0,393	0,404	0,415
40	0,415	0,426	0,437	0,448	0,460	0,471	0,482	0,494	0,505	0,517	0,528
50	0,528	0,540	0,551	0,563	0,574	0,586	0,598	0,609	0,621	0,633	0,645
60	0,645	0,657	0,668	0,680	0,692	0,704	0,716	0,728	0,741	0,753	0,765
70	0,765	0,777	0,789	0,802	0,814	0,826	0,839	0,851	0,863	0,876	0,888
80	0,888	0,901	0,914	0,926	0,939	0,951	0,964	0,977	0,990	1,002	1,015
90	1,015	1,028	1,041	1,054	1,067	1,080	1,093	1,106	1,119	1,132	1,145
100	1,145	1,158	1,172	1,185	1,198	1,212	1,225	1,238	1,252	1,265	1,278
110	1,278	1,292	1,305	1,319	1,333	1,346	1,360	1,374	1,387	1,401	1,415
120	1,415	1,428	1,442	1,456	1,470	1,484	1,498	1,512	1,526	1,540	1,554
130	1,554	1,568	1,582	1,596	1,610	1,624	1,639	1,653	1,667	1,681	1,696
140	1,696	1,710	1,725	1,739	1,753	1,768	1,782	1,797	1,811	1,826	1,841
150	1,841	1,855	1,870	1,884	1,899	1,914	1,929	1,943	1,958	1,973	1,988
160	1,988	2,003	2,018	2,033	2,048	2,063	2,078	2,093	2,108	2,123	2,138
170	2,138	2,153	2,168	2,183	2,199	2,214	2,229	2,244	2,260	2,275	2,290
180	2,290	2,306	2,321	2,337	2,352	2,368	2,383	2,399	2,414	2,430	2,445
190	2,445	2,461	2,477	2,492	2,508	2,524	2,539	2,555	2,571	2,587	2,603
200	2,603	2,618	2,634	2,650	2,666	2,682	2,698	2,714	2,730	2,746	2,762
210	2,762	2,778	2,794	2,810	2,826	2,843	2,859	2,875	2,891	2,907	2,924
220	2,924	2,940	2,956	2,973	2,989	3,005	3,022	3,038	3,055	3,071	3,088
230	3,088	3,104	3,121	3,137	3,154	3,170	3,187	3,203	3,220	3,237	3,253
240	3,253	3,270	3,287	3,303	3,320	3,337	3,354	3,371	3,387	3,404	3,421
250	3,421	3,438	3,455	3,472	3,489	3,506	3,523	3,540	3,557	3,574	3,591
260	3,591	3,608	3,625	3,642	3,659	3,676	3,693	3,711	3,728	3,745	3,762
270	3,762	3,780	3,797	3,814	3,831	3,849	3,866	3,883	3,901	3,918	3,936
280	3,936	3,953	3,970	3,988	4,005	4,023	4,040	4,058	4,075	4,093	4,111
290	4,111	4,128	4,146	4,163	4,181	4,199	4,216	4,234	4,252	4,269	4,287
300	4,287	4,305	4,323	4,340	4,358	4,376	4,394	4,412	4,430	4,447	4,465
310	4,465	4,483	4,501	4,519	4,537	4,555	4,573	4,591	4,609	4,627	4,645
320	4,645	4,663	4,681	4,699	4,717	4,735	4,753	4,772	4,790	4,808	4,826
330	4,826	4,844	4,862	4,881	4,899	4,917	4,935	4,954	4,972	4,990	5,009
340	5,009	5,027	5,045	5,064	5,082	5,100	5,119	5,137	5,156	5,174	5,192
350	5,192	5,211	5,229	5,248	5,266	5,285	5,303	5,322	5,340	5,359	5,378
360	5,378	5,396	5,415	5,433	5,452	5,471	5,489	5,508	5,527	5,545	5,564



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
370	5,564	5,583	5,601	5,620	5,639	5,658	5,676	5,695	5,714	5,733	5,752
380	5,752	5,770	5,789	5,808	5,827	5,846	5,865	5,884	5,902	5,921	5,940
390	5,940	5,959	5,978	5,997	6,016	6,035	6,054	6,073	6,092	6,111	6,130
400	6,130	6,149	6,168	6,187	6,206	6,225	6,245	6,264	6,283	6,302	6,321
410	6,321	6,340	6,359	6,378	6,398	6,417	6,436	6,455	6,474	6,494	6,513
420	6,513	6,532	6,551	6,571	6,590	6,609	6,628	6,648	6,667	6,686	6,706
430	6,706	6,725	6,744	6,764	6,783	6,802	6,822	6,841	6,861	6,880	6,899
440	6,899	6,919	6,938	6,958	6,977	6,997	7,016	7,035	7,055	7,074	7,094
450	7,094	7,113	7,133	7,152	7,172	7,191	7,211	7,231	7,250	7,270	7,289
460	7,289	7,309	7,328	7,348	7,368	7,387	7,407	7,427	7,446	7,466	7,485
470	7,485	7,505	7,525	7,544	7,564	7,584	7,604	7,623	7,643	7,663	7,682
480	7,682	7,702	7,722	7,742	7,761	7,781	7,801	7,821	7,840	7,860	7,880
490	7,880	7,900	7,920	7,939	7,959	7,979	7,999	8,019	8,038	8,058	8,078
500	8,078	8,098	8,118	8,138	8,158	8,178	8,197	8,217	8,237	8,257	8,277
510	8,277	8,297	8,317	8,337	8,357	8,377	8,397	8,417	8,437	8,457	8,476
520	8,476	8,496	8,516	8,536	8,556	8,576	8,596	8,616	8,636	8,656	8,676
530	8,676	8,696	8,717	8,737	8,757	8,777	8,797	8,817	8,837	8,857	8,877
540	8,877	8,897	8,917	8,937	8,957	8,977	8,997	9,018	9,038	9,058	9,078
550	9,078	9,098	9,118	9,138	9,158	9,178	9,199	9,219	9,239	9,259	9,279
560	9,279	9,299	9,320	9,340	9,360	9,380	9,400	9,420	9,441	9,461	9,481
570	9,481	9,501	9,521	9,542	9,562	9,582	9,602	9,622	9,643	9,663	9,683
580	9,683	9,703	9,723	9,744	9,764	9,784	9,804	9,825	9,845	9,865	9,885
590	9,885	9,906	9,926	9,946	9,966	9,987	10,007	10,027	10,048	10,068	10,088
600	10,088	10,108	10,129	10,149	10,169	10,190	10,210	10,230	10,250	10,271	10,291
610	10,291	10,311	10,332	10,352	10,372	10,393	10,413	10,433	10,454	10,474	10,494
620	10,494	10,515	10,535	10,555	10,576	10,596	10,616	10,637	10,657	10,677	10,698
630	10,698	10,718	10,738	10,759	10,779	10,799	10,820	10,840	10,860	10,881	10,901
640	10,901	10,921	10,942	10,962	10,983	11,003	11,023	11,044	11,064	11,084	11,105
650	11,105	11,125	11,146	11,166	11,186	11,207	11,227	11,247	11,268	11,288	11,309
660	11,309	11,329	11,349	11,370	11,390	11,410	11,431	11,451	11,472	11,492	11,512
670	11,512	11,533	11,553	11,574	11,594	11,614	11,635	11,655	11,676	11,696	11,716
680	11,716	11,737	11,757	11,778	11,798	11,818	11,839	11,859	11,880	11,900	11,921
690	11,921	11,941	11,961	11,982	12,002	12,023	12,043	12,063	12,084	12,104	12,125
700	12,125	12,145	12,165	12,186	12,206	12,227	12,247	12,268	12,288	12,308	12,329
710	12,329	12,349	12,370	12,390	12,410	12,431	12,451	12,472	12,492	12,513	12,533
720	12,533	12,553	12,574	12,594	12,615	12,635	12,656	12,676	12,696	12,717	12,737
730	12,737	12,758	12,778	12,799	12,819	12,840	12,860	12,880	12,901	12,921	12,942
740	12,942	12,962	12,983	13,003	13,023	13,044	13,064	13,085	13,105	13,126	13,146
750	13,146	13,167	13,187	13,207	13,228	13,248	13,269	13,289	13,310	13,330	13,351
760	13,351	13,371	13,392	13,412	13,433	13,453	13,473	13,494	13,514	13,535	13,555
770	13,555	13,576	13,596	13,617	13,637	13,658	13,678	13,699	13,719	13,740	13,760
780	13,760	13,781	13,801	13,822	13,842	13,863	13,883	13,904	13,924	13,945	13,965



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
790	13,965	13,986	14,006	14,027	14,047	14,068	14,088	14,109	14,129	14,150	14,170
800	14,170	14,191	14,211	14,232	14,252	14,273	14,293	14,314	14,334	14,355	14,375
810	14,375	14,395	14,416	14,436	14,457	14,477	14,498	14,518	14,539	14,559	14,580
820	14,580	14,600	14,621	14,641	14,662	14,682	14,703	14,723	14,744	14,764	14,784
830	14,784	14,805	14,825	14,846	14,866	14,887	14,907	14,928	14,948	14,969	14,989
840	14,989	15,009	15,030	15,050	15,071	15,091	15,112	15,132	15,152	15,173	15,193
850	15,193	15,214	15,234	15,255	15,275	15,295	15,316	15,336	15,357	15,377	15,398
860	15,398	15,418	15,438	15,459	15,479	15,500	15,520	15,540	15,561	15,581	15,602
870	15,602	15,622	15,642	15,663	15,683	15,703	15,724	15,744	15,765	15,785	15,805
880	15,805	15,826	15,846	15,866	15,887	15,907	15,928	15,948	15,968	15,989	16,009
890	16,009	16,029	16,050	16,070	16,090	16,111	16,131	16,151	16,172	16,192	16,212
900	16,212	16,233	16,253	16,273	16,294	16,314	16,334	16,354	16,375	16,395	16,415
910	16,415	16,436	16,456	16,476	16,497	16,517	16,537	16,557	16,578	16,598	16,618
920	16,618	16,638	16,659	16,679	16,699	16,720	16,740	16,760	16,780	16,801	16,821
930	16,821	16,841	16,861	16,881	16,902	16,922	16,942	16,962	16,983	17,003	17,023
940	17,023	17,043	17,063	17,084	17,104	17,124	17,144	17,164	17,185	17,205	17,225
950	17,225	17,245	17,265	17,285	17,306	17,326	17,346	17,366	17,386	17,406	17,427
960	17,427	17,447	17,467	17,487	17,507	17,527	17,547	17,568	17,588	17,608	17,628
970	17,628	17,648	17,668	17,688	17,708	17,728	17,748	17,769	17,789	17,809	17,829
980	17,829	17,849	17,869	17,889	17,909	17,929	17,949	17,969	17,989	18,009	18,029
990	18,029	18,049	18,069	18,090	18,110	18,130	18,150	18,170	18,190	18,210	18,230
1000	18,230	18,250	18,270	18,290	18,310	18,330	18,350	18,370	18,390	18,410	18,430
1010	18,430	18,450	18,469	18,489	18,509	18,529	18,549	18,569	18,589	18,609	18,629
1020	18,629	18,649	18,669	18,689	18,709	18,729	18,749	18,768	18,788	18,808	18,828
1030	18,828	18,848	18,868	18,888	18,908	18,928	18,947	18,967	18,987	19,007	19,027
1040	19,027	19,047	19,067	19,086	19,106	19,126	19,146	19,166	19,186	19,205	19,225
1050	19,225	19,245	19,265	19,285	19,304	19,324	19,344	19,364	19,384	19,403	19,423
1060	19,423	19,443	19,463	19,482	19,502	19,522	19,542	19,561	19,581	19,601	19,621
1070	19,621	19,640	19,660	19,680	19,700	19,719	19,739	19,759	19,778	19,798	19,818
1080	19,818	19,837	19,857	19,877	19,896	19,916	19,936	19,955	19,975	19,995	20,014
1090	20,014	20,034	20,054	20,073	20,093	20,113	20,132	20,152	20,171	20,191	20,211
1100	20,211	20,230	20,250	20,269	20,289	20,309	20,328	20,348	20,367	20,387	20,406
1110	20,406	20,426	20,446	20,465	20,485	20,504	20,524	20,543	20,563	20,582	20,602
1120	20,602	20,621	20,641	20,660	20,680	20,699	20,719	20,738	20,758	20,777	20,797
1130	20,797	20,816	20,836	20,855	20,875	20,894	20,914	20,933	20,952	20,972	20,991
1140	20,991	21,011	21,030	21,050	21,069	21,088	21,108	21,127	21,147	21,166	21,185
1150	21,185	21,205	21,224	21,243	21,263	21,282	21,301	21,321	21,340	21,360	21,379
1160	21,379	21,398	21,418	21,437	21,456	21,475	21,495	21,514	21,533	21,553	21,572
1170	21,572	21,591	21,611	21,630	21,649	21,668	21,688	21,707	21,726	21,745	21,765
1180	21,765	21,784	21,803	21,822	21,842	21,861	21,880	21,899	21,918	21,938	21,957
1190	21,957	21,976	21,995	22,014	22,034	22,053	22,072	22,091	22,110	22,129	22,149



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
1200	22,149	22,168	22,187	22,206	22,225	22,244	22,263	22,283	22,302	22,321	22,340
1210	22,340	22,359	22,378	22,397	22,416	22,435	22,454	22,473	22,493	22,512	22,531
1220	22,531	22,550	22,569	22,588	22,607	22,626	22,645	22,664	22,683	22,702	22,721
1230	22,721	22,740	22,759	22,778	22,797	22,816	22,835	22,854	22,873	22,892	22,911
1240	22,911	22,930	22,949	22,968	22,987	23,006	23,024	23,043	23,062	23,081	23,100
1250	23,100	23,119	23,138	23,157	23,176	23,195	23,214	23,232	23,251	23,270	23,289
1260	23,289	23,308	23,327	23,346	23,364	23,383	23,402	23,421	23,440	23,459	23,477
1270	23,477	23,496	23,515	23,534	23,553	23,571	23,590	23,609	23,628	23,647	23,665
1280	23,665	23,684	23,703	23,722	23,740	23,759	23,778	23,797	23,815	23,834	23,853
1290	23,853	23,871	23,890	23,909	23,928	23,946	23,965	23,984	24,002	24,021	24,040
1300	24,040	24,058	24,077	24,096	24,114	24,133	24,152	24,170	24,189	24,208	24,226
1310	24,226	24,245	24,263	24,282	24,301	24,319	24,338	24,356	24,375	24,394	24,412
1320	24,412	24,431	24,449	24,468	24,486	24,505	24,523	24,542	24,561	24,579	24,598
1330	24,598	24,616	24,635	24,653	24,672	24,690	24,709	24,727	24,746	24,764	24,783
1340	24,783	24,801	24,820	24,838	24,856	24,875	24,893	24,912	24,930	24,949	24,967
1350	24,967	24,985	25,004	25,022	25,041	25,059	25,078	25,096	25,114	25,133	25,151
1360	25,151	25,169	25,188	25,206	25,224	25,243	25,261	25,280	25,298	25,316	25,335
1370	25,335	25,353	25,371	25,389	25,408	25,426	25,444	25,463	25,481	25,499	25,517
1380	25,517	25,536	25,554	25,572	25,591	25,609	25,627	25,645	25,664	25,682	25,700
1390	25,700	25,718	25,736	25,755	25,773	25,791	25,809	25,827	25,846	25,864	25,882
1400	25,882	25,900	25,918	25,936	25,955	25,973	25,991	26,009	26,027	26,045	26,063
1410	26,063	26,082	26,100	26,118	26,136	26,154	26,172	26,190	26,208	26,226	26,244
1420	26,244	26,262	26,281	26,299	26,317	26,335	26,353	26,371	26,389	26,407	26,425
1430	26,425	26,443	26,461	26,479	26,497	26,515	26,533	26,551	26,569	26,587	26,605
1440	26,605	26,623	26,641	26,659	26,677	26,695	26,712	26,730	26,748	26,766	26,784
1450	26,784	26,802	26,820	26,838	26,856	26,874	26,892	26,909	26,927	26,945	26,963
1460	26,963	26,981	26,999	27,017	27,035	27,052	27,070	27,088	27,106	27,124	27,141
1470	27,141	27,159	27,177	27,195	27,213	27,230	27,248	27,266	27,284	27,302	27,319
1480	27,319	27,337	27,355	27,373	27,390	27,408	27,426	27,444	27,461	27,479	27,497
1490	27,497	27,514	27,532	27,550	27,567	27,585	27,603	27,621	27,638	27,656	27,673
1500	27,673	27,691	27,709	27,726	27,744	27,762	27,779	27,797	27,815	27,832	27,850
1510	27,850	27,867	27,885	27,903	27,920	27,938	27,955	27,973	27,990	28,008	28,026
1520	28,026	28,043	28,061	28,078	28,096	28,113	28,131	28,148	28,166	28,183	28,201
1530	28,201	28,218	28,236	28,253	28,271	28,288	28,306	28,323	28,341	28,358	28,375
1540	28,375	28,393	28,410	28,428	28,445	28,463	28,480	28,497	28,515	28,532	28,550
1550	28,550	28,567	28,584	28,602	28,619	28,636	28,654	28,671	28,688	28,706	28,723
1560	28,723	28,740	28,758	28,775	28,792	28,810	28,827	28,844	28,862	28,879	28,896
1570	28,896	28,913	28,931	28,948	28,965	28,982	29,000	29,017	29,034	29,051	29,069
1580	29,069	29,086	29,103	29,120	29,137	29,155	29,172	29,189	29,206	29,223	29,241
1590	29,241	29,258	29,275	29,292	29,309	29,326	29,343	29,361	29,378	29,395	29,412
1600	29,412	29,429	29,446	29,463	29,480	29,497	29,514	29,532	29,549	29,566	29,583



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
1610	29,583	29,600	29,617	29,634	29,651	29,668	29,685	29,702	29,719	29,736	29,753
1620	29,753	29,770	29,787	29,804	29,821	29,838	29,855	29,872	29,889	29,906	29,923
1630	29,923	29,939	29,956	29,973	29,990	30,007	30,024	30,041	30,058	30,075	30,092
1640	30,092	30,108	30,125	30,142	30,159	30,176	30,193	30,210	30,226	30,243	30,260
1650	30,260	30,277	30,294	30,311	30,327	30,344	30,361	30,378	30,394	30,411	30,428
1660	30,428	30,445	30,461	30,478	30,495	30,512	30,528	30,545	30,562	30,579	30,595
1670	30,595	30,612	30,629	30,645	30,662	30,679	30,695	30,712	30,729	30,745	30,762
1680	30,762	30,779	30,795	30,812	30,828	30,845	30,862	30,878	30,895	30,911	30,928
1690	30,928	30,944	30,961	30,978	30,994	31,011	31,027	31,044	31,060	31,077	31,093
1700	31,093	31,110	31,126	31,143	31,159	31,176	31,192	31,209	31,225	31,242	31,258
1710	31,258	31,275	31,291	31,307	31,324	31,340	31,357	31,373	31,389	31,406	31,422
1720	31,422	31,439	31,455	31,471	31,488	31,504	31,520	31,537	31,553	31,569	31,586
1730	31,586	31,602	31,618	31,635	31,651	31,667	31,684	31,700	31,716	31,732	31,749
1740	31,749	31,765	31,781	31,797	31,814	31,830	31,846	31,862	31,878	31,895	31,911
1750	31,911	31,927	31,943	31,959	31,976	31,992	32,008	32,024	32,040	32,056	32,072
1760	32,072	32,088	32,105	32,121	32,137	32,153	32,169	32,185	32,201	32,217	32,233
1770	32,233	32,249	32,265	32,281	32,297	32,313	32,329	32,345	32,361	32,377	32,393
1780	32,393	32,409	32,425	32,441	32,457	32,473	32,489	32,505	32,521	32,537	32,553
1790	32,553	32,569	32,585	32,600	32,616	32,632	32,648	32,664	32,680	32,696	32,712
1800	32,712	32,727	32,743	32,759	32,775	32,791	32,806	32,822	32,838	32,854	32,870
1810	32,870	32,885	32,901	32,917	32,933	32,948	32,964	32,980	32,995	33,011	33,027
1820	33,027	33,042	33,058	33,074	33,090	33,105	33,121	33,136	33,152	33,168	33,183
1830	33,183	33,199	33,215	33,230	33,246	33,261	33,277	33,292	33,308	33,324	33,339
1840	33,339	33,355	33,370	33,386	33,401	33,417	33,432	33,448	33,463	33,479	33,494
1850	33,494	33,510	33,525	33,540	33,556	33,571	33,587	33,602	33,618	33,633	33,648
1860	33,648	33,664	33,679	33,694	33,710	33,725	33,741	33,756	33,771	33,786	33,802
1870	33,802	33,817	33,832	33,848	33,863	33,878	33,893	33,909	33,924	33,939	33,954
1880	33,954	33,970	33,985	34,000	34,015	34,030	34,046	34,061	34,076	34,091	34,106
1890	34,106	34,121	34,136	34,152	34,167	34,182	34,197	34,212	34,227	34,242	34,257
1900	34,257	34,272	34,287	34,302	34,317	34,332	34,347	34,362	34,377	34,392	34,407
1910	34,407	34,422	34,437	34,452	34,467	34,482	34,497	34,512	34,527	34,542	34,556
1920	34,556	34,571	34,586	34,601	34,616	34,631	34,646	34,660	34,675	34,690	34,705
1930	34,705	34,720	34,734	34,749	34,764	34,779	34,793	34,808	34,823	34,838	34,852
1940	34,852	34,867	34,882	34,896	34,911	34,926	34,940	34,955	34,970	34,984	34,999
1950	34,999	35,013	35,028	35,043	35,057	35,072	35,086	35,101	35,115	35,130	35,144
1960	35,144	35,159	35,173	35,188	35,202	35,217	35,231	35,246	35,260	35,275	35,289
1970	35,289	35,303	35,318	35,332	35,347	35,361	35,375	35,390	35,404	35,418	35,433
1980	35,433	35,447	35,461	35,476	35,490	35,504	35,518	35,533	35,547	35,561	35,575
1990	35,575	35,590	35,604	35,618	35,632	35,646	35,660	35,675	35,689	35,703	35,717
2000	35,717	35,731	35,745	35,759	35,773	35,787	35,801	35,816	35,830	35,844	35,858
2010	35,858	35,872	35,886	35,900	35,914	35,927	35,941	35,955	35,969	35,983	35,997
2020	35,997	36,011	36,025	36,039	36,053	36,067	36,080	36,094	36,108	36,122	36,136



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
2030	36,136	36,149	36,163	36,177	36,191	36,204	36,218	36,232	36,246	36,259	36,273
2040	36,273	36,287	36,300	36,314	36,328	36,341	36,355	36,368	36,382	36,396	36,409
2050	36,409	36,423	36,436	36,450	36,463	36,477	36,490	36,504	36,517	36,531	36,544
2060	36,544	36,558	36,571	36,585	36,598	36,611	36,625	36,638	36,652	36,665	36,678
2070	36,678	36,692	36,705	36,718	36,731	36,745	36,758	36,771	36,784	36,798	36,811
2080	36,811	36,824	36,837	36,850	36,864	36,877	36,890	36,903	36,916	36,929	36,942
2090	36,942	36,955	36,969	36,982	36,995	37,008	37,021	37,034	37,047	37,060	37,073
2100	37,073	37,086	37,099	37,111	37,124	37,137	37,150	37,163	37,176	37,189	37,202
2110	37,202	37,214	37,227	37,240	37,253	37,266	37,278	37,291	37,304	37,317	37,329
2120	37,329	37,342	37,355	37,367	37,380	37,393	37,405	37,418	37,430	37,443	37,456
2130	37,456	37,468	37,481	37,493	37,506	37,518	37,531	37,543	37,556	37,568	37,580
2140	37,580	37,593	37,605	37,618	37,630	37,642	37,655	37,667	37,679	37,692	37,704
2150	37,704	37,716	37,729	37,741	37,753	37,765	37,777	37,790	37,802	37,814	37,826
2160	37,826	37,838	37,850	37,862	37,875	37,887	37,899	37,911	37,923	37,935	37,947
2170	37,947	37,959	37,971	37,983	37,995	38,006	38,018	38,030	38,042	38,054	38,066
2180	38,066	38,078	38,089	38,101	38,113	38,125	38,137	38,148	38,160	38,172	38,183
2190	38,183	38,195	38,207	38,218	38,230	38,242	38,253	38,265	38,276	38,288	38,299
2200	38,299	38,311	38,323	38,334	38,345	38,357	38,368	38,380	38,391	38,403	38,414
2210	38,414	38,425	38,437	38,448	38,459	38,471	38,482	38,493	38,504	38,515	38,527
2220	38,527	38,538	38,549	38,560	38,571	38,582	38,594	38,605	38,616	38,627	38,638
2230	38,638	38,649	38,660	38,671	38,682	38,693	38,704	38,715	38,725	38,736	38,747
2240	38,747	38,758	38,769	38,780	38,790	38,801	38,812	38,823	38,833	38,844	38,855
2250	38,855	38,865	38,876	38,887	38,897	38,908	38,918	38,929	38,940	38,950	38,961
2260	38,961	38,971	38,982	38,992	39,002	39,013	39,023	39,034	39,044	39,054	39,065
2270	39,065	39,075	39,085	39,095	39,106	39,116	39,126	39,136	39,146	39,157	39,167
2280	39,167	39,177	39,187	39,197	39,207	39,217	39,227	39,237	39,247	39,257	39,267
2290	39,267	39,277	39,287	39,296	39,306	39,316	39,326	39,336	39,345	39,355	39,365
2300	39,365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



**ЗНАЧЕНИЕ ТЭДС ДЛЯ ТЕРМОПАРЫ ТИПА W5 (W5Re/W26Re)  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧИХ КОНЦОВ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СВОБОДНЫХ КОНЦОВ 0 °С  
ПО ASTM E696-07**

°С	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
0	0,000	0,013	0,027	0,040	0,054	0,067	0,081	0,094	0,108	0,121	0,135
10	0,135	0,149	0,162	0,176	0,190	0,204	0,217	0,231	0,245	0,259	0,273
20	0,273	0,286	0,300	0,314	0,328	0,342	0,356	0,370	0,384	0,398	0,412
30	0,412	0,426	0,441	0,455	0,469	0,483	0,497	0,512	0,526	0,540	0,554
40	0,554	0,569	0,583	0,598	0,612	0,626	0,641	0,655	0,670	0,684	0,699
50	0,699	0,713	0,728	0,742	0,757	0,772	0,786	0,801	0,816	0,830	0,845
60	0,845	0,860	0,875	0,889	0,904	0,919	0,934	0,949	0,964	0,979	0,994
70	0,994	1,009	1,024	1,039	1,054	1,069	1,084	1,099	1,114	1,129	1,144
80	1,144	1,159	1,175	1,190	1,205	1,220	1,235	1,251	1,266	1,281	1,297
90	1,297	1,312	1,327	1,343	1,358	1,374	1,389	1,405	1,420	1,436	1,451
100	1,451	1,467	1,482	1,498	1,513	1,529	1,545	1,560	1,576	1,592	1,607
110	1,607	1,623	1,639	1,655	1,670	1,686	1,702	1,718	1,734	1,750	1,766
120	1,766	1,781	1,797	1,813	1,829	1,845	1,861	1,877	1,893	1,909	1,925
130	1,925	1,942	1,958	1,974	1,990	2,006	2,022	2,038	2,055	2,071	2,087
140	2,087	2,103	2,120	2,136	2,152	2,168	2,185	2,201	2,217	2,234	2,250
150	2,250	2,267	2,283	2,300	2,316	2,332	2,349	2,365	2,382	2,398	2,415
160	2,415	2,432	2,448	2,465	2,481	2,498	2,515	2,531	2,548	2,565	2,581
170	2,581	2,598	2,615	2,632	2,648	2,665	2,682	2,699	2,716	2,732	2,749
180	2,749	2,766	2,783	2,800	2,817	2,843	2,851	2,868	2,885	2,902	2,919
190	2,919	2,936	2,953	2,970	2,987	3,004	3,021	3,038	3,055	3,072	3,089
200	3,089	3,106	3,124	3,141	3,158	3,175	3,192	3,210	3,227	3,244	3,261
210	3,261	3,279	3,296	3,313	3,331	3,348	3,365	3,383	3,400	3,417	3,435
220	3,435	3,452	3,470	3,487	3,505	3,522	3,539	3,557	3,574	3,592	3,609
230	3,609	3,627	3,645	3,662	3,680	3,697	3,715	3,732	3,750	3,768	3,785
240	3,785	3,803	3,821	3,838	3,856	3,874	3,891	3,909	3,927	3,945	3,962
250	3,962	3,980	3,998	4,016	4,034	4,051	4,069	4,087	4,105	4,123	4,141
260	4,141	4,158	4,176	4,194	4,212	4,230	4,248	4,266	4,284	4,302	4,320
270	4,320	4,338	4,356	4,374	4,392	4,410	4,428	4,446	4,464	4,482	4,500
280	4,500	4,518	4,536	4,554	4,573	4,591	4,609	4,627	4,645	4,663	4,682
290	4,682	4,700	4,718	4,736	4,754	4,773	4,791	4,809	4,827	4,846	4,864
300	4,864	4,882	4,900	4,919	4,937	4,955	4,974	4,992	5,010	5,029	5,047
310	5,047	5,065	5,084	5,102	5,121	5,139	5,157	5,176	5,194	5,213	5,231
320	5,231	5,250	5,268	5,287	5,305	5,323	5,342	5,361	5,379	5,398	5,416
330	5,416	5,435	5,453	5,472	5,490	5,509	5,527	5,546	5,565	5,583	5,602
340	5,602	5,620	5,639	5,658	5,676	5,695	5,714	5,732	5,751	5,770	5,788
350	5,788	5,807	5,826	5,844	5,863	5,882	5,901	5,919	5,938	5,957	5,976
360	5,976	5,994	6,013	6,032	6,051	6,070	6,088	6,107	6,126	6,145	6,164



° C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
370	6,164	6,182	6,201	6,220	6,239	6,258	6,277	6,296	6,314	6,333	6,352
380	6,352	6,371	6,390	6,409	6,428	6,447	6,466	6,485	6,504	6,523	6,541
390	6,541	6,560	6,579	6,598	6,617	6,636	6,655	6,674	6,693	6,712	6,731
400	6,731	6,750	6,769	6,788	6,807	6,826	6,845	6,865	6,884	6,903	6,922
410	6,922	6,941	6,960	6,979	6,998	7,017	7,036	7,055	7,074	7,094	7,113
420	7,113	7,132	7,151	7,170	7,189	7,208	7,227	7,247	7,266	7,285	7,304
430	7,304	7,323	7,342	7,362	7,381	7,400	7,419	7,438	7,458	7,477	7,496
440	7,496	7,515	7,534	7,554	7,573	7,592	7,611	7,631	7,650	7,669	7,688
450	7,688	7,708	7,727	7,746	7,765	7,785	7,804	7,823	7,842	7,862	7,881
460	7,881	7,900	7,920	7,939	7,958	7,978	7,997	8,016	8,036	8,055	8,074
470	8,074	8,094	8,113	8,132	8,152	8,171	8,190	8,210	8,229	8,248	8,268
480	8,268	8,287	8,306	8,326	8,345	8,364	8,384	8,403	8,423	8,442	8,461
490	8,461	8,481	8,500	8,520	8,539	8,558	8,578	8,597	8,617	8,636	8,655
500	8,655	8,675	8,694	8,714	8,733	8,753	8,772	8,791	8,811	8,830	8,850
510	8,850	8,869	8,889	8,908	8,928	8,947	8,966	8,986	9,005	9,025	9,044
520	9,044	9,064	9,083	9,103	9,122	9,142	9,161	9,181	9,200	9,220	9,239
530	9,239	9,259	9,278	9,298	9,317	9,337	9,356	9,376	9,395	9,415	9,434
540	9,434	9,454	9,473	9,493	9,512	9,532	9,551	9,571	9,590	9,610	9,629
550	9,629	9,649	9,668	9,688	9,707	9,727	9,746	9,766	9,785	9,805	9,824
560	9,824	9,844	9,863	9,883	9,902	9,922	9,942	9,961	9,981	10,000	10,020
570	10,020	10,039	10,059	10,078	10,098	10,117	10,137	10,156	10,176	10,196	10,215
580	10,215	10,235	10,254	10,274	10,293	10,313	10,332	10,352	10,371	10,391	10,411
590	10,411	10,430	10,450	10,469	10,489	10,508	10,528	10,547	10,567	10,587	10,606
600	10,606	10,626	10,645	10,665	10,684	10,704	10,723	10,743	10,763	10,782	10,802
610	10,802	10,821	10,841	10,860	10,880	10,899	10,919	10,939	10,958	10,978	10,997
620	10,997	11,017	11,036	11,056	11,075	11,095	11,114	11,134	11,154	11,173	11,193
630	11,193	11,212	11,232	11,251	11,271	11,290	11,310	11,330	11,349	11,369	11,388
640	11,388	11,408	11,427	11,447	11,466	11,486	11,505	11,525	11,544	11,564	11,584
650	11,584	11,603	11,623	11,642	11,662	11,681	11,701	11,720	11,740	11,759	11,779
660	11,779	11,798	11,818	11,837	11,857	11,876	11,896	11,915	11,935	11,955	11,974
670	11,974	11,994	12,013	12,033	12,052	12,072	12,091	12,111	12,130	12,150	12,169
680	12,169	12,189	12,208	12,228	12,247	12,267	12,286	12,306	12,325	12,345	13,364
690	13,364	12,384	12,403	12,422	12,442	12,461	12,481	12,500	12,520	12,539	12,559
700	12,559	12,578	12,598	12,617	12,637	12,656	12,676	12,695	12,715	12,734	12,753
710	12,753	12,773	12,792	12,812	12,831	12,851	12,870	12,890	12,909	12,928	12,948
720	12,948	12,967	12,987	13,006	13,026	13,045	13,064	13,084	13,103	13,123	13,142
730	13,142	13,161	13,181	13,200	13,220	13,239	13,258	13,278	13,297	13,317	13,336
740	13,336	13,355	13,375	13,394	13,413	13,433	13,452	13,472	13,491	13,510	13,530
750	13,530	13,549	13,568	13,588	13,607	13,626	13,646	13,665	13,685	13,704	13,723
760	13,723	13,743	13,762	13,781	13,800	13,820	13,839	13,858	13,878	13,897	13,916
770	13,916	13,936	13,955	13,974	13,994	14,013	14,032	14,051	14,071	14,090	14,109
780	14,109	14,129	14,148	14,167	14,186	14,206	14,225	14,244	14,263	14,283	14,302



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
790	14,302	14,321	14,340	14,360	14,379	14,398	14,417	14,437	14,456	14,475	14,494
800	14,494	14,513	14,533	14,552	14,571	14,590	14,609	14,629	14,648	14,667	14,686
810	14,686	14,705	14,725	14,744	14,763	14,782	14,801	14,820	14,840	14,859	14,878
820	14,878	14,897	14,916	14,935	14,954	14,974	14,993	15,012	15,031	15,050	15,069
830	15,069	15,088	15,107	15,126	15,146	15,165	15,184	15,203	15,222	15,241	15,260
840	15,260	15,279	15,298	15,317	15,336	15,355	15,374	15,393	15,413	15,432	15,451
850	15,451	15,470	15,489	15,508	15,527	15,546	15,565	15,584	15,603	15,622	15,641
860	15,641	15,660	15,679	15,698	15,717	15,736	15,755	15,774	15,793	15,812	15,831
870	15,831	15,849	15,868	15,887	15,906	15,925	15,944	15,963	15,982	16,001	16,020
880	16,020	16,039	16,058	16,077	16,096	16,114	16,133	16,152	16,171	16,190	16,209
890	16,209	16,228	16,247	16,265	16,284	16,303	16,322	16,341	16,360	16,379	16,397
900	16,397	16,416	16,435	16,454	16,473	16,491	16,510	16,529	16,548	16,567	16,585
910	16,585	16,604	16,623	16,642	16,661	16,679	16,698	16,717	16,736	16,754	16,773
920	16,773	16,792	16,811	16,829	16,848	16,867	16,886	16,904	16,923	16,942	16,960
930	16,960	16,979	16,998	17,016	17,035	17,054	17,072	17,091	17,110	17,128	17,147
940	17,147	17,166	17,184	17,203	17,222	17,240	17,259	17,278	17,296	17,315	17,333
950	17,333	17,352	17,371	17,389	17,408	17,426	17,445	17,463	17,482	17,501	17,519
960	17,519	17,538	17,556	17,575	17,593	17,612	17,630	17,649	17,667	17,686	17,704
970	17,704	17,723	17,741	17,760	17,778	17,797	17,815	17,834	17,852	17,871	17,889
980	17,889	17,908	17,926	17,945	17,963	17,981	18,000	18,018	18,037	18,055	18,074
990	18,074	18,092	18,110	18,129	18,147	18,166	18,184	18,202	18,221	18,239	18,257
1000	18,257	18,276	18,294	18,312	18,331	18,349	18,367	18,386	18,404	18,422	18,441
1010	18,441	18,459	18,477	18,496	18,514	18,532	18,550	18,569	18,587	18,605	18,623
1020	18,623	18,642	18,660	18,678	18,696	18,715	18,733	18,751	18,769	18,788	18,806
1030	18,806	18,824	18,842	18,860	18,878	18,897	18,915	18,933	18,951	18,969	18,987
1040	18,987	19,006	19,024	19,042	19,060	19,078	19,096	19,114	19,132	19,151	19,169
1050	19,169	19,187	19,205	19,223	19,241	19,259	19,277	19,295	19,313	19,331	19,349
1060	19,349	19,367	19,385	19,403	19,421	19,439	19,457	19,475	19,493	19,511	19,529
1070	19,529	19,547	19,565	19,583	19,601	19,619	19,637	19,655	19,673	19,691	19,709
1080	19,709	19,727	19,745	19,763	19,781	19,799	19,816	19,834	19,852	19,870	19,888
1090	19,888	19,906	19,924	19,942	19,959	19,977	19,995	20,013	20,031	20,049	20,066
1100	20,066	20,084	20,102	20,120	20,138	20,155	20,173	20,191	20,209	20,227	20,244
1110	20,244	20,262	20,280	20,298	20,315	20,333	20,351	20,369	20,386	20,404	20,422
1120	20,422	20,439	20,457	20,475	20,492	20,510	20,528	20,546	20,563	20,581	20,598
1130	20,598	20,616	20,634	20,651	20,669	20,687	20,704	20,722	20,739	20,757	20,775
1140	20,775	20,792	20,810	20,827	20,845	20,863	20,880	20,898	20,915	20,933	20,950
1150	20,950	20,968	20,985	21,003	21,020	21,038	21,055	21,073	21,090	21,108	21,125
1160	21,125	21,143	21,160	21,178	21,195	21,213	21,230	21,248	21,265	21,282	21,300
1170	21,300	21,317	21,335	21,352	21,369	21,387	21,404	21,422	21,439	21,456	21,474
1180	21,474	21,491	21,508	21,526	21,543	21,560	21,578	21,595	21,612	21,630	21,647
1190	21,647	21,664	21,682	21,699	21,716	21,733	21,751	21,768	21,785	21,802	21,820
1200	21,820	21,837	21,854	21,871	21,889	21,906	21,923	21,940	21,957	21,975	21,992



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
1210	21,992	22,009	22,026	22,043	22,061	22,078	22,095	22,112	22,129	22,146	22,163
1220	22,163	22,180	22,198	22,215	22,232	22,249	22,266	22,283	22,300	22,317	22,334
1230	22,334	22,351	22,368	22,385	22,403	22,420	22,437	2,454	22,471	22,488	22,505
1240	22,505	22,522	22,539	22,556	22,573	22,590	22,607	22,624	22,641	22,657	22,674
1250	22,674	22,691	22,708	22,725	22,742	22,759	22,776	22,793	22,810	22,827	22,844
1260	22,844	22,860	22,877	22,894	22,911	22,928	22,945	22,962	22,978	22,995	23,012
1270	23,012	23,029	23,046	23,063	23,079	23,096	23,113	23,130	23,147	23,163	23,180
1280	23,180	23,197	23,214	23,230	23,247	23,264	23,281	23,297	23,314	23,331	23,347
1290	23,347	23,364	23,381	23,398	23,414	23,431	23,448	23,464	23,481	23,498	23,514
1300	23,514	23,531	23,548	23,564	23,581	23,597	23,614	23,631	23,647	23,664	23,680
1310	23,680	23,697	23,714	23,730	23,747	23,763	23,780	23,796	23,813	23,829	23,846
1320	23,846	23,862	23,879	23,895	23,912	23,928	23,945	23,961	23,978	23,994	24,011
1330	24,011	24,027	24,044	24,060	24,077	24,093	24,110	24,126	24,142	24,159	24,175
1340	24,175	24,192	24,208	24,224	24,241	24,257	24,274	24,290	24,306	24,323	24,339
1350	24,339	24,355	24,372	24,388	24,404	24,421	24,437	24,453	24,470	24,486	24,502
1360	24,502	24,518	24,535	24,551	24,567	24,583	24,600	24,616	24,632	24,648	24,665
1370	24,665	24,681	24,697	24,713	24,730	24,746	24,762	24,778	24,794	24,810	24,827
1380	24,827	24,843	24,859	24,875	24,891	24,907	24,923	24,940	24,956	24,972	24,988
1390	24,988	25,004	25,020	25,036	25,052	25,068	25,084	25,100	25,117	25,133	25,149
1400	25,149	25,165	25,181	25,197	25,213	25,229	25,245	25,261	25,277	25,293	25,309
1410	25,309	25,325	25,341	25,357	25,373	25,389	25,405	25,420	25,436	25,452	25,468
1420	25,468	25,484	25,500	25,516	25,532	25,548	25,564	25,580	25,595	25,611	25,627
1430	25,627	25,643	25,659	25,675	25,691	25,706	25,722	25,738	25,754	25,770	25,785
1440	25,785	25,801	25,817	25,833	25,849	25,864	25,880	25,896	25,912	25,927	25,943
1450	25,943	25,959	25,975	25,990	26,006	26,022	26,038	26,053	26,069	26,085	26,100
1460	26,100	26,116	26,132	26,147	26,163	26,179	26,194	26,210	26,226	26,241	26,257
1470	26,257	26,272	26,288	26,304	26,319	26,335	26,350	26,366	26,382	26,397	26,413
1480	26,413	26,428	26,444	26,459	26,475	26,490	26,506	26,521	26,537	26,552	26,568
1490	26,568	26,583	26,599	26,614	26,630	26,645	26,661	26,676	26,692	26,707	26,723
1500	26,723	26,738	26,753	26,769	26,784	26,800	26,815	26,830	26,846	26,861	26,877
1510	26,877	26,892	26,907	26,923	26,938	26,953	26,969	26,984	26,999	27,15	27,030
1520	27,030	27,045	27,061	27,076	27,091	27,107	27,122	27,137	27,152	27,168	27,183
1530	27,183	27,198	27,213	27,229	27,244	27,259	27,274	27,290	27,305	27,320	27,335
1540	27,335	27,350	27,366	27,381	27,396	27,411	27,426	27,441	27,457	27,472	27,487
1550	27,487	27,502	27,517	27,532	27,547	27,562	27,578	27,593	27,608	27,623	27,638
1560	27,638	27,653	27,668	27,683	27,698	27,713	27,728	27,743	27,758	27,773	27,788
1570	27,788	27,803	27,818	27,833	27,848	27,863	27,878	27,893	27,908	27,923	27,938
1580	27,938	27,953	27,968	27,983	27,998	28,013	28,028	28,043	28,058	28,072	28,087
1590	28,087	28,102	28,117	28,132	28,147	28,162	28,177	28,191	28,206	28,221	28,236
1600	28,236	28,251	28,266	28,280	28,295	28,310	28,325	28,340	28,354	28,369	28,384
1610	28,384	28,399	28,413	28,428	28,443	28,458	28,472	28,487	28,502	28,517	28,531
1620	28,531	28,546	28,561	28,575	28,590	28,605	28,619	28,634	28,649	28,663	28,678



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
1630	28,678	28,693	28,707	28,722	28,737	28,751	28,766	28,780	28,795	28,810	28,824
1640	28,824	28,839	28,853	28,868	28,883	28,897	28,912	28,926	28,941	28,955	28,970
1650	28,970	28,984	28,999	29,013	29,028	29,042	29,057	29,071	29,086	29,100	29,115
1660	29,115	29,129	29,144	29,158	29,173	29,187	29,201	29,216	29,230	29,245	29,259
1670	29,259	29,274	29,288	29,302	29,317	29,331	29,345	29,360	29,374	29,388	29,403
1680	29,403	29,417	29,431	29,446	29,460	29,474	29,489	29,503	29,517	29,532	29,546
1690	29,546	29,560	29,574	29,589	29,603	29,617	29,631	29,646	29,660	29,674	29,688
1700	29,688	29,703	29,717	29,731	29,745	29,759	29,774	29,788	29,802	29,816	29,830
1710	29,830	29,844	29,859	29,873	29,887	29,901	29,915	29,929	29,943	29,957	29,971
1720	29,971	29,986	30,000	30,014	30,028	30,042	30,056	30,070	30,084	30,098	30,112
1730	30,112	30,126	30,140	30,154	30,168	30,182	30,196	30,210	30,224	30,238	30,252
1740	30,252	30,266	30,280	30,294	30,308	30,322	30,336	30,350	30,364	30,378	30,391
1750	30,391	30,405	30,419	30,433	30,447	30,461	30,475	30,489	30,502	30,516	30,530
1760	30,530	30,544	30,558	30,572	30,585	30,599	30,613	30,627	30,641	30,654	30,668
1770	30,668	30,682	30,696	30,710	30,723	30,737	30,751	30,765	30,778	30,792	30,806
1780	30,806	30,819	30,833	30,847	30,861	30,874	30,888	30,902	30,915	30,929	30,943
1790	30,943	30,956	30,970	30,983	30,997	31,011	31,024	31,038	31,052	31,065	31,079
1800	31,079	31,092	31,106	31,119	31,133	31,147	31,160	31,174	31,187	31,201	31,214
1810	31,214	31,228	31,241	31,255	31,268	31,282	31,295	31,309	31,322	31,336	31,349
1820	31,349	31,363	31,376	31,389	31,403	31,416	31,430	31,443	31,457	31,470	31,483
1830	31,483	31,497	31,510	31,524	31,537	31,550	31,564	31,577	31,590	31,604	31,617
1840	31,617	31,630	31,644	31,657	31,670	31,683	31,697	31,710	31,723	31,737	31,750
1850	31,750	31,763	31,776	31,790	31,803	31,816	31,829	31,842	31,856	31,869	31,882
1860	31,882	31,895	31,908	31,922	31,935	31,948	31,961	31,974	31,987	32,001	32,014
1870	32,014	32,027	32,040	32,053	32,066	32,079	32,092	32,105	32,118	32,132	32,145
1880	32,145	31,158	32,171	32,184	32,197	32,210	32,223	32,236	32,249	32,262	32,275
1890	32,275	32,288	32,301	32,314	32,327	32,340	32,353	32,366	32,378	32,391	32,404
1900	32,404	32,417	32,430	32,443	32,456	32,469	32,482	32,495	32,507	32,520	32,533
1910	32,533	32,546	32,559	32,572	32,584	32,597	32,610	32,623	32,636	32,649	32,661
1920	32,661	32,674	32,687	32,700	32,712	32,725	32,738	32,751	32,763	32,776	32,789
1930	32,789	32,801	32,814	32,827	32,840	32,852	32,865	32,878	32,890	32,903	32,915
1940	32,915	32,928	32,941	32,953	32,966	32,979	32,991	33,004	33,016	33,029	33,041
1950	33,041	33,054	33,067	33,079	33,092	33,104	33,117	33,129	33,142	33,154	33,167
1960	33,167	33,179	33,192	33,204	33,217	33,229	33,242	33,254	33,266	33,279	33,291
1970	33,291	33,304	33,316	33,329	33,341	33,353	33,366	33,378	33,390	33,403	33,415
1980	33,415	33,427	33,440	33,452	33,464	33,477	33,489	33,501	33,514	33,526	33,538
1990	33,538	33,550	33,563	33,575	33,587	33,599	33,612	33,624	33,636	33,648	33,660
2000	33,660	33,673	33,685	33,697	33,709	33,721	33,733	33,746	33,758	33,770	33,782
2010	33,782	33,794	33,806	33,818	33,830	33,842	33,855	33,867	33,879	33,891	33,903
2020	33,903	33,915	33,927	33,939	33,951	33,963	33,975	33,987	33,999	34,011	34,023
2030	34,023	34,035	34,047	34,059	34,071	34,082	34,094	34,106	34,118	34,130	34,142
2040	34,142	34,154	34,166	34,178	34,189	34,201	34,213	34,225	34,237	34,249	34,260



°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Милливольт											
2050	34,260	34,272	34,284	34,296	34,307	34,319	34,331	34,343	34,354	34,366	34,378
2060	34,378	34,390	34,401	34,413	34,425	34,436	34,448	34,460	34,471	34,483	34,495
2070	34,495	34,506	34,518	34,530	34,541	34,553	34,564	34,576	34,587	34,599	34,611
2080	34,611	34,622	34,634	34,645	34,657	34,668	34,680	34,691	34,703	34,714	34,726
2090	34,726	34,737	34,749	34,760	34,771	34,783	34,794	34,806	34,817	34,829	34,840
2100	34,840	34,851	34,863	34,874	34,885	34,897	34,908	34,919	34,931	34,942	34,953
2110	34,953	34,965	34,976	34,987	34,998	35,010	35,021	35,032	35,043	35,055	35,066
2120	35,066	35,077	35,088	35,099	35,110	35,122	35,133	35,144	35,155	35,166	35,177
2130	35,177	35,188	35,199	35,211	35,222	35,233	35,244	35,255	35,266	35,277	35,288
2140	35,288	35,299	35,310	35,321	35,332	35,343	35,354	35,365	35,376	35,387	35,398
2150	35,398	35,409	35,420	35,430	35,441	34,452	35,463	35,474	35,485	35,496	35,506
2160	35,506	35,517	35,528	35,539	35,550	35,561	35,571	35,582	35,593	35,604	35,614
2170	35,614	35,625	35,636	35,647	35,657	35,668	35,679	35,689	35,700	35,711	35,721
2180	35,721	35,732	35,742	35,753	35,764	35,774	35,785	35,795	35,806	35,817	35,827
2190	35,827	35,838	35,848	35,859	35,869	35,880	35,890	35,901	35,911	35,922	35,932
2200	35,932	35,942	35,953	35,963	35,974	35,984	35,995	36,005	36,015	36,026	36,036
2210	36,036	36,046	36,057	36,067	36,077	36,088	36,098	36,108	36,118	36,129	36,139
2220	36,139	36,149	36,159	36,169	36,180	36,190	36,200	36,210	36,220	36,231	36,241
2230	36,241	36,251	36,261	36,271	36,281	36,291	36,301	36,311	36,321	36,331	36,341
2240	36,341	36,351	36,361	36,371	36,381	36,391	36,401	36,411	36,421	36,431	36,441
2250	36,441	36,451	36,461	36,471	36,481	36,491	36,500	36,510	36,520	36,530	36,540
2260	36,540	36,549	36,559	36,569	36,579	36,589	36,598	36,608	36,618	36,627	36,637
2270	36,637	36,647	36,656	36,666	36,676	36,685	36,695	36,705	36,714	36,724	36,733
2280	36,733	36,743	36,753	36,762	36,772	36,781	36,791	36,800	36,810	36,819	36,829
2290	36,829	36,838	36,847	36,857	36,866	36,876	36,885	36,895	36,904	36,913	36,923
2300	36,923	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—