

СОГЛАСОВАНО

**Технический директор
ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»**

 **М. С. Казаков**



09 **2022 г.**

Государственная система обеспечения единства измерений

Нагрузки электронные программируемые IT8900

Методика поверки

МП-НИЦЭ-136-22

г. Москва

2022 г.

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ.....	3
4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	4
5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ.....	4
6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	5
7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.....	5
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	6
11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.....	6
12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	10

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на нагрузки электронные программируемые IT8900 (далее – нагрузки), изготавливаемые ITECH ELECTRONIC CO., LTD., Китай, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость нагрузки к гэт4-91 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 октября 2018 года № 2091 (далее – Приказ № 2091), к гэт13-01 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 года № 3457 (далее – Приказ № 3457).

1.3 Поверка нагрузки должна проводиться в соответствии с требованиями настоящей методики поверки.

1.4 Методы, обеспечивающие реализацию методики поверки, – косвенный метод измерений, прямой метод измерений.

1.5 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в Приложении А.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки	Наименование операции	Необходимость выполнения при	
		первичной поверке	периодической поверке
7	Внешний осмотр средства измерений	Да	Да
8	Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да
9	Проверка программного обеспечения средства измерений	Да	Да
10	Определение метрологических характеристик средства измерений	Да	Да
10.1	Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока	Да	Да
10.2	Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока	Да	Да
10.3	Определение абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока	Да	Да
10.4	Определение абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока	Да	Да
10.5	Определение абсолютной погрешности установки силы постоянного тока	Да	Да
10.6	Определение абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока	Да	Да
11	Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды плюс (25 ± 5) °С;
- относительная влажность от 30 до 80 %.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые нагрузки и средства поверки.

4.2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованиям, изложенным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 года № 707 (ред. от 30.12.2020 года) «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

Таблица 2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки	Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) и (или) метрологические или основные технические характеристики средства поверки
Основные средства поверки		
р. 10	Диапазон измерений напряжения постоянного тока от 0 до 1000 В включ., пределы допускаемой относительной погрешности измерений $\pm 0,016$ %. Диапазон измерений напряжения постоянного тока св. 1000 до 1200 В, пределы допускаемой относительной погрешности измерений $\pm 0,508$ %. Диапазон измерений силы постоянного тока от 0 до 200 А включ., пределы допускаемой относительной погрешности измерений $\pm 0,05$ %. Диапазон измерений силы постоянного тока св. 200 до 1000 А, пределы допускаемой относительной погрешности измерений $\pm 0,35$ %.	Мультиметры 3458А, рег. № 25900-03. Делитель постоянного напряжения высоковольтный ДН-055, рег. № 10740-86. Шунт токовый АКПП-7501, рег. № 49121-12. Шунты измерительные стационарные с ограниченной взаимозаменяемостью 75 ШИСВ.1, рег. № 24112-02
Вспомогательные средства поверки		
р. 10	Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока от 0 до 1200 В. Диапазон воспроизведений силы постоянного тока от 0 до 1000 А.	Вспомогательный источник питания постоянного тока
р. 8	Диапазон измерений температуры окружающей среды от +20 до +30 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 1 °С, диапазон измерений относительной влажности от 30 до 80 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 3 %	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М», рег. № 32014-11

Допускается применение средств поверки с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений, установленную Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 октября 2018 года № 2091, Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 года № 3457.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Также должны быть соблюдены требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на поверяемые нагрузки и применяемые средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Нагрузка допускается к дальнейшей поверке, если:

- внешний вид нагрузки соответствует описанию и изображению, приведенному в описании типа;
- соблюдаются требования по защите нагрузки от несанкционированного вмешательства согласно описанию типа;
- отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки.

Примечание – При выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устранения до проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, выявленные дефекты устраняются, и нагрузка допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возможности устранения дефектов, нагрузка к дальнейшей поверке не допускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- изучить эксплуатационную документацию на поверяемую нагрузку и на применяемые средства поверки;
- выдержать нагрузку в условиях окружающей среды, указанных в п. 3.1, не менее 2 ч, если она находилась в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 3.1, и подготовить ее к работе в соответствии с ее эксплуатационной документацией;
- подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации;
- провести контроль условий поверки на соответствие требованиям, указанным в разделе 3, с помощью оборудования, указанного в таблице 2.

8.2 Опробование

Опробование нагрузки проводить в следующей последовательности:

- 1) включить нагрузки согласно с эксплуатационной документацией (далее – ЭД);
- 2) убедиться, что на цифровом индикаторе нагрузки загорелись цифры со значениями силы тока и напряжения.

Нагрузка допускается к дальнейшей поверке, если при опробовании выполняются все вышеуказанные требования

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Проверку программного обеспечения проводить в следующей последовательности:

- 1) включить нагрузку в соответствии с ЭД;

2) После включения считать с дисплея номер версии программного обеспечения (далее – ПО);

3) сравнить номер версии ПО, считанные с дисплея нагрузки после ее загрузки, с номером версии ПО, указанным в описании типа;

Нагрузка допускается к дальнейшей поверке, если программное обеспечение соответствует требованиям, указанным в описании типа.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока

Определение абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного проводить при помощи мультиметра 3458А и вспомогательного источника питания постоянного тока (далее – источник), делителя постоянного напряжения высоковольтный ДН-055 (далее – делитель) в следующей последовательности:

1) собрать схему, приведенную на рисунке 1 или 2;

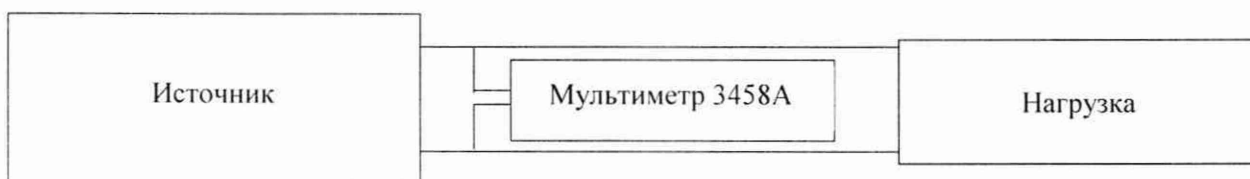


Рисунок 1 – Структурная схема определения абсолютной погрешности измерений/установки напряжения постоянного тока (от 0 до 1000 В включ.)

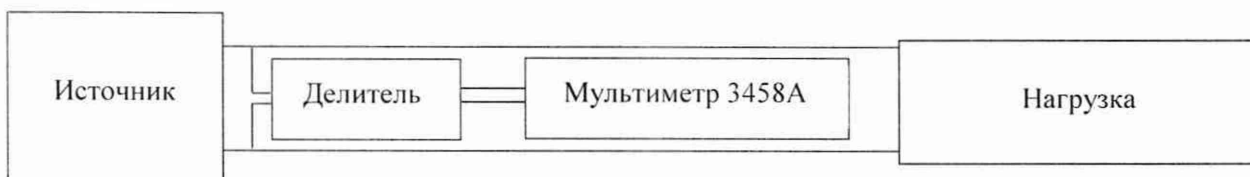


Рисунок 2 – Структурная схема определения абсолютной погрешности измерений/установки напряжения постоянного тока (св. 1000 В)

2) включить нагрузку и средства поверки согласно их ЭД;

3) последовательно воспроизвести с выходного канала источника пять значений напряжения постоянного тока, соответствующих 0-5 %, 20-30 %, 45-55 %, 70-80 %, 95-100 % диапазона измерений;

4) измерить мультиметром 3458А и нагрузкой значения напряжения постоянного тока на выходном канале источника для каждого воспроизводимого сигнала.

10.2 Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока

Определение абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока проводить при помощи мультиметра 3458А, источника, шунтов измерительных стационарных с ограниченной взаимозаменяемостью 75 ШИСВ.1 или шунта токового АКПП-7501 (далее – шунт) в следующей последовательности:

1) собрать схему, приведенную на рисунке 3;

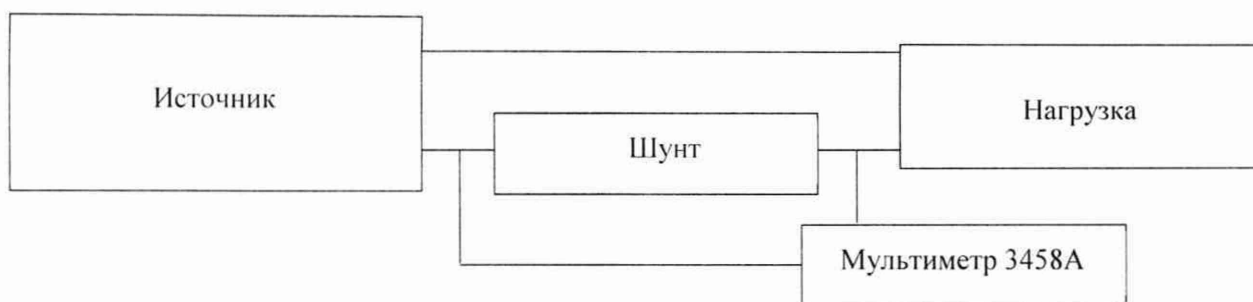


Рисунок 3 – Структурная схема определения абсолютной погрешности измерений/установки силы постоянного тока

2) в зависимости от модификации поверяемой нагрузки выбрать шунт таким образом, чтобы сила тока, измеряемая нагрузкой, не превышала максимально допустимой силы тока шунта;

3) последовательно воспроизвести с выходного канала источника пять значений силы постоянного тока, соответствующих 0-5 %, 20-30 %, 45-55 %, 70-80 %, 95-100 % диапазона измерений;

4) измерить мультиметром 3458А значения падения напряжения на шунте и нагрузкой значения силы постоянного тока.

10.3 Определение абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока

Определение абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока проводить при помощи мультиметра 3458А, источника, шунта, делителя в следующей последовательности:

1) собрать схему, приведенную на рисунке 4 или 5;



Рисунок 4 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерений/установки электрической мощности постоянного тока (от 0 до 1000 В включ.)

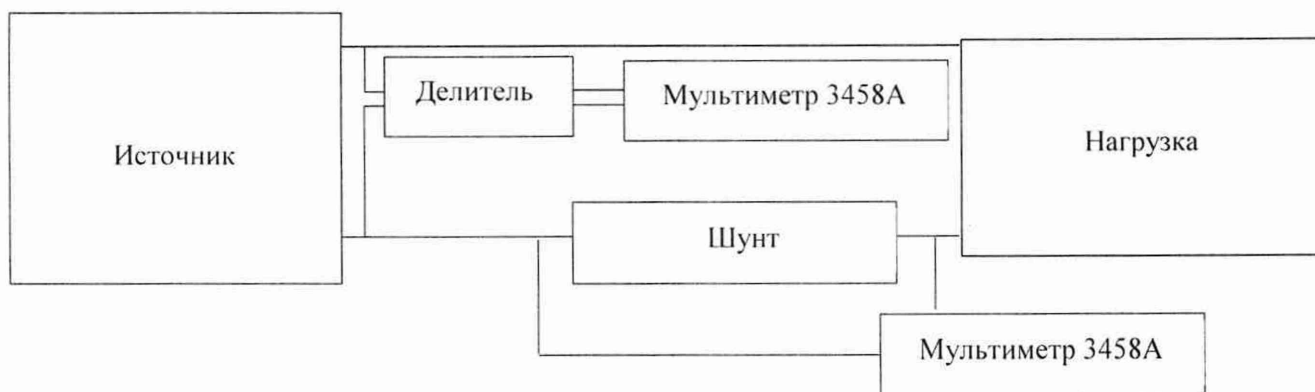


Рисунок 5 - Структурная схема определения абсолютной погрешности измерений/установки электрической мощности постоянного тока (св. 1000 В)

2) последовательно воспроизвести с выходного канала источника значения силы и напряжения постоянного тока, соответствующие пяти значениям электрической мощности постоянного тока 0-5 %, 20-30 %, 45-55 %, 70-80 %, 95-100 % диапазона измерений;

3) измерить мультиметром 3458А значения падения напряжения на шунте, значения напряжения постоянного тока и нагрузкой значения электрической мощности постоянного тока.

10.4 Определение абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока

Определение абсолютной погрешности установки напряжения постоянного проводить при помощи мультиметра 3458А и источника в следующей последовательности:

- 1) собрать схему, приведенную на рисунке 1 или 2;
- 2) включить нагрузку и средства поверки согласно их ЭД;
- 3) последовательно воспроизвести с выходного канала источника пять значений напряжения постоянного тока, соответствующих 7 %, 27 %, 52%, 77 %, 100 % диапазона установки при этом на нагрузке установить соответственно пять значений напряжения постоянного тока, соответствующих 5 %, 25 %, 50 %, 75 %, 98 % диапазона установки;
- 4) измерить мультиметром 3458А и нагрузкой значения напряжения постоянного тока на выходном канале источника для каждого воспроизводимого сигнала.

10.5 Определение абсолютной погрешности установки силы постоянного тока

Определение абсолютной погрешности установки силы постоянного тока проводить при помощи мультиметра 3458А, источника, шунта в следующей последовательности:

- 1) собрать схему, приведенную на рисунке 3;
- 2) в зависимости от модификации поверяемой нагрузки выбрать шунт таким образом, чтобы сила тока, измеряемая нагрузкой, не превышала максимально допустимой силы тока шунта;
- 3) последовательно воспроизвести с выходного канала источника пять значений силы постоянного тока, соответствующих 7 %, 27 %, 52%, 77 %, 100 % диапазона установки при этом на нагрузке установить соответственно пять значений силы постоянного тока, соответствующих 5 %, 25 %, 50 %, 75 %, 98 % диапазона установки;
- 4) измерить мультиметром 3458А значения падения напряжения на шунте и нагрузкой значения силы постоянного тока.

10.6 Определение абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока

Определение абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока проводить при помощи мультиметра 3458А, источника, шунта, делителя в следующей последовательности:

- 1) собрать схему, приведенную на рисунке 4 или 5;
- 2) последовательно воспроизвести с выходного канала источника значения силы и напряжения постоянного тока, соответствующие пяти значениям электрической мощности постоянного тока, соответствующих 7 %, 27 %, 52%, 77 %, 100 % диапазона установки при этом на нагрузке установить соответственно пять значений электрической мощности постоянного тока, соответствующих 5 %, 25 %, 50 %, 75 %, 98 % диапазона установки;
- 3) измерить мультиметром 3458А значения падения напряжения на шунте, значения напряжения постоянного тока и нагрузкой значения электрической мощности постоянного тока.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Абсолютная погрешность измерений/установки напряжения постоянного тока Δ_U , В, рассчитывается по формуле:

$$\Delta_U = U_{\text{изм/уст}} - U_{\text{действ}}, \quad (1)$$

где $U_{\text{изм/уст}}$ – значение напряжения постоянного тока, измеренное/установленное поверяемой нагрузкой, В;

$U_{\text{действ}}$ – действительное значение напряжения постоянного тока, измеренное мультиметром 3458А, В.

При использовании делителя $U_{\text{действ}}$, В, рассчитывается по формуле:

$$U_{\text{действ}} = K \cdot U_{\text{изм}}, \quad (2)$$

где K – коэффициент деления делителя;

$U_{\text{изм}}$ – измеренное мультиметром 3458А значение напряжения постоянного тока на выходе делителя, В.

11.2 Абсолютная погрешность измерений/установки силы постоянного тока Δ_I , А, рассчитывается по формуле:

$$\Delta_I = I_{\text{изм/уст}} - I_{\text{действ}}, \quad (3)$$

где $I_{\text{изм/уст}}$ – значение силы постоянного тока, измеренное/установленное поверяемой нагрузкой, А;

$I_{\text{действ}}$ – действительное значение силы постоянного тока, А.

Действительное значение силы постоянного тока $I_{\text{действ}}$, А, рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{действ}} = \frac{U_{\text{действ}}}{R_{\text{шунта}}}, \quad (4)$$

где $U_{\text{действ}}$ – значения падения напряжения постоянного тока на шунте, измеренное

мультиметром 3458А, В;

$R_{\text{шунта}}$ – действительное сопротивление шунта постоянному току, Ом.

11.3 Абсолютная погрешность измерений/установки электрической мощности постоянного тока ΔP , Вт, рассчитывается по формуле:

$$\Delta P = P_{\text{изм/уст}} - P_{\text{действ}} \quad (5)$$

где $P_{\text{изм/уст}}$ – значение электрической мощности постоянного тока, измеренное/установленное поверяемой нагрузкой, Вт;

$P_{\text{действ}}$ – действительное значение электрической мощности постоянного тока, Вт.

Действительное значение электрической мощности постоянного тока $P_{\text{действ}}$, Вт, рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{действ}} = U_{\text{действ}} \cdot I_{\text{действ}} \quad (6)$$

Нагрузка подтверждает соответствие метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, если полученные значения абсолютной погрешности измерений/установки напряжения постоянного тока, абсолютной погрешности измерений/установки силы постоянного тока, абсолютной погрешности измерений/установки электрической мощности постоянного не превышают пределов, указанных в таблицах А.1-А.2 Приложения А.

При невыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда нагрузка не подтверждает соответствие метрологическим требованиям), поверку нагрузки прекращают, результаты поверки признают отрицательными.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Результаты поверки нагрузки подтверждаются сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

12.2 По заявлению владельца нагрузки или лица, представившего ее на поверку, положительные результаты поверки (когда нагрузка подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) внесением в паспорт нагрузки записи о проведенной поверке, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

12.3 По заявлению владельца нагрузки или лица, представившего ее на поверку, отрицательные результаты поверки (когда нагрузка не подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

12.4 Протоколы поверки нагрузки оформляются по произвольной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основные метрологические характеристики нагрузок

Таблица А.1 – Метрологические характеристики в режиме установки напряжения и силы постоянного тока, электрической мощности постоянного тока

Модификация нагрузок	Диапазон установки напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, В	Диапазон установки силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока, А	Диапазон установки электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока, Вт
IT8902A-150-200	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 20 от 0 до 200	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$
IT8902E-150-200	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 20 от 0 до 200	$\pm(0,001 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$
IT8902A-600-140	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 14 от 0 до 140	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$
IT8902E-600-140	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 14 от 0 до 140	$\pm(0,001 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$
IT8902A-1200-80	от 0,1 до 120 от 0,1 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 18)$	от 0 до 8 от 0 до 80	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$
IT8902E-1200-80	от 0,1 до 120 от 0,1 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 18)$	от 0 до 8 от 0 до 80	$\pm(0,001 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$
IT8904A-150-400	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 40 от 0 до 200 включ. св. 200 до 400 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,04)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,4)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 4)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$

Модификация нагрузок	Диапазон установки напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, В	Диапазон установки силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока, А	Диапазон установки электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока, Вт
IT8904E-150-400	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 40 от 0 до 200 включ. св. 200 до 400 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,04)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,4)$ $\pm(0,001 \cdot I + 4)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$
IT8904A-600-280	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 28 от 0 до 200 включ. св. 200 до 280 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,028)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,28)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 2,8)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$
IT8904E-600-280	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 28 от 0 до 200 включ. св. 200 до 280 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,028)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,28)$ $\pm(0,001 \cdot I + 2,8)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$
IT8904A-1200-160	от 0,1 до 120 от 0,1 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 18)$	от 0 до 16 от 0 до 160	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$
IT8904E-1200-160	от 0,1 до 120 от 0,1 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 18)$	от 0 до 16 от 0 до 160	$\pm(0,001 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$
IT8906A-150-600	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 60 от 0 до 200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,6)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$

Модификация нагрузок	Диапазон установки напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, В	Диапазон установки силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока, А	Диапазон установки электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока, Вт
			св. 200 до 600 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I+6)$		
IT8906E-150-600	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U+0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 60 от 0 до 200 включ. св. 200 до 600 включ.	$\pm(0,001 \cdot I+0,06)$ $\pm(0,001 \cdot I+0,6)$ $\pm(0,001 \cdot I+6)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P+0,003 \cdot P_{Д})$
IT8906A-600-420	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U+0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 42 от 0 до 200 включ. св. 200 до 420 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I+0,042)$ $\pm(0,0005 \cdot I+0,42)$ $\pm(0,0005 \cdot I+4,2)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P+0,002 \cdot P_{Д})$
IT8906E-600-420	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U+0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 42 от 0 до 200 включ. св. 200 до 420 включ.	$\pm(0,001 \cdot I+0,042)$ $\pm(0,001 \cdot I+0,42)$ $\pm(0,001 \cdot I+4,2)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P+0,003 \cdot P_{Д})$
IT8906A-1200-240	от 0,1 до 120 от 0,1 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U+0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U+0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U+18)$	от 0 до 24 от 0 до 200 включ. св. 200 до 240 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I+0,024)$ $\pm(0,0005 \cdot I+0,24)$ $\pm(0,0005 \cdot I+2,4)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P+0,002 \cdot P_{Д})$
IT8906E-1200-240	от 0,1 до 120 от 0,1 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U+0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U+0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U+18)$	от 0 до 24 от 0 до 200 включ. св. 200 до 240 включ.	$\pm(0,001 \cdot I+0,024)$ $\pm(0,001 \cdot I+0,24)$ $\pm(0,001 \cdot I+2,4)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P+0,003 \cdot P_{Д})$
IT8912A-150-1200	от 0,1 до 18	$\pm(0,0005 \cdot U+0,0005 \cdot U_{Д})$	от 0 до 120	$\pm(0,0005 \cdot I+0,12)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P+0,002 \cdot P_{Д})$

Модификация нагрузок	Диапазон установки напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, В	Диапазон установки силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока, А	Диапазон установки электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока, Вт
	от 0,1 до 150		от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 1,2)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 10)$		
IT8912E-150-1200	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{\text{д}})$	от 0 до 120 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,12)$ $\pm(0,001 \cdot I + 1,2)$ $\pm(0,001 \cdot I + 10)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{\text{д}})$
IT8912A-600-840	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{\text{д}})$	от 0 до 84 от 0 до 200 включ. св. 200 до 840 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,084)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,84)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 8,4)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{\text{д}})$
IT8912E-600-840	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{\text{д}})$	от 0 до 84 от 0 до 200 включ. св. 200 до 840 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,084)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,84)$ $\pm(0,001 \cdot I + 8,4)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{\text{д}})$
IT8912A-1200-480	от 0,1 до 120 от 0,1 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 18)$	от 0 до 48 от 0 до 200 включ. св. 200 до 480 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,048)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,48)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 4,8)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{\text{д}})$
IT8912E-1200-480	от 0,1 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 0,6)$	от 0 до 48 от 0 до 200 включ. св. 200 до	$\pm(0,001 \cdot I + 0,048)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,48)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{\text{д}})$

Модификация нагрузок	Диапазон установки напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, В	Диапазон установки силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока, А	Диапазон установки электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока, Вт
	включ.	$\pm(0,0005 \cdot U + 18)$	480 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 4,8)$		
IT8918A-150-1800	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{дл})$	от 0 до 180 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,18)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 1,8)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 10)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{дл})$
IT8918E-150-1800	от 0,1 до 18 от 0,1 до 150	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{дл})$	от 0 до 180 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,18)$ $\pm(0,001 \cdot I + 1,8)$ $\pm(0,001 \cdot I + 10)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{дл})$
IT8918A-600-1260	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{дл})$	от 0 до 126 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,126)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 1,26)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 10)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{дл})$
IT8918E-600-1260	от 0,1 до 60 от 0,1 до 600	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,0005 \cdot U_{дл})$	от 0 до 126 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,126)$ $\pm(0,001 \cdot I + 1,26)$ $\pm(0,001 \cdot I + 10)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{дл})$
IT8918A-1200-720	от 0,1 до 120 от 0,1 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 18)$	от 0 до 72 от 0 до 200 включ. св. 200 до 720 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,072)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,72)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 7,2)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{дл})$
IT8918E-1200-720	от 0,1 до 120 от 0,1 до	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,06)$	от 0 до 72 от 0 до	$\pm(0,001 \cdot I + 0,072)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{дл})$

Модификация нагрузок	Диапазон установки напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, В	Диапазон установки силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока, А	Диапазон установки электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки электрической мощности постоянного тока, Вт
	1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot U + 18)$	200 включ. св. 200 до 720 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,72)$ $\pm(0,001 \cdot I + 7,2)$		
<p>Примечания:</p> <p>U – установленное значение напряжения постоянного тока, В;</p> <p>U_D – величина диапазона установки напряжения постоянного тока, В;</p> <p>I – установленное значение силы постоянного тока, А;</p> <p>I_D – величина диапазона установки силы постоянного тока, А;</p> <p>P – установленное значение электрической мощности постоянного тока, Вт;</p> <p>P_D – величина диапазона установки электрической мощности постоянного тока, Вт.</p>						

Таблица А.2 – Метрологические характеристики в режиме измерений напряжения и силы постоянного тока, электрической мощности постоянного тока

Модификация нагрузок	Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А	Диапазон измерений электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока, Вт
IT8902A-150-200	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 20 от 0 до 200	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,001 \cdot I_D)$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$
IT8902E-150-200	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 20 от 0 до 200	$\pm(0,001 \cdot I + 0,001 \cdot I_D)$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$
IT8902A-600-140	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 14 от 0 до 140	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,001 \cdot I_D)$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$
IT8902E-600-140	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 14 от 0 до 140	$\pm(0,001 \cdot I + 0,001 \cdot I_D)$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$
IT8902A-1200-80	от 0 до 120	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$	от 0 до 8	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,001 \cdot I_D)$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$

Модификация нагрузок	Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А	Диапазон измерений электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока, Вт
	от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 80			
IT8902E-1200-80	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 8 от 0 до 80	$\pm(0,001 \cdot I + 0,001 \cdot I_{Д})$	от 0 до 2000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$
IT8904A-150-400	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_{Д})$	от 0 до 40 от 0 до 200 включ. св. 200 до 400 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,04)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,4)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 4)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$
IT8904E-150-400	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_{Д})$	от 0 до 40 от 0 до 200 включ. св. 200 до 400 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,04)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,4)$ $\pm(0,001 \cdot I + 4)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$
IT8904A-600-280	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_{Д})$	от 0 до 28 от 0 до 200 включ. св. 200 до 280 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,028)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,28)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 2,8)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{Д})$
IT8904E-600-280	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_{Д})$	от 0 до 28 от 0 до 200 включ. св. 200 до	$\pm(0,001 \cdot I + 0,028)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,28)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{Д})$

Модификация нагрузок	Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А	Диапазон измерений электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока, Вт
			280 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 2,8)$		
IT8904A-1200-160	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 16 от 0 до 160	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,001 \cdot I_D)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$
IT8904E-1200-160	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 16 от 0 до 160	$\pm(0,001 \cdot I + 0,001 \cdot I_D)$	от 0 до 4000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$
IT8906A-150-600	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 60 от 0 до 200 включ. св. 200 до 600 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,06)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,6)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 6)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$
IT8906E-150-600	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 60 от 0 до 200 включ. св. 200 до 600 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,06)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,6)$ $\pm(0,001 \cdot I + 6)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$
IT8906A-600-420	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 42 от 0 до 200 включ. св. 200 до 420 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,042)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,42)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 4,2)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$
IT8906E-600-420	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 42 от 0 до	$\pm(0,001 \cdot I + 0,042)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$

Модификация нагрузок	Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А	Диапазон измерений электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока, Вт
			200 включ. св. 200 до 420 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,42)$ $\pm(0,001 \cdot I + 4,2)$		
IT8906A-1200-240	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 24 от 0 до 200 включ. св. 200 до 240 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,024)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,24)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 2,4)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$
IT8906E-1200-240	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 24 от 0 до 200 включ. св. 200 до 240 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,024)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,24)$ $\pm(0,001 \cdot I + 2,4)$	от 0 до 6000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$
IT8912A-150-1200	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 120 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,12)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 1,2)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 10)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$
IT8912E-150-1200	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 120 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,12)$ $\pm(0,001 \cdot I + 1,2)$ $\pm(0,001 \cdot I + 10)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$
IT8912A-600-840	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 84 от 0 до 200 включ. св. 200 до 840 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,084)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,84)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 8,4)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$

Модификация нагрузок	Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А	Диапазон измерений электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока, Вт
IT8912E-600-840	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_{\text{д}})$	от 0 до 84 от 0 до 200 включ. св. 200 до 840 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,084)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,84)$ $\pm(0,001 \cdot I + 8,4)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{\text{д}})$
IT8912A-1200-480	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 48 от 0 до 200 включ. св. 200 до 480 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,048)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,48)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 4,8)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{\text{д}})$
IT8912E-1200-480	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 48 от 0 до 200 включ. св. 200 до 480 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,048)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,48)$ $\pm(0,001 \cdot I + 4,8)$	от 0 до 12000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{\text{д}})$
IT8918A-150-1800	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_{\text{д}})$	от 0 до 180 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,18)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 1,8)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 10)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{\text{д}})$
IT8918E-150-1800	от 0 до 18 от 0 до 150	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_{\text{д}})$	от 0 до 180 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,18)$ $\pm(0,001 \cdot I + 1,8)$ $\pm(0,001 \cdot I + 10)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_{\text{д}})$
IT8918A-600-1260	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_{\text{д}})$	от 0 до 126 от 0 до 200 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,126)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 1,26)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_{\text{д}})$

Модификация нагрузок	Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Диапазон измерений силы постоянного тока, А	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А	Диапазон измерений электрической мощности постоянного тока, Вт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока, Вт
			св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 10)$		
IT8918E-600-1260	от 0 до 60 от 0 до 600	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00025 \cdot U_D)$	от 0 до 126 от 0 до 200 включ. св. 200 до 1000 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,126)$ $\pm(0,001 \cdot I + 1,26)$ $\pm(0,001 \cdot I + 10)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$
IT8918A-1200-720	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 72 от 0 до 200 включ. св. 200 до 720 включ.	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,072)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 0,72)$ $\pm(0,0005 \cdot I + 7,2)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,002 \cdot P_D)$
IT8918E-1200-720	от 0 до 120 от 0 до 1000 включ. св. 1000 до 1200 включ.	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,03)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 0,3)$ $\pm(0,00025 \cdot U + 18)$	от 0 до 72 от 0 до 200 включ. св. 200 до 720 включ.	$\pm(0,001 \cdot I + 0,072)$ $\pm(0,001 \cdot I + 0,72)$ $\pm(0,001 \cdot I + 7,2)$	от 0 до 18000	$\pm(0,002 \cdot P + 0,003 \cdot P_D)$

Примечания:

U – измеренное значение напряжения постоянного тока, В;

U_D – величина диапазона измерений напряжения постоянного тока, В;

I – измеренное значение силы постоянного тока, А;

I_D – величина диапазона измерений силы постоянного тока, А;

P – измеренное значение электрической мощности постоянного тока, Вт;

P_D – величина диапазона измерений электрической мощности постоянного тока, Вт.