



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора - заместитель по научной
работе ФГУП «ВНИИФТРИ»



 А.Н. Щипунов
»  2024 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**Модули расширения частотного диапазона векторных
анализаторов электрических цепей 3643**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 113-23-012

р.п. Менделеево
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	4
3	ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ.....	5
4	ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	5
5	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ....	5
6	ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	7
7	ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.....	7
8	ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.....	8
9	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.	9
10	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.....	13
12	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	15

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на модули расширения частотного диапазона векторных анализаторов электрических цепей 3643 (далее – МРЧД), изготавливаемые фирмой «Ceyear Technologies Co., Ltd», Китай, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 Первичной поверке подлежат МРЧД до ввода в эксплуатацию и после ремонта. Периодической поверке подлежат МРЧД, находящиеся в эксплуатации и на хранении.

1.3 Применяемые при поверке эталоны и средства измерений должны обеспечивать прослеживаемость к государственным первичным эталонам единиц величин:

ГЭТ 1-2022 «Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени» в соответствии с Приказом Росстандарта № 2360 от 26.09.2022 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;

ГЭТ 193-2011 «Государственный первичный эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 178 ГГц» в соответствии с Приказом Росстандарта № 3383 от 30.12.2019 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений ослабления напряжения постоянного тока и электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 20 Гц до 178,4 ГГц».

1.4 Проверка МРЧД может осуществляться только аккредитованным на проведение поверки лицом в соответствии с его областью аккредитации, в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

1.5 При проведении поверки необходимо руководствоваться настоящей методикой и эксплуатационной документацией на МРЧД и на используемое при поверке оборудование. Методика поверки реализуется посредством методов прямых измерений.

1.6 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические характеристики, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	3643NA	3643P
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 50 до 75	от 75 до 110
Диапазон частот на входах «RF» и «LO», ГГц	от 12,5 до 18,75	от 12,5 до 18,33
Мощность выходного сигнала, дБ (1 мВт), не менее		5
Номинальный уровень мощности на входах «RF» и «LO», дБ (1 мВт)		10
Диапазон измерений модуля коэффициента передачи $ S_{ji} ^{1)}$, дБ		от 0 до -60
Диапазон измерений фазы коэффициента передачи $ S_{ji} $, градус		от -180 до +180
Диапазон измерений модуля коэффициента отражения $ S_{ii} ^{2)}$		от 0,01 до 1
Диапазон измерений фазы коэффициента отражения $ S_{ii} $, градус		от -180 до +180
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения $ S_{ii} $, отн. ед. ³⁾		$0,018+0,014 \cdot S_{ii} +0,018 \cdot S_{ii} ^2$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента отражения, градус ³⁾		$\pm[1,0+(180/\pi) \cdot \arcsin(\Delta S_{ii} / S_{ii})]$

Продолжение таблицы 1

Наименование характеристики	Значение	
	3643NA	3643Р
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей $\Delta S_{ji} $, дБ ³⁾		$\pm[0,12+ 0,01 \cdot S_{ji}]$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи, градус ³⁾		$\pm[0,5+(180/\pi) \cdot \arcsin(\Delta S_{ji} /8,6)]$
¹⁾ $ S_{ji} $ – модуль коэффициента передачи		
²⁾ $ S_{ii} $ – модуль коэффициента отражения		
³⁾ Значения погрешностей приведены после калибровки комплектами мер калибровочных ZV-WR10, ZV-WR15 или аналогичных		

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки МРЧД должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	да	да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
Определение диапазона рабочих частот и диапазона частот на входах «RF» и «LO»	да	да	9.1
Определение номинального уровня мощности на входах «RF» и «LO»	да	да	9.2
Определение мощности выходного сигнала	да	да	9.3
Определение диапазона измерений модуля и фазы коэффициента отражения $ S_{ii} $ и абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения $\Delta S_{ii} $	да	да	9.4
Определение диапазона измерений модуля коэффициента передачи $ S_{ji} $ и абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей $\Delta S_{ji} $	да	да	9.5
Определение диапазона измерений фазы коэффициента передачи и абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи	да	да	9.6
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	10

2.2 Допускается проводить периодическую поверку меньшего числа измеряемых величин, которые используются при эксплуатации по соответствующим пунктам настоящей методики поверки. Данные ограничения должны быть зафиксированы при оформлении результатов поверки.

2.3 При получении отрицательных результатов по любому пункту таблицы 1 поверяемый МРЧД бракуется и направляется в ремонт.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия (если не оговорено иное):

- температура окружающего воздуха, °C (K) от плюс 15 до плюс 25 (от 288 до 298);
- относительная влажность окружающего воздуха, % не более 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800);

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 Поверка должна осуществляться лицами со средним или высшим техническим образованием, аттестованными в качестве поверителей в области радиотехнических измерений в установленном порядке и имеющим квалификационную группу электробезопасности не ниже второй.

4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно ознакомиться с документами «Модули расширения частотного диапазона векторных анализаторов электрических цепей 3643. Руководство по эксплуатации» (далее – РЭ) и «Модули расширения частотного диапазона векторных анализаторов электрических цепей 3643NA, 3643P. Паспорт» (далее – ПС).

4.3 Поверка осуществляется одним специалистом.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 Рекомендуемые средства поверки, в том числе рабочие эталоны и средства измерений, приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Перечень средств поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	<u>Вспомогательное оборудование:</u> Комплект мер калибровочных тип волноводного тракта: WR15 для модификации 3643NA; WR10 для модификации 3643P	Комплект мер калибровочных ZV-WR10 и комплект мер калибровочных ZV-WR15 из состава Государственного рабочего эталона комплексных коэффициентов передачи в диапазоне от 0 до минус 60 дБ и комплексных коэффициентов отражений в диапазоне частот от 33 до 170 ГГц в волноводных трактах 3.1.ZZT.0148.2015

Продолжение таблицы 3

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
9.1 Определение диапазона рабочих частот и диапазона частот на входах «RF» и «LO»	Стандарт частоты с номинальным значением воспроизводимых частот: 5, 10 МГц, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 3 разряда в соответствии с Приказом Росстандарта № 2360 от 26.09.2022.	Стандарт частоты рубидиевый FS725, рег. № 31222-06
9.2 Определение номинального уровня мощности на входах «RF» и «LO»	Анализатор спектра с диапазоном рабочих частот от 5 кГц до 3 ГГц, диапазоном измерений уровня мощности входного сигнала от минус 70 до 0 дБ (1 мВт). Генератор сигналов с диапазоном частот от 250 кГц до 50 ГГц, пределом допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 7,5 \cdot 10^{-8}$; диапазоном выходной мощности от минус 110 до 15 дБ (1 мВт)	Анализатор спектра FPC1000, рег. № 68365-17 Генератор сигналов E8257D, рег. № 68365-17
9.3 Определение мощности выходного сигнала	Измеритель мощности с диапазоном измерения мощности от 0 до 10 дБ (1 мВт), тип волноводного тракта: WR15 для модификации 3643NA; WR10 для модификации 3643P	Преобразователь измерительный ваттметров поглощаемой мощности V8486A рег. № 58320-14 Преобразователь измерительный ваттметров поглощаемой мощности W8486A рег. № 58320-14
9.4 Определение диапазона измерений модуля и фазы коэффициента отражения $ S_{ii} $ и абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения $\Delta S_{ii} $	<u>Вспомогательное оборудование:</u> Нагрузка согласованная с сечением волноводного тракта: WR15 для модификации 3643NA; WR10 для модификации 3643P	Государственный рабочий этalon комплексных коэффициентов передачи в диапазоне от 0 до минус 60 дБ и комплексных коэффициентов отражений в диапазоне от 0,006 до 1 в диапазоне частот от 33 до 170 ГГц в волноводных трактах 3.1.ZZT.0148.2015
9.5 Определение диапазона измерений модуля коэффициента передачи $ S_{ji} $ и абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей $\Delta S_{ji} $	Аттенюатор с диапазоном частот от 50 до 75 ГГц для модификации 3643NA, от 75 до 110 ГГц для модификации 3643P, диапазоном измерений ослабления от 0 до 60 дБ, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 2 разряда в соответствии с Приказом Росстандарта № 3383 от 30.12.2019. <u>Вспомогательное оборудование:</u> Нагрузка короткозамкнутая с сечением волноводного тракта: WR15 для модификации 3643NA; WR10 для модификации 3643P	Аттенюатор поляризационный DA-04E, рег. № 92420-24 Аттенюатор поляризационный DA-03E, рег. № 92420-24 Государственный рабочий этalon комплексных коэффициентов передачи в диапазоне от 0 до минус 60 дБ и комплексных коэффициентов отражений в диапазоне от 0,006 до 1 в диапазоне частот от 33 до 170 ГГц в волноводных трактах 3.1.ZZT.0148.2015

Продолжение таблицы 3

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
9.6 Определение диапазона измерений фазы коэффициента передачи и абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи	<u>Вспомогательное оборудование:</u> Мера фазового сдвига с сечением волноводного тракта: WR15 для модификации 3643NA; WR10 для модификации 3643Р	Государственный рабочий эталон комплексных коэффициентов передачи в диапазоне от 0 до минус 60 дБ и комплексных коэффициентов отражений в диапазоне от 0,006 до 1 в диапазоне частот от 33 до 170 ГГц в волноводных трактах 3.1.ZZT.0148.2015
9.1 9.6	Анализатор электрических цепей с диапазоном рабочих частот от 10 МГц до 20 ГГц, с пределом допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала $\pm 1 \cdot 10^{-7}$, с диапазоном воспроизведения мощности выходного сигнала от минус 30 до плюс 15 дБ (1 мВт). Измеритель температуры с диапазоном температур от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Измеритель влажности с диапазоном измерений относительной влажности от 0 до 99 %. Измеритель атмосферного давления с диапазоном измерений абсолютного давления от 840 до 1060 гПа.	Анализатор электрических цепей векторный ZVA67, рег. № 48355-11 Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, рег. № 15500-07

Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, регламентируемые правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, а также требования безопасности, приведённые в эксплуатационной документации на МРЧД и средства поверки.

6.2 Средства поверки должны быть надежно заземлены в соответствии с эксплуатационной документацией.

6.3 Размещение и подключение измерительных приборов разрешается производить только при выключенном питании.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Внешний осмотр МРЧД провести визуально без вскрытия, при этом необходимо проверить:

- комплектность, маркировку и пломбировку (наклейку) на соответствие документам РЭ и ПС;

- целостность и чистоту разъемов;
- целостность фирменной наклейки;
- исправность сетевого шнура;
- отсутствие видимых повреждений, влияющих на работоспособность МРЧД.

7.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если:

- комплект поставки соответствует документам РЭ и ПС;
- маркировка соответствует документу РЭ;
- пломбировка (наклейка) и фирменная наклейка целы;
- разъемы целы и чисты;
- отсутствуют видимые повреждения, влияющие на работоспособность МРЧД.

В противном случае результаты внешнего осмотра считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в РЭ на применяемые средства поверки.

8.2 Проверку работоспособности МРЧД выполнить в следующей последовательности.

ВНИМАНИЕ! Перед включением МРЧД убедитесь, что провод заземления МРЧД надежно соединен с проводом заземления источника питания постоянного тока. Прежде, чем подключить МРЧД к источнику питания, убедитесь, что напряжение питания в норме.

8.2.1 Подключить штекер адаптера питания к интерфейсу [DC input] (вход питания) модуля расширения частотного диапазона.

8.2.2 Подготовить к работе анализатор электрических цепей векторный ZVA67 (далее – анализатор цепей векторный) в соответствии с РЭ на него.

8.2.3 Собрать схему в соответствии с рисунком 1. При соединении МРЧД с анализатором цепей векторным руководствоваться ЭД на МРЧД.

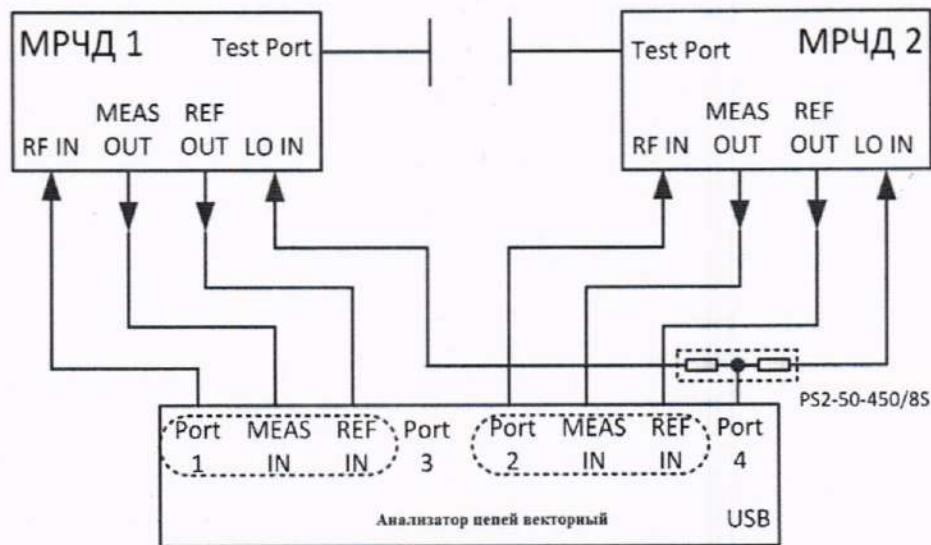


Рисунок 1 – Схема проверки работоспособности МРЧД

8.2.4 Включить модуль расширения частотного диапазона и анализатор цепей векторный в соответствии с РЭ на них. Убедиться, что после включения срабатывает вентилятор внутри поверяемого модуля. Прогреть в течении 30 минут.

8.2.5 Обеспечить прямое соединение между волноводными фланцами МРЧД и провести нормализацию в соответствии с ЭД на анализатор цепей векторный.

8.2.6 После проведения нормализации отсоединить волноводные фланцы МРЧД друг от друга и провести двухпортовую калибровку анализатора цепей векторного подключая соответствующие калибровочные меры. Устанавливая поочередно режимы измерений S_{11} , S_{12} , S_{21} , S_{22} убедиться, что происходит обновление трассы в полном диапазоне частот для каждого вида измерений.

8.3 Результаты опробования считать положительными, если:

- вентилятор МРЧД срабатывает после включения.

- в режимах измерений S_{11} , S_{12} , S_{21} , S_{22} происходит обновление трассы в полном диапазоне частот для каждого вида измерений.

В противном случае результаты поверки считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Определение диапазона рабочих частот и диапазона частот на входах «RF» и «LO»

9.1.1 Определение диапазона рабочих частот и диапазона частот на входах «RF» и «LO» выполнить в следующей последовательности.

9.1.1.1 Подготовить к работе анализатор спектра FPC1000 (далее - анализатор спектра), генератор сигналов E8257D (далее – гетеродин), анализатор цепей векторный, стандарт частоты рубидиевый FS725 (далее – стандарт частоты) в соответствии с РЭ на них.

9.1.1.2 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 1. Установить на векторном анализаторе цепей диапазон частот, соответствующий диапазону рабочих частот МРЧД. Выполнить TRL калибровку анализатора цепей векторного с подключенными к нему МРЧД в соответствии с РЭ на анализатор цепей векторный. Установить на векторном анализаторе цепей режим измерения S_{21} .

9.1.1.3 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 2. Включить гетеродин, анализатор спектра и стандарт частоты.

9.1.1.4 Соединить выходы 10 МГц стандарта частоты с соответствующими входами анализатора спектра и гетеродина. Соединить выход REF OUT МРЧД2 с входом анализатора спектра.

9.1.1.5 Установить на анализаторе спектра режим работы от внешнего источника, центральную частоту для соответствующего измерительного порта 500 МГц, полосу обзора 999 МГц. Анализатор цепей векторный настроить для работы на фиксированной частоте.

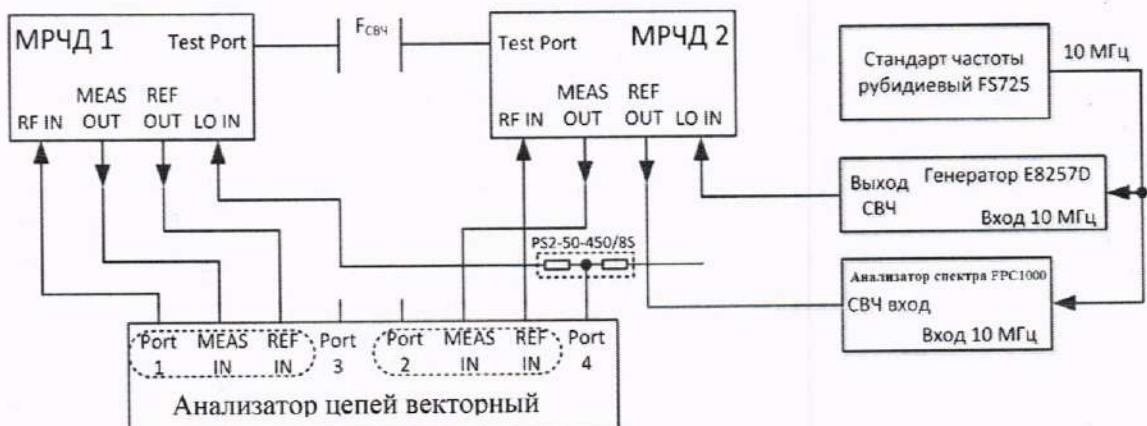


Рисунок 2 – Схема определения относительной погрешности установки частоты выходного сигнала

9.1.1.6 Установить на анализаторе цепей векторном частоту выходного сигнала, в соответствии с таблицей 4, и значение мощности 10 дБ (1 мВт).

9.1.1.7 Установить на гетеродине частоту выходного сигнала $F_{ГЕТ1}$ (ГГц), определяемую по формуле (1), и мощность выходного сигнала 10 дБ (1мВт).

$$F_{ГЕТ1} = \frac{F_{УСТ} + F_{ПЧ1}}{N_2}, \quad (1)$$

где $F_{УСТ}$ – значение частоты выходного сигнала МРЧД, ГГц, в соответствии с таблицей 4;

$F_{ПЧ1}$ – значение частоты на выходе REF OUT МРЧД, ГГц, измеряемое анализатором спектра.

N_2 – коэффициент умножения частоты гетеродина $F_{ГЕТ}$;

9.1.1.8 Наблюдать на экране анализатора спектра появление сигнала. Убедиться, что сигнал не является паразитным. Для этого увеличить частоту гетеродина на $\Delta F_{ГЕТ} = 10$ МГц. При этом измеряемое анализатором спектра значение промежуточной частоты $F_{ПЧ1}$ должно увеличиться на $(N \cdot \Delta F_{ГЕТ})$ МГц.

9.1.1.9 Установить на анализаторе спектра центральную частоту 300 МГц и полосу обзора 480 МГц.

9.1.1.10 Измерить анализатором спектра частоту сигнала $F_{ПЧ1}$, установив маркер в режим измерения частоты с разрешением 1 Гц.

9.1.1.11 Зафиксировать в протоколе поверки значение частот $F_{УСТ}$, $F_{ГЕТ1}$ и значение промежуточной частоты $(F_{ПЧ1})_j$, отсчитанное по маркеру на анализаторе спектра в режиме измерения частоты.

9.1.1.12 Увеличить частоту гетеродина на 10 МГц. Зафиксировать частоту, измеренную анализатором спектра $F_{ПЧ2}$.

9.1.1.13 Рассчитать измеренное значение частоты по формулам (4), (5):

$$F_{изм} = N \cdot F_{ГЕТ1} - F_{ПЧ1}, \text{ если } F_{ПЧ2} > F_{ПЧ1}, \quad (4)$$

$$F_{изм} = N \cdot F_{ГЕТ1} + F_{ПЧ1}, \text{ если } F_{ПЧ2} < F_{ПЧ1}, \quad (5)$$

9.1.1.14 Повторить действия п.п. 9.1.1.5 – 9.1.1.13 для значений частот из таблицы 4.

Таблица 4 – Значения частот, устанавливаемые на МРЧД

Значение частоты на входах «RF» и «LO» F_{RF} , устанавливаемое на анализаторе цепей векторном, ГГц	Коэффициент умножения частоты входного сигнала N	Значение частоты выходного сигнала МРЧД, $F_{УСТ}$, ГГц	
3643NA	3643P	3643NA	3643P
12,50000		50	75
13,50000		54	81
14,50000		58	87
15,50000		62	93
16,50000		66	99
17,50000		70	105
18,75000		75	110
18,33333			

9.1.2 Результаты поверки считать положительными, если диапазон рабочих частот и диапазон частот на входах «RF» и «LO» соответствуют п. 10.1.

9.2 Определение номинального уровня мощности на входах «RF» и «LO»

9.2.1 Определение номинального уровня мощности на входах «RF» и «LO» проводить одновременно с п. 9.5 «Определение диапазона измерений модуля коэффициента передачи $|S_{ji}|$ и абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей $\Delta|S_{ji}|$ ».

9.2.2 Результаты поверки считать положительными, если при номинальном уровне мощности на входах «RF» и «LO» 10 дБ (1 мВт) диапазон измерений модуля коэффициента передачи $|S_{ji}|$ соответствует п. 10.4.

9.3 Определение мощности выходного сигнала

9.3.1 Определение мощности выходного сигнала проводить в следующей последовательности.

9.3.1.1 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 1. Установить на векторном анализаторе цепей диапазон частот, соответствующий диапазону рабочих частот МРЧД.

9.3.1.2 Установить на анализаторе цепей векторном значение мощности 10 дБ (1 мВт).

9.3.1.3 Анализатор цепей векторный настроить для работы на фиксированной частоте.

9.3.1.4 Подготовить к работе преобразователь измерительный V8486 А (для модификации 3643НА) или преобразователь измерительный W8486А (для модификации 3643Р) (далее – ваттметр) в соответствии с РЭ на них.

9.3.1.5 Подключить к волноводному выходу МРЧД ваттметр.

9.3.1.6 Провести измерения на частотах в соответствии с таблицей 4.

9.3.1.7 Результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

9.3.2 Результаты поверки считать положительными, если мощность выходного сигнала не менее 5 дБ (1 мВт).

9.4 Определение диапазона измерений модуля и фазы коэффициента отражения $|S_{ii}|$ и абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения $\Delta|S_{ii}|$

9.4.1 Определение диапазона измерений модуля и фазы коэффициента отражения $|S_{ii}|$ выполнить в следующей последовательности.

9.4.1.1 Установить на векторном анализаторе цепей режим измерения S_{11} .

9.4.1.2 Присоединить нагрузку согласованную (номинальное значение модуля коэффициента отражения 0,01), из состава Государственного эталона единиц комплексных коэффициентов передачи в диапазоне от 0 до минус 60 дБ и комплексных коэффициентов отражений в диапазоне от 0,006 до 1 в диапазоне частот от 33 до 170 ГГц в волноводных трактах (далее – 3.1.ZZT.0148.2015), к МРЧД, подключенному к порту 1 векторного анализатора цепей.

9.4.1.3 Провести измерения модуля коэффициента отражения $|S_{ii}|$, используя маркеры, на частотах:

модификация 3643НА 50, 60, 70, 75 ГГц;

модификация 3643Р 75, 90, 100, 110 ГГц.

9.4.1.4 Повторить операции п.п. 4.10.1.2 – 4.10.1.4 для второго МРЧД.

9.4.1.5 Результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

9.4.1.6 Отсоединить от МРЧД нагрузку согласованную.

9.4.1.7 Присоединить нагрузку рассогласованную с номинальным значением КСВН 1,2, аттестованную (проверенную) по фазе коэффициента отражения, из состава 3.1.ZZT.0148.2015, к МРЧД, подключенному к порту 1 векторного анализатора цепей.

9.4.1.8 Провести измерения фазы коэффициента отражения, на частотах аттестации

(проверки) нагрузки рассогласованной.

9.4.1.9 При измерении фазы коэффициента отражения, убедиться, что отображение фазы есть в диапазоне от минус 180° до плюс 180°.

9.4.1.10 Повторить операции п.п. 9.4.1.7 – 9.4.1.9 для второго МРЧД.

9.4.1.11 Результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

9.4.1.12 Отсоединить от МРЧД нагрузку рассогласованную.

9.4.1.13 Присоединить к порту 1 отрезок и меру короткого замыкания (номинальное значение модуля коэффициента отражения 1) из состава 3.1.ZZT.0148.2015.

9.4.1.14 Повторить операции п.п. 9.4.1.3 – 9.4.1.5.

9.4.1.15 Рассчитать абсолютную погрешность модуля и фазы коэффициента отражения $\Delta|S_{ii}|$ в соответствии с п. 10.2.

9.4.2 Результаты поверки считать положительными, если диапазон измерений модуля и фазы коэффициента отражения $|S_{ii}|$ и абсолютная погрешность измерений модуля и фазы коэффициента отражения $\Delta|S_{ii}|$ находится в допускаемых пределах, приведенных в п.10.2.

9.5 Определение диапазона измерений модуля коэффициента передачи $|S_{ji}|$ и абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей $\Delta|S_{ji}|$

9.5.1 Определение диапазона измерений модуля коэффициента передачи $|S_{ji}|$ выполнить в следующей последовательности.

9.5.1.1 Установить на векторном анализаторе цепей режим измерения S_{21} , маркеры на частотах:

модификация 3643NA 50, 55, 60, 65, 70, 75 ГГц;

модификация 3643Р 75, 80, 90, 100, 105, 110 ГГц.

9.5.1.2 Подключить аттенюатор к 3.1.ZZT.0148.2015.

9.5.1.3 Установить на аттенюаторе уровень ослабления, соответствующий модулю коэффициента передачи 0 дБ.

9.5.1.4 Отсоединить аттенюатор и не изменяя его настройки подключить к волноводному фланцу первого МРЧД. Выход аттенюатора соединить с волноводным фланцем второго МРЧД, в соответствии с рисунком 4.



Рисунок 4 – Схема измерения модуля коэффициента передачи $|S_{ji}|$

9.5.1.5 Провести измерения модуля коэффициента передачи S_{21} .

9.5.1.6 Результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

9.5.1.7 Повторить операции п.п. 9.5.1.2 -9.5.1.6 устанавливая на аттенюаторе значения ослабления, соответствующие модулю коэффициента передачи 30 и 60 дБ. Полученные значения занести в протокол испытаний.

9.5.1.8 Повторить операции п.п. 9.5.1.2 - 9.5.1.7 при режиме измерений векторного анализатора цепей S_{12} .

9.5.1.9 Рассчитать абсолютную погрешность измерений модуля коэффициента передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей $\Delta|S_{ji}|$ в соответствии с п. 10.3.

9.5.2 Результаты поверки считать положительными, если диапазон измерений модуля коэффициента передачи $|S_{ji}|$ и абсолютная погрешность измерений модуля коэффициента

передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей $\Delta|S_{ji}|$ находятся в допускаемых пределах, приведенных в п. 10.3.

9.6 Определение диапазона измерений фазы коэффициента передачи и абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи

9.6.1 Определение диапазона измерений фазы коэффициента передачи и абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи выполнить в следующей последовательности.

9.6.1.1 Установить на векторном анализаторе цепей режим измерения S_{21} .

9.6.1.2 Соединить волноводный фланец первого МРЧД с мерой фазового сдвига из состава 3.1.ZZT.0148.2015. Противоположный выход меры фазового сдвига соединить с волноводным фланцем СВЧ выхода второго МРЧД, в соответствии с рисунком 5.



Рисунок 5 – Схема измерения фазы коэффициента передачи $|S_{ij}|$

9.6.1.3 Провести измерения фазы коэффициента передачи в рабочем диапазоне частот МРЧД, при этом наблюдать за фазо-частотной характеристикой меры фазового сдвига, которая представляет из себя пилообразную кривую, принимающую значения от минус 180° до плюс 180° по оси ординат. Убедиться, что отображение фазы есть в диапазоне от минус 180° до плюс 180° .

9.6.1.4 Результаты измерений занести в протокол поверки.

9.6.1.5 Рассчитать абсолютную погрешность измерений фазы коэффициента передачи в соответствии с п. 10.4.

9.6.2 Результаты поверки считать положительными, если диапазон измерений фазы коэффициента передачи и абсолютная погрешность измерений фазы коэффициента передачи находится в допускаемых пределах, приведенных в п. 10.4.

10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

10.1 Диапазон рабочих частот и диапазон частот на входах «RF» и «LO» определить методом прямых измерений и сравнения полученных результатов с нормированными значениями.

Результаты поверки считать положительными, если:

- диапазон рабочих частот находится в допускаемых пределах:
модификация 3643NA от 50 до 75 ГГц;
модификация 3643Р от 75 до 110 ГГц;
 - диапазон частот на входах «RF» и «LO» находится в допускаемых пределах:
модификация 3643NA от 12,5 до 18,75 ГГц;
модификация 3643Р от 12,5 до 18,33 ГГц.

10.2 Диапазон измерений модуля и фазы коэффициента отражения $|S_{ii}|$ определить методом прямых измерений и сравнения полученных результатов с нормированными значениями.

Абсолютную погрешность модуля и фазы коэффициента отражения $\Delta|S_{ii}|$ рассчитать по формуле (6).

$$\Delta|S_{ii}| = |S_{ii}|_{ном} - |S_{ii}|_{изм}, \quad (6)$$

$$\Delta\Phi_{ii} = \Phi_{ii\text{ nom}} - \Phi_{ii\text{ изм}} \quad (7)$$

где $|S_{ii}|_{ном}$ – номинальное значение модуля коэффициента отражения нагрузки согласованной;

$|S_{ii}|_{изм}$ – измеренное значение модуля коэффициента отражения;

$\Phi_{ii\text{ nom}}$ – номинальное значение фазы коэффициента отражения нагрузки согласованной, градус;

$\Phi_{ii\text{ изм}}$ – измеренное значение фазы коэффициента отражения, градус.

Результаты поверки считать положительными, если:

- значения модуля коэффициента отражения $|S_{ii}|_{изм}$ в диапазоне рабочих частот находятся в пределах от 0,01 до 1;

- фаза коэффициента отражения находится в диапазоне от минус 180° до плюс 180° ;

- абсолютная погрешность измерений модуля коэффициента отражения $\Delta|S_{ii}|$ находится в допускаемых пределах $\Delta|S_{ii}|_{don}=0,018+0,014\cdot|S_{ii}|+0,018\cdot|S_{ii}|^2$;

- абсолютная погрешность измерений фазы коэффициента отражения находится в допускаемых пределах $\Delta\Phi_{ii\text{ don}}=\pm[1,0+(180/\pi)\cdot\arcsin(\Delta|S_{ii}|/|S_{ii}|)]$.

10.3 Диапазон измерений модуля коэффициента передачи $|S_{ji}|$ определить методом прямых измерений и сравнения полученных результатов с нормированными значениями.

Абсолютную погрешность измерений модуля коэффициента передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей $\Delta|S_{ji}|$ рассчитать по формуле (8).

$$\Delta|S_{ji}| = |S_{ji}|_{ном} - |S_{ji}|_{изм}, \quad (8)$$

где $|S_{ji}|_{ном}$ – значение модуля коэффициента передачи, установленное на аттенюаторе с помощью 3.1.ZZT.0148.2015, дБ;

$|S_{ji}|_{изм}$ – измеренное значение модуля коэффициента передачи, дБ.

Результаты поверки считать положительными, если:

- значения модуля коэффициента передачи $\Delta|S_{ji}|$ находятся в допускаемых пределах от 0 до минус 60;

- абсолютная погрешность измерений модуля коэффициента передачи согласованных четырехполюсников без учета нелинейности и уровня собственных шумов анализатора цепей находится в пределах $\Delta|S_{ji}|_{don}=\pm[0,12+|0,01\cdot|S_{ji}||]$.

10.4 Диапазон измерений фазы коэффициента передачи определить методом прямых измерений и сравнения полученных результатов с нормированными значениями.

Абсолютную погрешность фазы коэффициента передачи рассчитать по формуле (9).

$$\Delta\Phi_{ji} = \Phi_{ji\text{ nom}} - \Phi_{ji\text{ изм}} \quad (9)$$

где $\Phi_{ji\text{ nom}}$ – номинальное значение фазы коэффициента передачи меры фазового сдвига, градус;

$\Phi_{ji\text{ изм}}$ – измеренное значение фазы коэффициента передачи, градус.

Результаты поверки считать положительными, если:

- значения фазы коэффициента передачи находятся в допускаемых пределах от минус 180° до плюс 180° ;

- абсолютная погрешность измерений фазы коэффициента передачи находится в пределах $\Delta\Phi_{ji\text{ don}}=\pm[0,5+(180/\pi)\cdot\arcsin(\Delta|S_{ji}|/8,6)]$.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 МРЧД признается годным, если в ходе поверки все результаты поверки положительные.

11.2 Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

11.3 При положительных результатах поверки по заявлению владельца МРЧД или лица, предъявившего его на поверку выдается свидетельство о поверке, и (или) в паспорт МРЧД вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

11.4 Знак поверки в виде наклейки наносится на переднюю панель МРЧД.

11.5 При выполнении сокращенной поверки (на основании решения или заявки на проведение поверки, эксплуатирующей организации) в свидетельстве о поверке указывать диапазон частот, на котором выполнена поверка.

11.6 МРЧД, имеющий отрицательные результаты поверки, в обращение не допускается. На него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования по установленной форме.

Начальник НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»

Начальник центра - заместитель начальника
НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»

Ведущий инженер лаборатории 113 НИО-1
ФГУП «ВНИИФТРИ»

О.В. Каминский

И.П. Чирков

О.А. Коновалова