

СОГЛАСОВАНО



Заместитель директора  
ФГБУ «ВНИИОФИ»

Е.А. Гаврилова

2024 г.

**«ГСИ. Измеритель удлинения световодов ИД-2-ЗВ.  
Методика поверки»  
МП 030.Ф3-24**

Главный метролог  
ФГБУ «ВНИИОФИ»

С.Н. Негода

2024 г.

Москва

2024 г.

## 1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на измеритель удлинения световодов ИД-2-3В (далее – ИД-2-3В) и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверки. ИД-2-3В предназначен для измерений удлинения волоконных световодов (оптических волокон (ОВ) и волоконно-оптических кабелей) при проведении их механических и температурных испытаний.

1.2 По итогам проведения поверки должна обеспечиваться прослеживаемость к Государственному эталону единицы длины – метра ГЭТ 2-2021, в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 29.12.2018 № 2840.

1.3 Поверка ИД-2-3В выполняется методом сличений с помощью компаратора.

1.4 Метрологические характеристики ИД-2-3В приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики ИД-2-3В

Наименование характеристики	Значение
Рабочая длина волны, нм	1550±20
Диапазон измерений удлинения ОВ, мм	от 0,5 до 1000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений удлинения ОВ, мм	$\pm(0,5+0,002\cdot L+0,5\cdot T)$ , где L – удлинение ОВ, мм; T – коэффициент, зависящий от времени измерений, равный количеству часов от их начала
Динамический диапазон, дБ	15

## 2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	8
Проверка программного обеспечения средства измерений	Да	Да	9
Определение метрологических характеристик средства измерений	Да	Да	10
Проверка рабочей длины волны	Да	Нет	10.1
Проверка диапазона и определение абсолютной погрешности измерений удлинения ОВ	Да	Да	10.2
Проверка динамического диапазона	Да	Да	10.3
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	11

2.2 Допускается проведение поверки в меньшем диапазоне измерений удлинения и для ограниченного числа измерительных каналов. Для поверки в меньшем диапазоне измерений удлинения и для ограниченного числа измерительных каналов проводится периодическая поверка на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, оформленного в произвольной форме.

2.3 При получении отрицательных результатов при проведении хотя бы одной операции поверка прекращается.

### 3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 Все операции поверки, за исключением особо оговоренных, проводят при следующих условиях:

- температура окружающей среды, °С от +15 до +25;
- относительная влажность воздуха, % не более 70;
- атмосферное давление, кПа от 96 до 104;
- напряжение питающей сети, В от 198 до 240;
- частота питающей сети, Гц от 50 до 51.

3.2 Помещение, где проводится поверка, должно быть чистым и сухим, свободным от пыли. Допускаемый перепад температуры при проведении поверки – не более 2 °С.

### 4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускают лиц, изучивших настоящую методику поверки и руководства по эксплуатации (далее – РЭ) поверяемого ИД-2-3В и средств поверки, ознакомившихся с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, указанных в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н, и имеющих опыт работы с высокоточными средствами измерений в области волоконно-оптических систем передачи информации; прошедших обучение на право проведения поверки по требуемому виду измерений.

4.2 Поверку средства измерений осуществляют аккредитованные в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

### 5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении первичной и периодической поверок применяются средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне от +15°С до +25 °С с абсолютной погрешностью не более 0,2 °С. Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне до 80 % с абсолютной погрешностью не более 2 %.	Приборы контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС-200А», рег. № 27468-04

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
	Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106 кПа с абсолютной погрешностью не более 0,13 кПа	
	Средства измерений частоты переменного тока от 40 до 60 Гц с относительной погрешностью не более 0,01 %. Средства измерений напряжения переменного тока до 600 В с относительной погрешностью не более 0,1 %	Вольтметры универсальные НМ8112-3S, рег. № 50576-12
п. 10.1 Проверка рабочей длины волны	Средства измерений длины волны и спектра оптического излучения в диапазоне от 1500 до 1600 нм с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более $\pm 0,1$ нм	Анализатор спектра оптического BRISTOL 771A-NIR-APC, ГПСИ 74066-19 (далее АОС)
п. 10.2 Проверка диапазона и определение абсолютной погрешности измерений удлинения	Эталоны единицы длины, не ниже уровня 2-го разряда по государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Росстандарта от 29.12.18 № 2840, в диапазоне измерений линейных перемещений от 0 до 80000 мм с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более $\pm (0,02 + 0,5 \cdot L)$ мкм, где $L$ – измеряемое перемещение, м.	Система лазерная измерительная XL-80, рег. № 35362-13
ОВ и п. 10.3 Проверка динамического диапазона	Эталоны средней мощности и ослабления оптического излучения в волоконно-оптических системах передачи, не ниже уровня рабочего эталона по государственной поверочной схеме, утвержденной приказом Росстандарта от 05.12.2019 № 2862, в диапазоне измерений: - средней мощности оптического излучения: от $10^{-10}$ до 1 Вт; - длин волн исследуемого излучения: от 500 до 1700 нм; - пределы допускаемой относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения на длинах волн градуировки: $\pm 2$ %; - пределы допускаемой относительной погрешности измерений относительных уровней мощности: $\pm 1$ %	Государственный рабочий эталон единиц средней мощности и ослабления непрерывного и импульсно-модулированного лазерного излучения в волоконно-оптических системах передачи в диапазоне от $10^{-10}$ до 1 Вт на длинах волн от 500 до 1700 нм (далее – РЭСМ), рег. № 3.1.ZZA.0100.2017
<b>Вспомогательное оборудование</b>		
	Микроскоп волоконно-оптический EXFO FIP-400-P-SINGLE	
	Модуль линейных перемещений – длина хода не менее 1 м	
	Лазер с длиной волны $630 \pm 30$ нм, волоконный выход FC	
	Волоконно-оптические соединительные кабели FC/APC на основе оптического волокна стандарта G.652 и совместимых	
	Спирт изопропиловый по ГОСТ 9805-84	

5.2 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение необходимых метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

5.3 Средства измерений, используемые при проведении поверки, должны быть аттестованы (поверены) в установленном порядке.

## **6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки**

6.1 При проведении поверки соблюдают требования, установленные ГОСТ 12.1.040-83, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, указанными в приложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н. Оборудование, применяемое при поверке, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91. Воздух рабочей зоны должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 при температуре помещения, соответствующей условиям испытаний для легких физических работ.

6.2 Система электрического питания регистраторов должна быть защищена от колебаний и пиков сетевого напряжения, искровые генераторы не должны устанавливаться вблизи регистраторов.

6.3 Помещение, в котором проводится поверка, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

## **7 Внешний осмотр средства измерений**

7.1 Комплектность поверяемых регистраторов должна соответствовать комплектности, приведенной в эксплуатационной документации (РЭ) и описании типа (далее – ОТ).

7.2 При внешнем осмотре должно быть установлено:

– наличие маркировки, подтверждающей тип и идентифицирующей поверяемый ИД-2-3В;

– отсутствие на наружных поверхностях поверяемого ИД-2-3В повреждений, влияющих на его работоспособность;

– отсутствие ослаблений элементов конструкции, сохранность пломб, чистота разъемов.

7.3 ИД-2-3В считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если корпус, внешние элементы, органы управления и индикации не повреждены, отсутствуют механические повреждения и ослабления элементов конструкции, а комплектность соответствует таблице состава РЭ и ОТ.

## **8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений**

8.1 Подключают к сети питания поверяемый ИД-2-3В.

8.2 Подготавливают поверяемый ИД-2-3В к работе согласно его РЭ. Проводят прогрев всех включенных приборов в течение получаса если иное не указано в их РЭ.

8.3 Дожидаются загрузки программного обеспечения (ПО) и появления на экране главного меню.

8.4 ИД-2-3В считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если не происходит отказа световых индикаторов, ошибок при запуске ПО и в работе ПО при загрузке меню.

## 9 Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Проверяют соответствие заявленных идентификационных данных ПО сведениям, приведенным в ОТ на ИД-2-3В. Для этого включают ИД-2-3В, запускают файл ПО ID\_2\_3.exe, в появившемся окне главного меню активируют раздел «Помощь», подраздел «О программе» и в выпадающем окне находят идентификационные данные ПО.

9.2 3 ИД-2-3В считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если идентификационные данные ПО соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки) ПО	Значение
Идентификационное наименование ПО	Измеритель удлинения ИД-2-3
Номер версии (идентификационный номер) ПО	4.9.0.75
Цифровой идентификатор ПО	–

## 10 Определение метрологических характеристик средства измерений

### 10.1 Проверка длины волны

Для проверки длины волны излучения оптического передатчика ИД-2-3В используют анализатор оптического спектра BRISTOL 771A.

10.1.1 Подключают опорный канал ИД-2-3В/И с помощью волоконно-оптического соединительного кабеля FC/APC-FC/APC к входному разъему BRISTOL 771A. Включают источник излучения ИД-2-3В/И согласно РЭ на ИД-2-3В.

10.1.2 Измеряют однократно длину волны излучения с помощью BRISTOL 771A согласно его РЭ.

10.1.3 ИД-2-3В считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если полученное в ходе измерений значение длины волны лежит в диапазоне от 1530 до 1570 нм.

### 10.2 Проверка диапазона и определение абсолютной погрешности измерений удлинения ОВ

Для проверки диапазона измерений удлинения ОВ применяют схему с использованием системы лазерной измерительной XL-80 (см. рисунок 1). Применяют оптическую линию задержки на основе модуля линейных перемещений.

10.2.1 Собирают схему, приведенную на рисунке 1. На подвижный столик модуля линейных перемещений устанавливают рефлектор из состава XL-80 и один объектив-коллиматор с волоконно-оптическими разъемами типа FC/PC в оправе для угловой юстировки. Второй объектив-коллиматор в аналогичной оправе устанавливают неподвижно возле лазерного блока XL-80. Подключают к объективам одномодовые волоконно-оптические соединительные кабели (пачкорды) с разъемами FC/PC-FC/APC. Юстируют XL-80 для измерений линейных перемещений по схеме с подвижным рефлектором согласно РЭ XL-80. Юстируют оптическую систему из двух объективов-коллиматоров с помощью лазера видимой области спектра (например, красного, с длиной волны 630 нм), оснащенного волоконно-оптическим разъемом типа FC/APC. Для этого подключают лазер к одному из объективов-коллиматоров посредством пачкорда и с помощью юстировочных винтов оправы добиваются совмещения пятна излучения лазера на ответном объективе с его центром. Затем перемещают подвижный столик модуля линейных перемещений на расстояние, равное максимальному удлинению, измеряемому поверяемым ИД-2-3В и повторяют операцию центровки пятна. Аналогично проводят юстировку второго объектива-коллиматора. После юстировки визуально убеждаются, что из свободного

пачкорда выходит излучение лазера. При отсутствии видимых признаков излучения на выходе системы {лазер-пачкорд-объектив-воздушное пространство-объектив-пачкорд} операции юстировки объективов-коллиматоров повторяют сначала.

10.2.2 Подключают оба пачкорда к измерительному каналу ИД-2-3В. Запускают программу измерений удлинения ИД-2-3В, формируют новое измерение удлинения и фиксируют время начала измерений T1, часы (см. РЭ ИД-2-3В), далее делают десять измерений нулевого удлинения  $\Delta l_{0i}$ ,  $i = (1;10)$ . Запускают программу измерений линейных перемещений XL-80 и обнуляют текущие показания перемещений (см. РЭ XL-80).


Для определения нижней границы диапазона измерений удлинения ОВ перемещают подвижный столик модуля линейных перемещений на длину, которая соответствует минимальному значению диапазона измеряемого удлинения согласно РЭ ИД-2-3В.

10.2.3 Фиксируют показания измеренного перемещения  $\Delta L_{ref\ i}$ , мм, с индикатора главного окна программы измерений линейных перемещений XL-80 и  $\Delta l_i$ , мм, с окна программы поверяемого СИ удлинения десять раз:  $i = (1; 10)$ . Вычисляют значения удлинения, полученные с помощью поверяемого СИ по формуле:

$$\Delta L_i = \Delta l_i - \Delta l_{0\ сред}, \quad (1)$$

где  $\Delta l_{0\ сред} = \frac{\sum_{i=1}^{10} \Delta l_{0i}}{10}$  – среднее значение нулевого удлинения при запуске измерений поверяемым СИ, мм.

Следует учесть, что в настройках программы ИД-2-3В для показателя преломления среды в данном случае следует использовать показатель преломления воздуха  $n_l=1,0003$ .

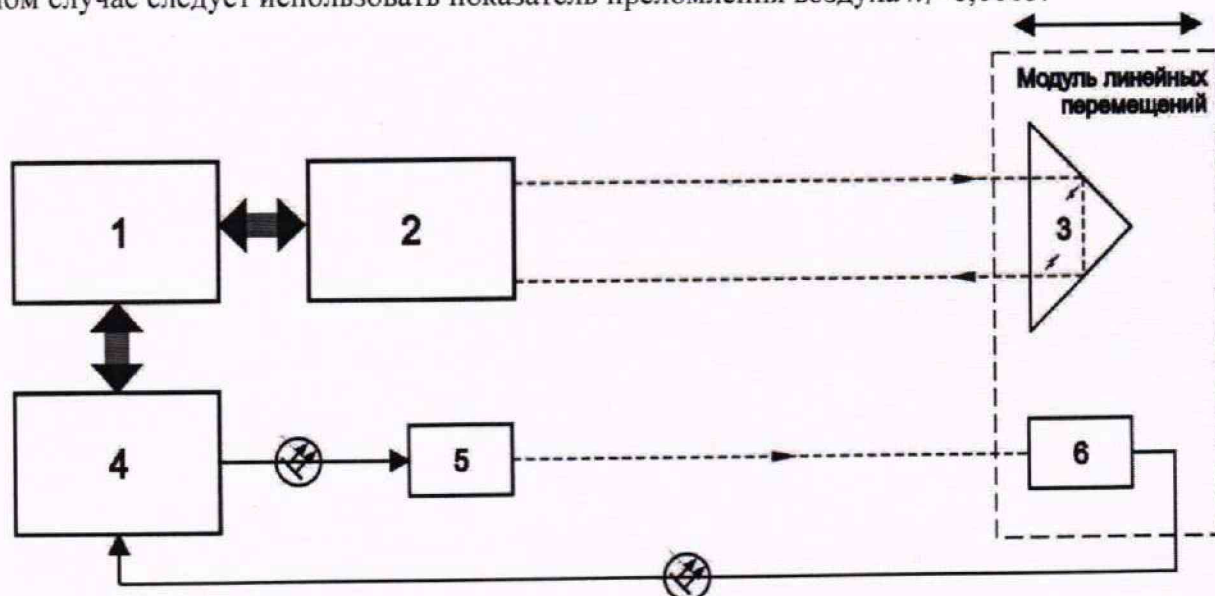

1 – ЭВМ; 2 – система лазерная измерительная XL-80; 3 – рефлектор на основе триппель-призмы из состава XL-80; 4 – поверяемый ИД-2-3В; 5,6 – два объектива-коллиматора с волоконно-оптическими разъёмами типа FC/PC и рабочей длиной волны  $(1550 \pm 30)$  нм

Рисунок 1 – Блок-схема эталонной установки для проверки диапазона и абсолютной погрешности измерений удлинения

10.2.4 Проводят операции п.п.10.2.2-10.2.3 для определения верхней границы диапазона измерений удлинения перемещая подвижный столик модуля линейных перемещений на длину, которая соответствует максимальному значению диапазона измеряемого удлинения ИД-2-3В.

10.2.5 После завершения всех измерений удлинения с помощью ИД-2-3В фиксируют время их окончания  $T_2$ , часы. Вычисляют количество целых часов, прошедших с момента начала измерений удлинения поверяемым СИ по формуле

$$T = T_2 - T_1. \quad (2)$$

### 10.3 Проверка динамического диапазона

Проверку динамического диапазона измерений удлинения проводят с помощью аттенюаторов из состава РЭСМ-ВС, которые последовательно включают в опорный и измерительные каналы поверяемого ИД-2-3В и вносят ослабление, равное 15 дБ.

10.3.1 Собирают схему рисунка 1, вставив в разрыв соединения позиций 4 и 5 измерительного канала аттенюатор из состава РЭСМ-ВС, а также аттенюатор в опорный канал. Устанавливают на аттенюаторах ослабление 15 дБ согласно РЭ на РЭСМ-ВС.

10.3.2 Проводят операции п.п.10.2.2-10.2.5 для всех каналов поверяемого ИД-2-3В.

## 11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.1 Для полученных в п.10.2 и 10.3 результатов измерений удлинения ОВ с помощью XL-80 вычисляют средние значения удлинения ОВ  $\Delta \bar{L}_{ref}$ , мм, по формуле:

$$\Delta \bar{L}_{ref} = \frac{\sum_{i=1}^m \Delta L_{ref-i}}{m}, \quad (3)$$

где  $m$  – количество измерений.

Полученные результаты заносят в протокол поверки, форма которого приведена в приложении А (таблица А.1).

11.2 Для полученных в п.10.2 и 10.3 результатов измерений удлинения ОВ с помощью ИД-2-3В СИ вычисляют средние значения удлинения ОВ  $\Delta \bar{L}$ , мм, по формуле:

$$\Delta \bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^m \Delta L_i}{m}. \quad (4)$$

Полученные результаты заносят в протокол поверки, форма которого приведена в приложении А (таблица А.1).

11.3 Определяют значения абсолютной погрешности измерений удлинения с помощью ИД-2-3В  $\Delta$ , мм, по формуле:

$$\Delta = \Delta \bar{L} - \Delta \bar{L}_{ref}. \quad (5)$$

Полученные результаты заносят в протокол поверки, форма которого приведена в приложении А (таблица А.1).

11.4 ИД-2-3В считается прошедшим операцию поверки с положительным результатом, если диапазон измерений удлинения  $\Delta L$  составляет от 0,5 до 1000,0 мм, а значения абсолютной погрешности измерений удлинения ОВ  $\Delta$ , мм, не превышают пределы  $\pm(0,5 + 0,002 \cdot \Delta \bar{L}_{ref} + 0,5 \cdot T)$  в том числе в динамическом диапазоне 15 дБ.



## 12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки оформляются протоколом поверки. Рекомендуемая форма протокола поверки приведена в приложении А. Протокол может храниться на электронных носителях.

12.2 ИД-2-3В считается прошедшим поверку с положительным результатом и допускается к применению, если все операции поверки пройдены с положительным результатом и полученные значения метрологических характеристик удовлетворяют требованиям к ИД-2-3В в соответствии с его ОТ, а также соблюдены требования по защите средства измерений от несанкционированного вмешательства. В ином случае ИД-2-3В считается прошедшим поверку с отрицательным результатом и не допускается к применению.

12.3 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, с учетом требований методики поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средства измерений метрологическим требованиям) выдает свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утвержденными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510. Нанесение знака поверки на ИД-2-3В не предусмотрено.

12.4 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, с учетом требований методики поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средства измерений метрологическим требованиям) выдает извещение о непригодности к применению средства измерений.

12.5 Сведения о результатах поверки (как положительных, так и отрицательных) передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Заместитель начальника отделения Ф-3



А.П. Мамонов

Начальник лаборатории отделения Ф-3



А.К. Митюрёв

**Приложение А**  
(Рекомендуемое)  
Форма протокола поверки

**ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ (ПЕРИОДИЧЕСКОЙ) ПОВЕРКИ №**  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Измеритель удлинения световодов ИД-2-3В**

(регистрационный № \_\_\_\_\_, 2007 года выпуска)

Заводской номер:

Изготовитель:

Владелец СИ:

Применяемые эталоны:

Применяемая методика поверки: МП \_\_.Ф3-24 «ГСИ. Измеритель удлинения световодов ИД-2-3В. Методика поверки»

Место проведения поверки:

Условия поверки:

- температура окружающей среды:
- относительная влажность воздуха:
  - атмосферное давление:
- напряжение сети питания:
- частота сети питания:

Проведение поверки:

1. Внешний осмотр:
2. Опробование:
3. Идентификация программного обеспечения:
4. Определение метрологических характеристик:

Полученные результаты измерений метрологических характеристик:

Результаты поверки рабочей длины волны: \_\_\_\_\_ нм.

Таблица А.1 – Результаты проверки диапазона и определения абсолютной погрешности измерений удлинения ОВ в динамическом диапазоне 15 дБ

$\Delta L_{ref_i}$ , мм	$\Delta \bar{L}_{ref}$ , мм	$\Delta L_i$ , мм	$\Delta \bar{L}$ , мм	$\Delta$ , мм
Канал № _____				

При ослаблении сигнала на 15 дБ				

5. Заключение по результатам проверки:

Поверитель:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

Руководитель:

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.